stomdevice

РАБОТА С МОДЕЛЯМИ


artex® bn



_Руководство по эксплуатации

AMANNGIRRBACH

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

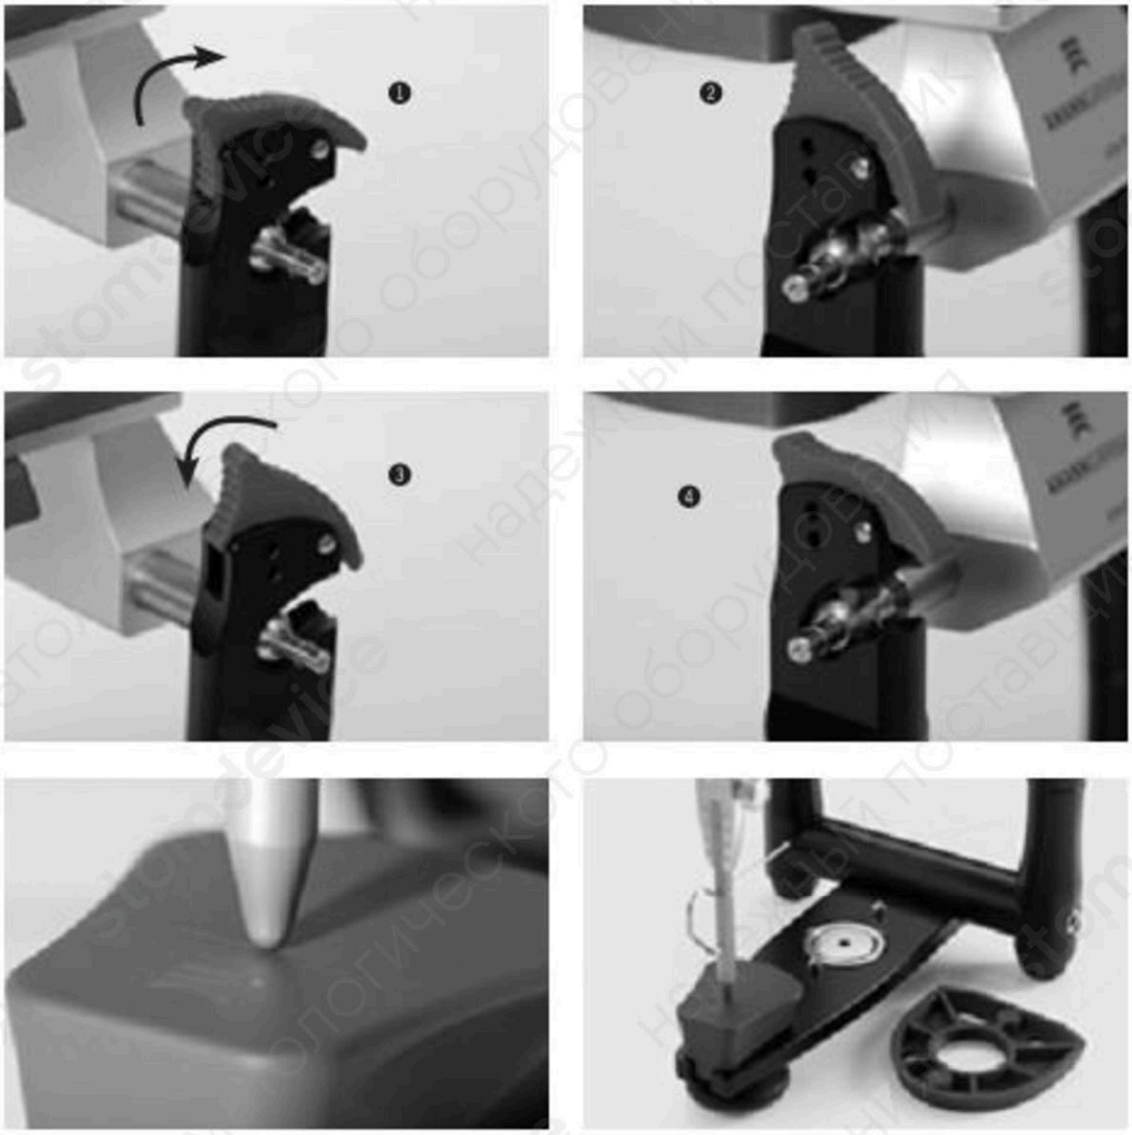

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АРТИКУЛЯТОР ARTEX®BN

ЦЕНТРАТОР ОТКРЫТ

Передвиньте защелку 1 вверх с помощью большого пальца; верхнюю часть артикулятора Artex можно беспрепятственно двигать в обратном направлении. Защелка ограничивает перемещение назад и предохраняет верхнюю часть артикулятора Artex от опрокидывания.
Центратор открыт 2, мыщелок высвобожден.

ЦЕНТРАТОР ЗАКРЫТ

Надавите на защелку 3; пластмассовый язычок центрирует мыщелок в самом нижнем положении мыщелкового канала. Вращение осуществляется только в верхней части.
Центратор закрыт 4: мыщелок зафиксирован в нужном положении с помощью пластмассового язычка.

НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ САГГИТАЛЬНОГО РЕЗЦОВОГО ПУТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕХПУНКТНЫМ КОНТАКТОМ БОНВИЛЛА

Стандартный механизм для позиционирования саггитального резцового пути в положение 0° обозначен двумя линиями. При размещении направляющего резцового штифта по центру между двумя линиями, резцовый путь с резцовым штифтом позиционируется в соответствии с трехпунктным контактом Бонвилла в 110 мм (образованного точкой резцового штифта и центральными точками мыщелков = межмыщелковое расстояние).

МАГНИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ

Пластины для моделей снимаются легко и быстро.

Объем поставки:
Заказ №:
217360 Artex BN

Принадлежности/Компоненты:
Заказ №:
217330 Пластины для моделей синие, пара
217331 Пластины для моделей синие, 50 шт./упаковка
215250 Ретенционный диск

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

_Как проверить регулировку центратора артикуляторов Artex BN, CN и Artex CT
При наличии в верхней части артикулятора бокового люфта, такое отклонение можно услышать и почувствовать по «щелчку». В этом случае необходимо повторно отрегулировать центратор.
Затем выполните следующее:
_Закройте фиксатор центратора.
_Отвинтите резьбовые штифты в основании задней части с помощью шестигранного ключа.
_Отрегулируйте направляющий резцовый штифт по центру в нулевом положении.
_В этом положении зафиксируйте верхнюю часть артикулятора. Одновременно вытяните наружу левую полуось до упора и с помощью шестигранного ключа затяните резьбовой штифт.
Выполните аналогичные действия в отношении правой полуоси.

_Общая информация
Артикуляторы являются прецизионными измерительными инструменты. Поэтому обращаться с ними нужно осторожно.
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими указаниями:
_Регулярно выполняйте проверку системы осевого сочленения и мыщелковых каналов на предмет чистоты для того, чтобы поддерживать плавную подвижность мыщелка по оси и, следовательно, обеспечивать функциональные возможности артикулятора.
_Удалите загрязнения в этой области с помощью пароочистителя, затем высушите.
_Запрещается помещать артикулятор в устройства для кипячения, нагнетательные баки или ультразвуковые ванны.
_В процессе очистки и ухода используйте только чистящие средства, подходящие для легких металлов.

В том, что касается использования моющего средства, пожалуйста, следуйте инструкциям производителя. Запрещается использовать очищающие средства с уровнем pH <5 или >8, так как это может повредить анодированные поверхности.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Производитель
Дистрибьютор

Amann Girrbach AG
Герршафтсвизен 1
6842 Коблах, Австрия
Тел. +43 5523 62333-0
Факс +43 5523 55990

Дистрибьютор

Amann Girrbach GmbH
Durrenweg 40
75177 Пфорцхайм, Германия
Тел. +49 7231 957-100
Факс +49 7231 957-159

austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com

www.amanngirrbach.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ