stomdevice

artex® ct



Регистрация
Установка в артикулятор




_Руководство по эксплуатации


AMANNGIRRBACH


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



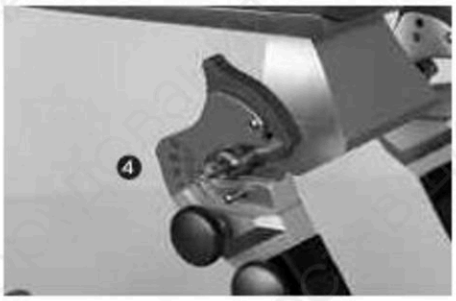





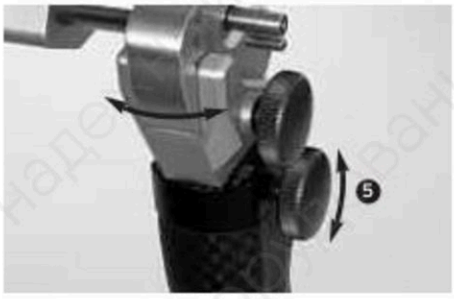

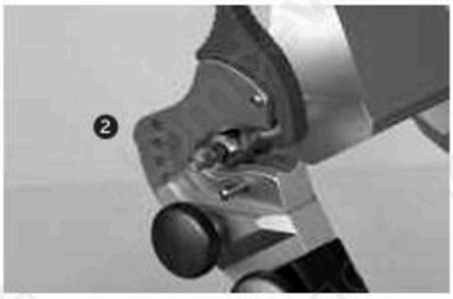



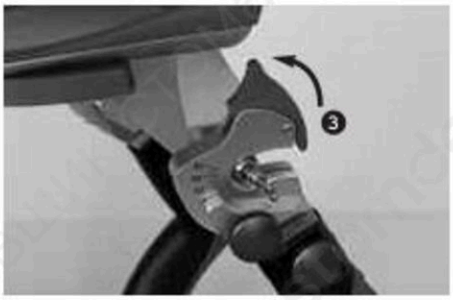

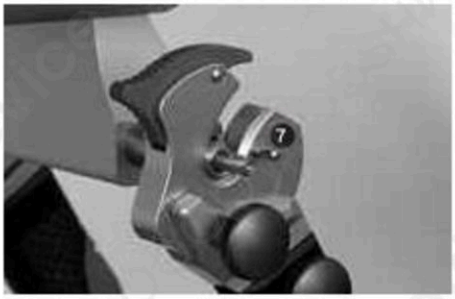

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АРТИКУЛЯТОР ARTEX®CT

ЦЕНТРАТОР ОТКРЫТ

Передвиньте защелку **(1)** вверх с помощью большого пальца; верхнюю часть артикулятора Artex можно беспрепятственно двигать в обратном направлении. Защелка ограничивает перемещение назад и предохраняет верхнюю часть артикулятора Artex от опрокидывания.
Центратор открыт **(2)**, мыщелок высвобожден.

ЦЕНТРАТОР ЗАКРЫТ

Надавите на защелку **(3)**; пластмассовый язычок центрирует мыщелок в самом нижнем положении мыщелкового пути. Вращение осуществляется только в верхней части.
Центратор закрыт **(4)**: мыщелок зафиксирован в нужном положении с помощью пластмассового язычка.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА БЕННЕТА

Отверните регулировочный винт Беннетта **(5)**, поверните мыщелок в необходимое положение и зафиксируйте положение с помощью регулировочного винта. Угол Беннета можно установить по выбору от 0° до 20°.
Рис.: Угол Беннета = 0°.

РЕГУЛИРОВКА МЫЩЕЛКОВОГО ПУТИ

Отверните регулировочный винт мыщелка **(6)**. Установите необходимый наклон мыщелка и зафиксируйте положение с помощью регулировочного винта. Угол Беннетта можно установить по выбору от -15° до +60°.
Рис.: HCI = +15°.

НЕЗАВИСИМЫЙ ШТИФТ

Если необходимо адаптировать лицевую дугу “независимо” непосредственно на артикуляторе, т.е. через отверстие в ушных раковинах, мыщелковую камеру необходимо устанавливать под углом 60° и углом Беннетта в 0°. В этом положении независимый штифт воспроизводит (среднее значение) положение ушного отверстия, в котором лицевая дуга закрепляется на пациенте. (Адаптация в средней точки оси во всех случаях является предпочтительной).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

_Анатомическое переднее ведение
Угол протрузионного пути = 40°;
при боковом перемещении угол варьируется от 30 до 40° в зависимости от предварительно установленного угла Беннета

_Как проверить регулировку центратора артикуляторов Artex CN и Artex CT
При наличии в верхней части артикулятора бокового люфта, такое отклонение можно услышать и почувствовать по «щелчку». В этом случае необходимо повторно отрегулировать центратор.
Затем выполните следующее:
_Установите угол Беннета на 10°
_Закройте фиксатор центратора.
_Отвинтите резьбовые штифты в основании задней части с помощью шестигранного ключа.
_ В анатомической пластине переднего ведения штифт переднего ведения регулируются по центру в нулевом положении.
_Зафиксируйте верхнюю часть артикулятора в этом положении. Одновременно вытяните наружу левую полуось до упора и с помощью шестигранного ключа затяните резьбовой штифт.
Выполните аналогичные действия в отношении правой полуоси.

_Общая информация
Артикуляторы являются прецизионными измерительными инструменты. Поэтому обращаться с ними нужно осторожно.
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими указаниями:
_Регулярно выполняйте проверку системы осевого сочленения и мыщелковых каналов на предмет чистоты для того, чтобы поддерживать плавную подвижность мыщелка по оси и, следовательно, обеспечивать функциональные возможности артикулятора.
_Удалите загрязнения в этой области с помощью пароочистителя, затем высушите.
_Запрещается помещать артикулятор в устройства для кипячения, нагнетательные баки или ультразвуковые ванны.
_В процессе очистки и ухода используйте только чистящие средства, подходящие для легких металлов.
В том, что касается использования моющего средства, пожалуйста, следуйте инструкциям производителя. Запрещается использовать очищающие средства с уровнем pH <5 или >8, так как это может повредить анодированные поверхности.

Принадлежности/дискретные компоненты:
Заказ №:

217330	Пластины для моделей синие, пара
217331	Пластины для моделей синие, 50 шт./упаковка
215250	Ретенционный диск

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

www.hellbau.com 30133-FB 2008-11-07

Made in the European Union

ISO 9001

Производитель
Дистрибьютор

Amann Girrbach AG
Герршафтсвизен 1
6842 Коблах, Австрия
Тел. +43 5523 62333-0
Факс +43 5523 55990

Дистрибьютор

Amann Girrbach GmbH
Дюрренвег 40
75177 Пфорцхайм, Германия
Тел. +49 7231 957-100
Факс +49 7231 957-159

austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com

www.amanngirrbach.com

AMANNGIRRBACH

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ