
stomdevice

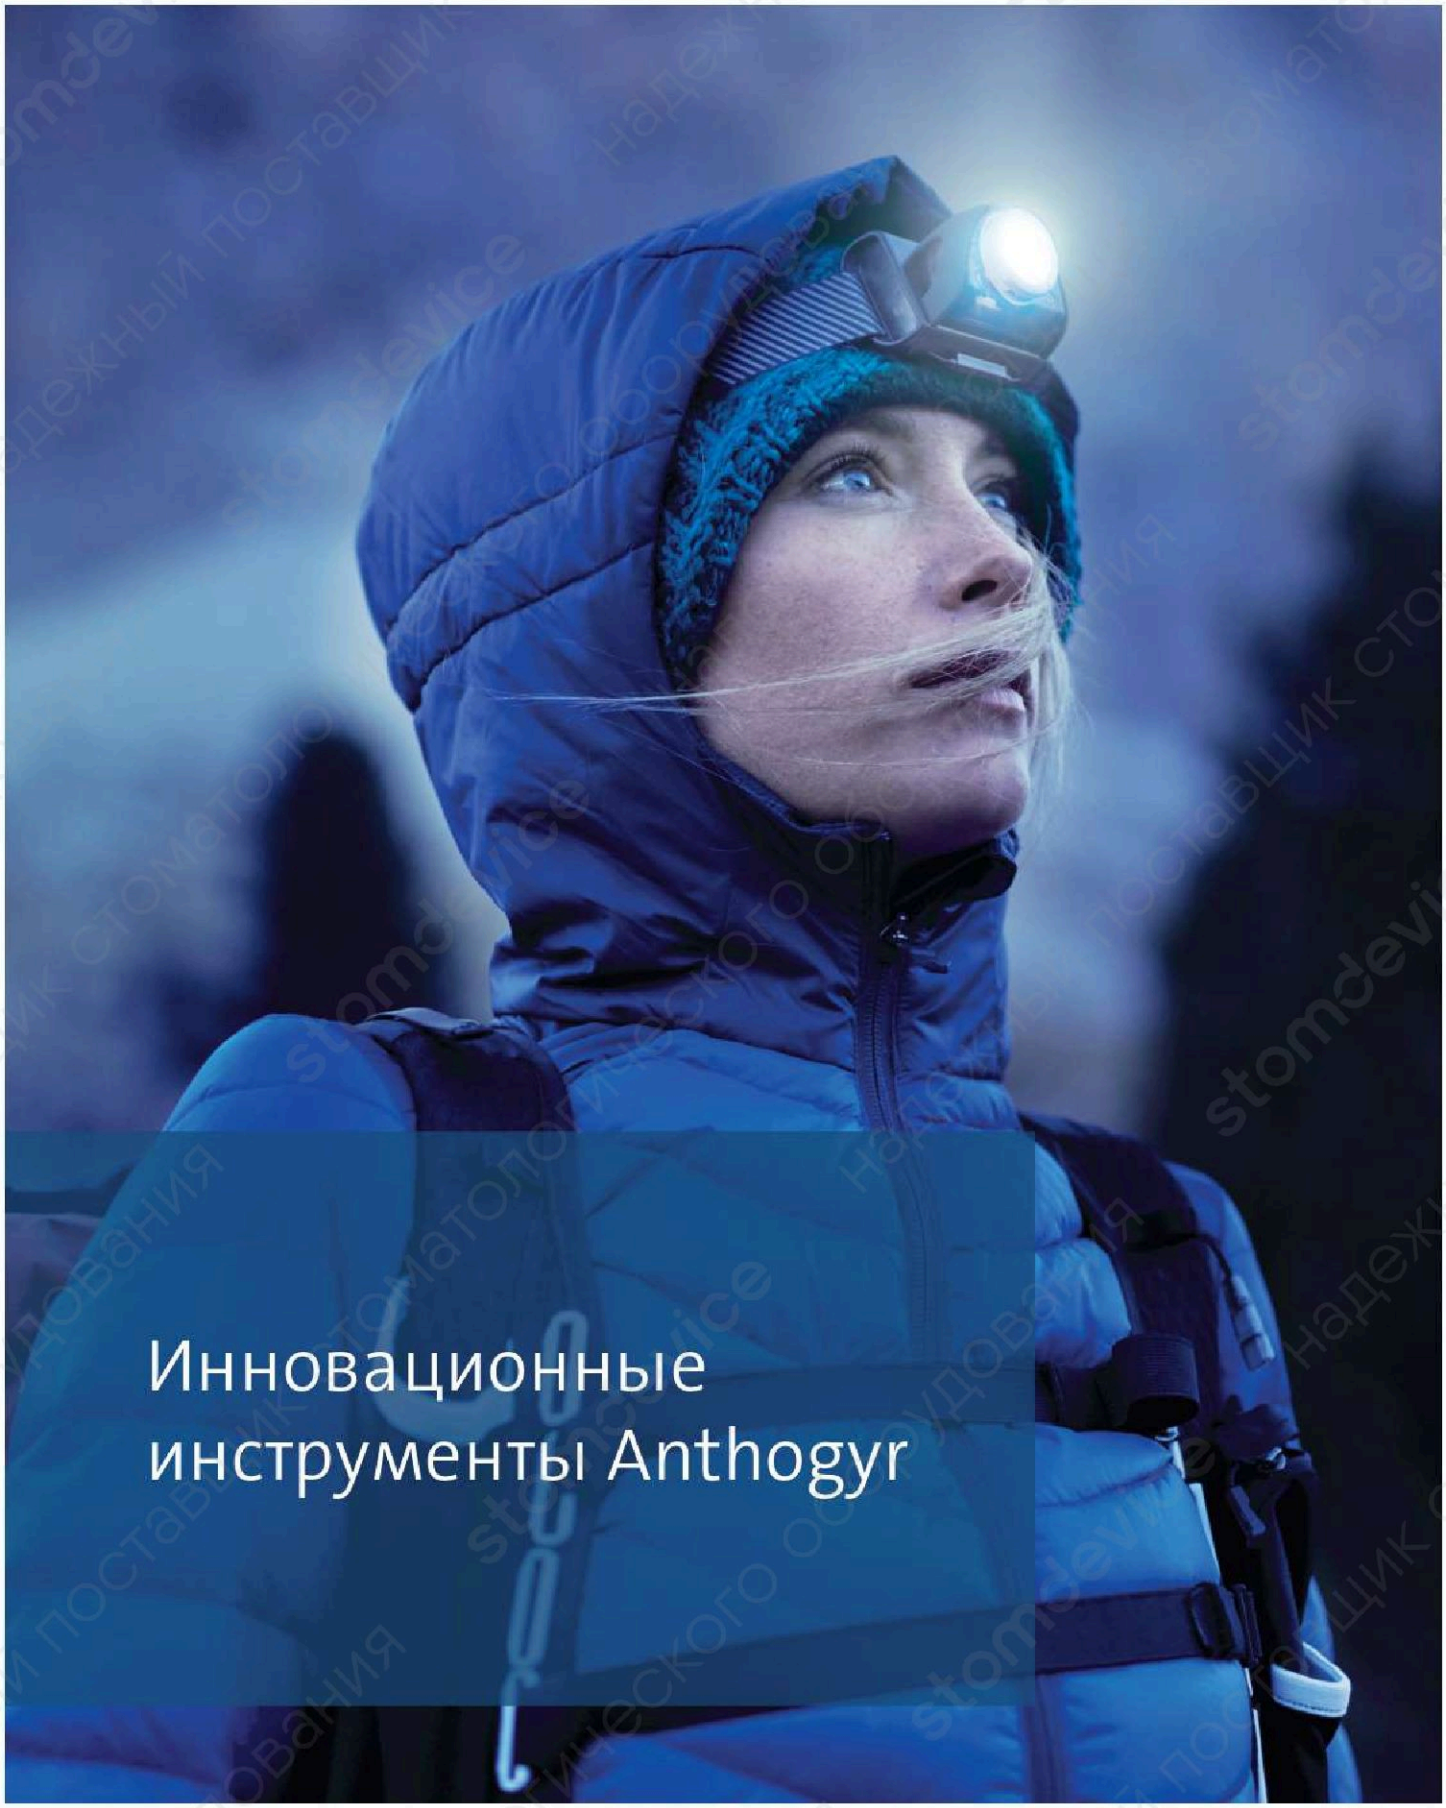

Инновационные инструменты Anthogyr

Anthogyr
A Straumann Group Brand

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1947: ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ ANTHOGYR



С момента основания компания Anthogyr была сфокусирована на высокотехнологичных продуктах и решениях для стоматологов. Следующие десятилетия компания продолжала работать в том же направлении, завоевывая все больше поклонников среди врачей.

1983: ПЕРВЫЕ ШАГИ В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ



Anthogyr получает первые заказы на производство дентальных имплантатов для сторонних компаний. В том же году компания представила собственную разработку — физиодиспенсер Minigyr с оборотами до 30 тыс. об/мин, идеально подходящий для угловых наконечников.

1997: ANTHOGYR ЗАПУСКАЕТ СОБСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ ИМПЛАНТАТОВ



Приобретенная экспертиза и знания, полученные за годы работы на стоматологическом рынке, позволили компании Anthogyr запустить свою первую линейку дентальных имплантатов Anthofit.

2009: ANTHOGYR ЗАПУСКАЕТ AXIOM



Запуск инновационной линейки имплантатов Anthogyr Axiom, которой уже более 20 лет доверяют врачи по всему миру.

2019: ANTHOGYR СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ STRAUMANN GROUP



Следуя своей стратегии активного развития, Anthogyr присоединяется к Straumann Group, мировому лидеру в области разработки решений для дентальной имплантологии.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Латунные хромированные шприцы Anthogyr® – это наиболее доступное решение в нашем портфеле

ЛАТУННЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ШПРИЦЫ



арт. **1640**

Без аспирации



арт. **3800**

С ручной аспирацией



Эргономичный и надежный механизм установки карпулы



Ручная аспирация для максимально безопасной анестезии

ШПРИЦЫ ANTHOGYR ОЧЕНЬ ПРОСТЫ В СТЕРИЛИЗАЦИИ И НЕ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ	
Очистка	Ультразвуковая очистка
Предварительная дезинфекция	Замачивание в дезрастворе
Сухожаровая стерилизация	Нет
Автоклавирование	135 ºC в течение 20 минут

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Стальные нержавеющие шприцы Anthogyr® – это лучшее решение в нашем портфеле с исключительной надежностью и эргономикой

СТАЛЬНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ШПРИЦЫ



арт. **2310**

Без аспирации



арт. **2320**

С автоаспирацией



арт. **2330**

С ручной аспирацией



Исключительная износостойкость и точность благодаря использованию нержавеющей стали



Ручная и автоматическая аспирация для максимально безопасной анестезии

ШПРИЦЫ ANTHOGYR ОЧЕНЬ ПРОСТЫ В СТЕРИЛИЗАЦИИ И НЕ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ	
Очистка	Ультразвуковая очистка
Предварительная дезинфекция	Замачивание в дезрастворе
Сухожаровая стерилизация	Да
Автоклавирование	135 °C в течение 20 минут

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Шприцы Anthogyr® – это наиболее эргономичное и технологичное решение для такой сложной анестезии, как интралигаментарная


ИНТРАЛИГАМЕНТАРНЫЕ ШПРИЦЫ



арт. **2400**



арт. **2300**

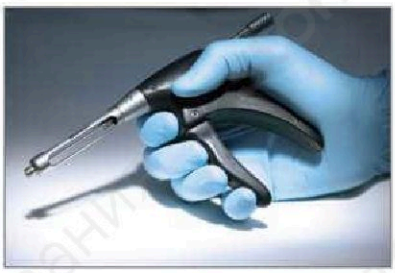

Интралигаментарный шприц Ergoject увеличивает силу нажатия в 3 раза



Интралигаментарный шприц Minject увеличивает силу нажатия в 5 раз



Интралигаментарные шприцы снабжены механизмом, который обеспечивает плавность и непрерывность инъекции

ШПРИЦЫ ANTHOGYR ОЧЕНЬ ПРОСТЫ В СТЕРИЛИЗАЦИИ И НЕ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ	
Очистка	Ультразвуковая очистка
Предварительная дезинфекция	Замачивание в дезрастворе
Сухожаровая стерилизация	Нет
Автоклавирование	135 ºC в течение 20 минут

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ловушка костных остатков Aspeo® — уникальный инструмент, созданный по высоким стандартам и требованиям Anthogyr®

Аутогенная кость по-прежнему считается золотым стандартом для аугментации кости. Она позволяет избежать иммунного ответа и снижает риск передачи инфекции.

Aspeo® — одна из лучших систем для сбора кости со значительной пропускной способностью фильтра.

Его оригинальная конструкция позволяет также легко уложить кость в область аугментации, обеспечивая врачу непревзойденную простоту использования.

АРТИКУЛЫ В КАТАЛОГЕ

12010 : Костная ловушка Aspeo + 3 фильтра.
12006 : Упаковка из 6 одноразовых фильтров.
12012 : Упаковка из 12 одноразовых фильтров.



ASPEO ПОЗВОЛЯЕТ ОБЛЕГЧИТЬ РАБОТУ ДОКТОРА И ВЫВЕСТИ ЕЕ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

+ Большая емкость для сбора кости (916 мм³ на фильтр).
+ Высококачественная фильтрация аутогенной кости.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

+ Многоразовое устройство (кроме одноразового фильтра).
+ Фильтр можно использовать несколько раз за время операции у одного пациента.

ЭРГОНОМИКА

+ Просто забирать и доставать костный материал.
+ Хорошая видимость во рту.
+ Легко собирать и разбирать.
+ Может подключаться ко всем типам аспирационных систем с помощью адаптера.

БЕЗУПРЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

+ 100 % нержавеющая сталь.
+ Полностью разборный.
+ Одноразовые фильтры.
+ Термическая дезинфекция и стерилизация (автоклавирование при 135 °C).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

При разработке ловушки костных остатков Aspeo® мы стремились достичь максимально возможной эргономики и качества кости

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

- Установите фильтр (1) и поставьте на место переднюю канюлю (2).



1



2

- Подсоедините Aspeo® к аспирационной системе.
- Во время сверления держите переднюю канюлю близко к месту установки имплантата.
- Убедитесь, что собранные костные фрагменты не пересыхают из-за непрерывного потока воздуха, проходящего через фильтр.
- Снимите переднюю канюлю, чтобы извлечь костные фрагменты.
- Активируйте поршень (как в шприце).
  Собранные костные фрагменты затем можно поместить в чашу или уложить непосредственно в зону аугментации (3).


3

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Torq Control® – это универсальный ортопедический динамометрический ключ и один из бестселлеров компании Anthogyr®

Torq Control® гарантирует точность установки вне зависимости от типа соединения имплантата или сложности доступа.


Torq Control® был специально разработан компанией Anthogyr® для фиксации любых ортопедических конструкций и в особенности для работы с тотальными реставрациями.

ЭРГОНОМИЧНАЯ МИКРОГОЛОВКА

Легкий доступ к дистальным отделам и отличная видимость

АДАПТИРОВАН ДЛЯ ВСЕХ ПРОТОКОЛОВ

7 значений торка

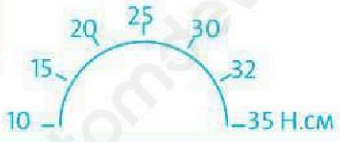



УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Любые ортопедические отвертки

Любая система имплантатов

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Ощущение закручивания обеспечивает полный контроль

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СБРАСЫВАНИЕ УСИЛИЯ

Точность, надежность и безопасность

MADE IN FRANCE

Знаковый продукт с 1997 года!

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Torq Control® позволяет осуществить установку ортопедических компонентов с максимально точным усилием и соблюдением протоколов лечения

СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ СИСТЕМАМИ ИМПЛАНТАТОВ!

- Универсальное соединение с разъемом, как у углового наконечника.
- 7 значений крутящего момента, от 10 до 35 Н·см, адаптированы для любого протокола.



СОЗДАН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Микроголовка с углом наклона 100° для легкого доступа и оптимального обзора даже в жевательном отделе.

ТАК ЛЕГКО ОБРАЩАТЬСЯ

- Всего 130 г обеспечат большую свободу движений



Процесс упаковки, Anthogyr, Салланш

СОВЕРШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Высокоточные значения торка с допуском +/- 1
- Автоматическое сбрасывание усилия при достижении заданного торка





МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 100 % движений вне полости рта
- Без боковых движений

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Цельная конструкция
- Стерилизация в автоклаве при 135 °C

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

- Производится в долине Монблан, Франция, с 1997 года
- Высокое качество изготовления



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Как ухаживать за Torq Control®?

1. РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ

- Очистку необходимо проводить сразу после использования.
- Используйте только моющие или дезинфицирующие растворы с нейтральным или слабощелочным pH.

  Важно: не рекомендуется использовать средства, которые могут фиксировать Х-белки к инструменту (спирт, альдегиды).
- Не используйте гипохлорит натрия (отбеливатель) в связи с высоким риском коррозии.

НАРУЖНАЯ ЧИСТКА

- Ключ можно очищать с помощью щетки под проточной водопроводной водой.
- Наружная дезинфекция с помощью спрея или салфетки, пропитанной дезинфицирующими средствами с микробиологическим контролем (pH 2,5-9).

  Важно: соблюдайте длительность реакции используемого дезинфицирующего средства.
- Не используйте дезинфицирующие средства, содержащие щелочь и хлор.
- Не погружайте ключ в дезинфицирующий раствор или контейнер для ультразвуковой очистки.

2. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СМАЗЫВАТЬ

Смазку необходимо проводить перед первым использованием, а также перед каждой стерилизацией.

- Установите наконечник распылителя (P/N 1933X) на банку с аэрозолем.
- Поместите наконечник банки с аэрозолем в отверстие, расположенное на задней стороне ключа Torq Control.
- Удерживайте сопло баллончика в отверстии ключа до повторного снижения давления.
- Распыляйте в течение 1-2 секунд.
- Масло проходит через весь инструмент, выступая в роли очищающего и смазывающего средства.

3. ПРАВИЛЬНО СТЕРИЛИЗУЙТЕ

Важно: мы рекомендуем использовать стерилизатор класса В. Следует избегать любых других методов стерилизации. Ознакомьтесь с инструкцией, предоставленной производителем стерилизатора. Соблюдайте указанный промежуток между пакетами и не перегружайте стерилизатор.

- Стерилизуйте только ранее продезинфицированные, очищенные, смазанные и проверенные инструменты.
- Снимите отвертку, вставленную в ключ, до стерилизации.
- Убедитесь в отсутствии каких-либо участков коррозии или трещин и проверьте его исправность. Убедитесь, что инструмент сухой; при необходимости, удалите остатки воды с помощью медицинского воздуха под давлением.
- Используйте пакеты для стерилизации, подходящие для ключа и стерилизатора. В один пакет всегда помещайте один инструмент.
- Во избежание остатка воды помещайте пакет в стерилизатор таким образом, чтобы вогнутые детали были направлены вниз.
- Если стерилизатор имеет несколько видов циклов, выберите цикл, предназначенный для медицинских изделий (не менее 135 °C, 2,13 бара (275 °F при 30,88 фунтов/кв. дюйм) в течение 18 минут).
- После каждого цикла стерилизации убедитесь, что внутри и снаружи пакета не осталось воды. Убедитесь, что цвет индикатора потока изменился на соответствующий.
- Храните инструменты в пакетах для стерилизации вдали от источников света, влаги и любого вида загрязнения. Следуйте рекомендациям производителя, указанным на упаковке.
- Максимальный срок хранения после стерилизации составляет 1 месяц. Сделайте маркировку с указанием даты окончания срока годности. После истечения срока годности повторно проведите процедуру очистки и стерилизации.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ