stomdevice


ARTINOX

Изготовитель:
АРТИНОКС ЧУП,
Республика Беларусь,
Минская область,
Минский р-н,
Михановичский с/с 14,
район д. Михановичи

ПАСПОРТ

ГОСТ 16371-93

Стул для рентгенкабинета AR-Z76X

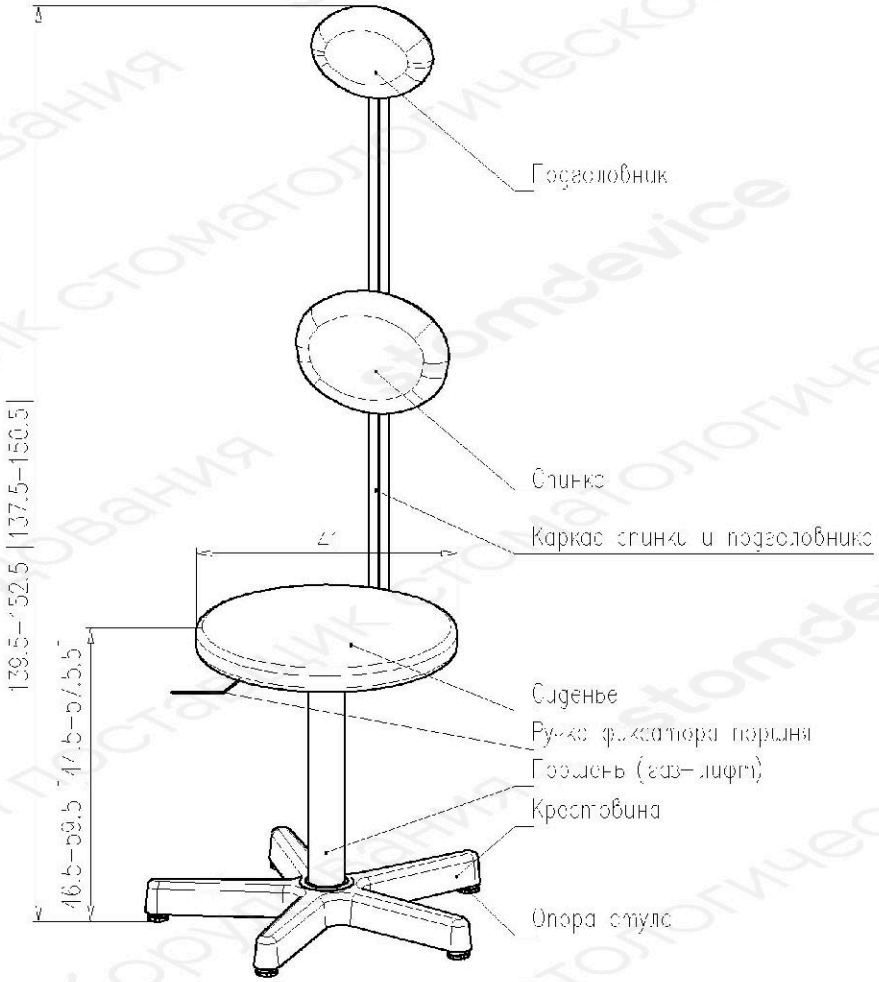

***[1]Все размеры в сантиметрах**
***[2]Размеры: меньшее значение – для сжатого газ-лифта, большее – для вытянутого газ-лифта**
***[3]Размеры в квадратных скобках для стула AR-Z76X**

2017г.

Комплектность
Крестовина* - 1шт,
Опора стула** – 5шт.
Поршень (газ-лифт) – 1шт
Сиденье с прикрепленной пиастрой*** – 1шт
Каркас спинки и подголовника – 1шт
Спинка**** – 1шт,
Подголовник**** – 1шт,
Упаковка – 1комплект
Паспорт – 1шт.

* Материал крестовины – пластик для AR-Z67B; металл для AR-Z67X
** Опора стула - стационарная ножка; возможна установка колеса поворотного со стопором по согласованию с заказчиком
*** Пиастра - переходник под газ-лифт со встроенной ручкой фиксатора поршня газ-лифта и механизмом крепления каркаса спинки стула
**** Спинка и подголовник комплектуются кронштейнами с фиксирующими винтами для перемещения по каркасу спинки

Общее описание
Стул состоит из крестовины с опорами (колеса или ножки в зависимости от комплектации), на которой через регулируемый поршень (газ-лифт) крепится с сиденье с каркасом спинки. На каркасе спинки размещены спинка и подголовник с возможностью регулировки по высоте. Материал обивки сиденья, спинки и подголовника – медицинский кожзаменитель. Способ регулировки высоты сиденья – пневматический, спинки и подголовника – ручной механический.

Порядок сборки
Изделие поставляется в разобранном виде
1. Вставьте колеса в крестовину до упора – должна произойти фиксация колеса в крестовине
2. Вставьте поршень (газ-лифт) в крестовину до упора
3. Надеть сиденье на верхнюю часть поршня
4. Вставить и зафиксировать винтом спинку стула

Порядок регулировки
Регулировка высоты сидения стула производится следующим образом:
1. Потянуть ручку фиксатора газ-лифта «вверх».
2. Удерживая ручку фиксатора, установить высоту сиденья стула (усиливая или ослабляя давление на сиденье) на требуемом уровне
3. Отпустить ручку фиксатора газ-лифта. Ручка должна вернуться в исходное положение «вниз», зафиксировав газ-лифт в нужном положении

Регулировка спинки и подголовника:
1. Ослабить стопорный винт на спинке (подголовнике) стула
2. Установить спинку (подголовник) стула на требуемой высоте
3. Зафиксировать положение стопорным винтом

Условия эксплуатации
Стул предназначен для работы в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от +10°С до +40°С и относительной влажностью 25-90% без образования конденсата. Предельно допустимая нагрузка – 110кг. Не производите самостоятельно разборку изделия.
В связи с постоянной работой по совершенствованию кресла, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

Транспортировка и хранение
1. Транспортирование изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
2. При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.
3. При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
4. Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.
5. Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5°С до +40°С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25°С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Правила ухода
1. По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхности изделия.
2. Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.
3. Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.
4. Уход за медицинским кожзаменителем: загрязненные участки кожи обработать мягкой тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства или 50% спиртово-водным раствором (допускается чистка средствами, содержащими аммиак), протереть чистой влажной а затем сухой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ РАСТВОРИТЕЛИ: АЦЕТОН, БЕНЗИН и т.д.

Порядок предъявления претензий
1. Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.
2. Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев).
3. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, без уведомления заказчика, и не ухудшающие работоспособность изделия

Свидетельство о приемке
Комплект и его составные части соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным к эксплуатации.

Артикул: _____

Дата выпуска: _____

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП
Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район д. Михановичи

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ