
stomdevice

ВЕГА-ПРО
РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО

АВЕРОН

ДОЛОТО ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ распаковочное модель ПД 1.0 ПЕДАЛЬ

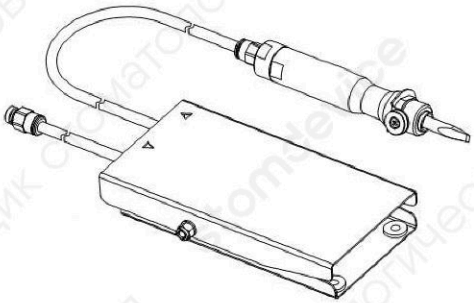

Этикетка АВЕ 435.000.001 ЭТ

для удаления гипса и паковочной массы
при распаковке литья

ВНИМАНИЕ!

Перед подсоединением **долота** после хранения разместить его вверх отверстием для насадки и капнуть 5…7 капель смазки (см. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ), затем энергично встряхнуть 10 раз до появления звука перемещения ударника.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВНИМАНИЕ!

В качестве штуцеров применены быстроразъемные соединения.
См. Памятку **Эксплуатация быстроразъемного соединения**.
С целью снижения отказов перед подсоединением **долота** продуть шланг сжатым воздухом для удаления из шланга пыли и микрочастиц абразива.
Если после подсоединения и подачи воздуха насадка **долота** неподвижна (поршень в нейтральной фазе) - сместить насадку по продольной оси.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Долото пневматическое распаковочное **ПД 1.0 ПЕДАЛЬ** (далее – **долото**) предназначено для удаления гипса и паковочной массы. Является принадлежностью к Аппаратам для струйной обработки АСО3 "Аверон" (далее – АСО3).
Допускается совместное использование с Автономными струйными модулями АМС АВЕРОН и аналогичными устройствами, а также автономное использование, при подсоединении к пневмосети через АДАПТЕР 2.0 МПВ, редуктор МПВ 1.0.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура.....10...35°С
- влажность при 25°С, не более..... 80%

1.3 Основные технические характеристики

- рабочее давление.....6 атм
- расход воздуха, не более ..... 50 л/мин
- габариты **долота** .....30×30×165 мм
- габариты педали .....95×165×30 мм
- масса, не более.....0,7 кг

1.4 Комплектность

Пневмодолото	1
Пневмопедаль ПВП 1.0	1
Фитинг цанга прямой	1 к-т
Этикетка АВЕ 435.000.001 ЭТ	
⊠ АДАПТЕР 2.0 МПВ	

⊠ - поставка по дополнительной заявке

1.5 Особенности

- просто в обслуживании, надежно, долговечно и позволяет экономить до 30% времени при обработке;
- выполнено из высококачественной стали;
- полная передача силы ударного механизма на насадку **долота**;
- незначительная вибрация корпуса;
- резиновый колпачок для защиты носовой детали **долота** от износа и повреждения;
- боковой выброс воздуха – не раздувает отходы распаковки;
- магнит на скобе в носовой части - для крепления **долота** в удобном месте (например, к корпусу АСО3).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При подсоединении **долота,** АДАПТЕР 2.0 МПВ выключить АСОЗ от сети и перекрыть магистраль высокого давления.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ работать в защитных очках и маске или использовать бокс, например, Б 7.х МОБИЛ АРТ.

3 УСТРОЙСТВО, рис.1

1 – Пневмодолото
2 – Насадка
3 – Штуцер G1/8″
4 – Пневмошланг 6/4 L=2 м
6 – Пневмопедаль ПВП 1.0

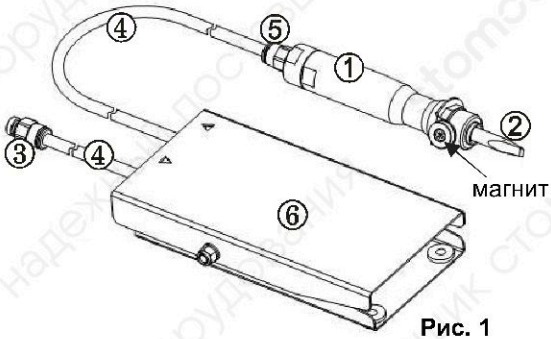


Рис. 1

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При снижении рабочего давления ниже 6 атм резко падает сила удара насадки долота.

Порядок подключения к АСОЗ АВЕРОН
в зависимости от вида регулятора давления

Для конструкции рис.2:
1. Шестигранным ключом х4 мм выкрутить заглушку **(6)** из регулятора давления.
2. Штуцер **долота** вкрутить вместо заглушки.



Рис. 2

Или:
Использовать **АДАПТЕР 2.0 МПВ (7)**, рис.3, поставка по дополнительной заявке.

Рабочее давление – 6 атм, см.п.1.3.

Установка насадки в **долото** возможна только в двух диаметральных положениях (на его хвостовике две лыски). Полная установка насадки в **долото** сопровождается небольшим щелчком фиксатора.

Легкое прижатие рабочей части насадки к модели обеспечивает ее больший ход, ускоряя разрушение гипса, паковочной массы.



Рис. 3

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

stomdevice

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• **регулярно** смазывать **долото** 3…5 каплями смазки (дизельное топливо, очищенное машинное масло);
• если **долото** не использовалось более 10 дней, то разместить его вверх отверстием для насадки и капнуть 5…7 капель смазки, затем энергично встряхнуть 10 раз до появления звука перемещения ударника;
• производить заточку насадки по мере необходимости.

6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Срок службы - не менее 5 лет.
Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.
Гарантии не распространяются на насадку, пневмошланги.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель ПД 1.0 ПЕДАЛЬ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ