stomdevice

КОММУТАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ

БЛИК 2.2 СЕНСОР



Руководство по эксплуатации
АВЕ 591.000.001 РЭ

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.14026/20 от 18.05.2020

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

БЛИК 2.2 СЕНСОР	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на коммутатор универсальный бесконтактный **БЛИК 2.2 СЕНСОР** (далее - **БЛИК**). ТУ 27.90.11-070-52331864-2020.

1.2 БЛИК предназначен для бесконтактного включения/выключения различных исполнительных устройств (далее – Устройство*) мощностью до 1,3 кВт при срабатывании любого из двух подключенных инфракрасных датчиков (далее - ИК-датчик).

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура..... 10...35°С
- влажность при 25°С, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- электропитание, с подключенной нагрузкой..... ~220/230В 50/60Гц 6А
- коммутируемая мощность, до..... 1300 Вт
- масса, не более..... 0,9 кг
- габариты блока коммутации, не более..... 95×115×45 мм
- габариты кронштейна с датчиком, не более ..... 45×50×45 мм

1.5 Комплектность

БЛИК 2.2 СЕНСОР — 1 шт
ИК-датчик с кабелем — 2 шт
Кронштейн ИК-датчика — 2 шт
Отвертка шлицевая — 1 шт
Руководство по эксплуатации АВЕ 591.000.001 РЭ

1.6 Особенности

Включение Устройства только при внесении рук и обрабатываемого изделия в любую из рабочих зон, контролируемых **БЛИК** двумя ИК-датчиками, и его выключение при их удалении.

Условия работы комфортнее: исключаются ручные включения/выключения Устройства, удобней удерживать изделия, меньше отвлекается внимание и др.

Наиболее эффективный расход ресурса Устройства и экономия энергоресурсов: Устройство включается только на время использования рабочих зон, «холостой» пробег минимален.

Дальность срабатывания ИК-датчиков регулируется.

Примеры актуального применения **БЛИК** для управления:

- включением/выключением ПОЛИР СТАРТ/МАСТЕР и подключенной к ним вытяжке УПЗ;
- вытяжкой, подключаемой к двум зуботехническим столам;
- вытяжкой в составе произвольного рабочего места зубного техника;
- освещением в рабочей зоне.

БЛИК адаптирован к столам СЗТ 4.3 МАСТЕР: ИК-датчик выводится через кабель-канал и одну из втулок на передний торец столешницы и фиксируется за счет магнитов на кронштейне. По необходимости ИК-датчик вытягивается из втулки и ставится в рабочее положение. Корпус блока

* - Эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

коммутации фиксируется магнитом на задней стенке, его выключатель доступен для оперативной коммутации.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Розетка электропитания должна иметь контакт защитного заземления.

При присоединении к **БЛИК** сетевой выключатель Устройства должен быть в выключенном положении.

Обязательно выключать коммутируемое Устройство сетевым выключателем при обслуживании (замена инструмента, регулировка, чистка и пр.), а также соблюдать остальные Меры безопасности из сопроводительной документации на эти Устройства.

ВНИМАНИЕ!


Подключенное к **БЛИК** Устройство включается автоматически при срабатывании любого из двух подключенных ИК-датчиков.

По окончании работы всегда выключайте Устройство сетевым выключателем.

Соблюдайте осторожность.

3 УСТРОЙСТВО

1 – блок коммутации
2 – ИК-датчик
3 – сетевая вилка для подключения к питающей сети
4 – сетевая розетка для подключения коммутируемого Устройства
5 – сетевой выключатель
6 – кронштейн ИК-датчика
7 – винт подстройки дальности включения
8 – пластиковая гайка ИК-датчика

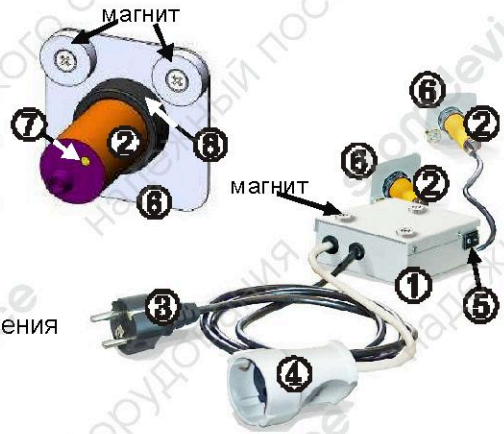

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 Выдержать **БЛИК** при комнатной температуре 4 часа, если он находился в холоде.

4.2 Установить ИК-датчики **(2)** с помощью магнитов так, чтобы линзы датчиков были направлены на рабочие зоны Устройств на рабочих местах. При необходимости перестановки магнитов с лицевой стороны кронштейна **(6)** на тыльную или обратно – вручную открутить пластиковую гайку **(8)** ИК-датчика, перевернуть кронштейн и закрутить гайку на ИК-датчик.

4.3 Сетевую розетку **(4)** соединить с сетевой вилкой коммутируемого Устройства, а сетевую вилку **(3)** подключить к сетевой розетке (см. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ).

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

stomdevice

4.4 Включить сетевые выключатели **БЛИК** и Устройств.

4.5 При необходимости изменить дальность включения Устройства винтом **(7)**: при вращении винта отверткой по часовой стрелке дальность увеличивается, против — уменьшается.

4.6 При длительных перерывах в работе отключать **БЛИК** от сетевой розетки.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование **БЛИК** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам. Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50°С, относительная влажность до 100 % при температуре 25°С.

5.2 **БЛИК** должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С. Не допускается хранение **БЛИК** совместно с кислотами и щелочами.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости, эксплуатирующим персоналом должна обеспечиваться очистка наружных поверхностей **БЛИК** от пыли влажной мягкой тканью (губкой) или дезинфекция (растворы согласно МУ 287-113-00).

Затекание жидкостей в конструкцию **БЛИК** не допускается.

7 ГАРАНТИИ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие **БЛИК** требованиям действующей технической документации в случае соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.

7.2 Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

7.3 Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ