
stomdevice

ПНЕВМОРАЗВЕТВИТЕЛЬ

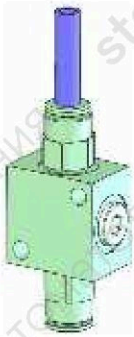

модель БЛОК 3.0 ПНЕВМО

Этикетка
АВЕ 515.000.000 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель БЛОК 3.0 ПНЕВМО	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,

то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ПНЕВМОРАЗВЕТВИТЕЛЬ БЛОК 3.0 ПНЕВМО (далее – Разветвитель) предназначен для подключения к одному источнику сжатого воздуха до 2-х пневмоустройств - дополнительно к обдувочному соплу СО 2.0 (далее – СО).
В столах производства АВЕРОН серий: МАСТЕР, ДРИМ, ЛОРЕЛЕЯ и ряде другой продукции обеспечивается оперативное подключение СО и Устройства КУЛЕР 1.0 БМ (далее – КУЛЕР) для локального охлаждения инструментов и изделий при работе с бормашиной.

1.2 Основные технические характеристики

- рабочее давление.....до 6 атм
- масса, не более .....0,1 кг
- наружный диаметр пневмошланга.....6 мм



2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

БЛОК 3.0 ПНЕВМО (1) с пневмошлангом **(2)**
Этикетка АВЕ 515.000.000 ЭТ

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Отключить подачу сжатого воздуха в пневмосети при подсоединении Разветвителя, СО и других пневмоустройств, а также при проведении их технического обслуживания.

Внимание !


В качестве штуцеров в Разветвителе применены быстроразъемные соединения. См. Приложение: Эксплуатация быстроразъемных соединений.

Обдувочное сопло СО подсоединять только к выходу напротив входа Разветвителя**!**

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Разветвитель устанавливается между СО и фитингом **(5)**, к которому подсоединяется СО в столах МАСТЕР, ЛОРЕЛЕЯ, для чего:

- вместо СО подсоединить к фитингу **(5)** шланг **(2)** Разветвителя;
- к выходу **(4)** напротив входа Разветвителя подсоединить пневмошланг СО;
- вместо заглушки **(3)** к выходу **(6)** и/или аналогичному с противоположной стороны Разветвителя подсоединить пневмошланг нужного устройства, например, КУЛЕРА.

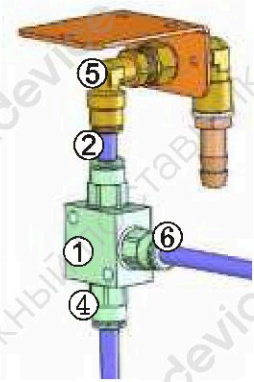

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения протереть влажной мягкой тканью, губкой (растворы в соответствии с МУ 287-113-00).

6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Гарантия не распространяется на пневмошланг.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.


Адрес Изготовителя:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20
тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Эксплуатация быстроразъемных соединений
(установлены в качестве штуцеров)


1. Требования к поверхности и геометрии пневмошланга (трубки):
- устанавливаемая в соединение часть трубки должна быть без повреждений (вмятин, заусенец и т.п.);
- неперпендикулярность торца - не более 5 градусов (см. рис.).

2. Установка трубки в гильзу соединения - на длину L (до упора), на этом расстоянии рекомендуется нанести на трубку контрольную метку.

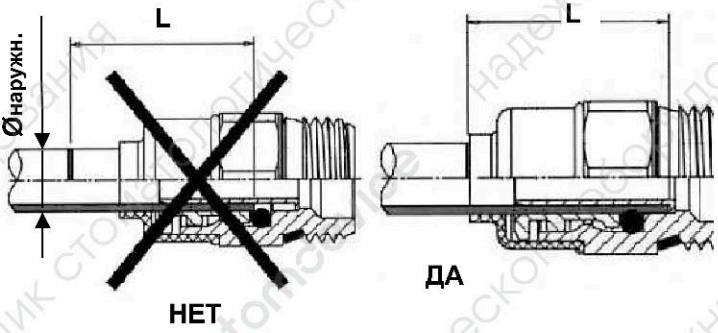

Ø мм	L мм
Ø5	15 мм
Ø6	16 мм
Ø8	18 мм
Ø10	19 мм

Для демонтажа трубки или заглушки необходимо:
- перекрыть подачу давления от внешнего источника и снять давление в пневмосистеме устройства;
- нажать на колпак **(1)** соединения, который сместит цангу и освободит трубку;
- удерживая колпак в нажатом положении, извлечь трубку **(2)** из соединения.

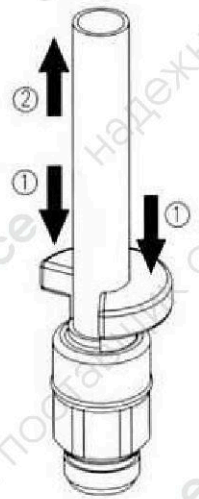

Соединение, находящееся под давлением, неразборное!