stomdevice

ЭЛЕКТРОШПАТЕЛЬ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ ЭШЗ-01-«АВЕРОН»



1.1 СТАРТ

РУ №ФСР 2009/05430 от 30.01.2024

Руководство по эксплуатации АВЕ 045.000.000.1 РЭ

Нанесенная маркировка по безопасности:

⚠	До начала работ внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации
⎓12В 1,2А	Указаны номинальные значения параметров электропитания

https://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство распространяется на Электрошпатель зуботехнический ЭШЗ-01-«АВЕРОН», ТУ 9452-004-41752545-2001, далее – **ЭШЗ**.

1.2 ЭШЗ предназначен для моделирования воском в стоматологических учреждениях.

1.3 Условия эксплуатации

окружающая температура	10...35°С
влажность при 30°С, не более	80%

1.4 Основные технические характеристики

диапазон температуры	40...220°С
электропитание	⎓ 12В 1,2А
электропитание адаптера	100-240В 50/60Гц
потребляемая мощность, не более	15 Вт
масса блока управления, не более	0,15 кг
масса адаптера, не более	0,15 кг
габариты, без адаптера, не более	65×95×50 мм

1.5 Особенности

Ручка электрошпателя (далее ручка **ЭШЗ**) из твердых пород дерева.

Встроенный нагреватель с термопарой обеспечивают точную температуру.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Остерегайтесь прикосновения к нагретой насадке и попадания расплавленного воска на кожу.

Исключите касания разогретой насадкой кабеля ручки **ЭШЗ** и провода блока питания.

Не разбирайте ручку **ЭШЗ**.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1 - Блок управления с ручкой **ЭШЗ (2)** и сменной насадкой **(3)** НС 5.0 НЬЮ "лопатка прямая"
4 - Блок питания
5 - Ключ для снятия насадок
6 - Кольцо силиконовое

Руководство по эксплуатации АВЕ 045.000.000.1 РЭ.

Поставка по дополнительной заявке:
☒ - Насадка НС х.0 НЬЮ








Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

4 ПОДГОТОВКА

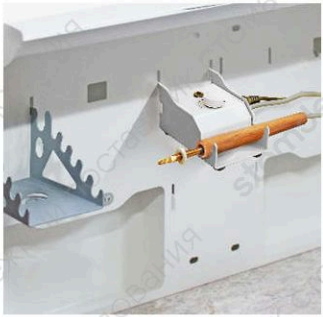

- Разместите блок управления **(1)** на ровной горизонтальной поверхности или навесьте на гнезда с шагом 60 мм передней панели СЗТ с помощью зацепов.
- Соедините блок управления с блоком питания **(4)**.

ВНИМАНИЕ!

Обеспечьте надежный контакт блока питания с сетевой розеткой.

5 РАБОТА

- Включите блок питания в сетевую розетку.
- Нагрев отображается светодиодом:

- красный – идет нагрев;
- зеленый – установилась заданная температура.

- Задайте температуру вращением ручки регулятора:

- по часовой стрелке – увеличение температуры;
- против часовой стрелки – уменьшение температуры.

- По окончании работ отключите блок питания от сетевой розетки.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование **ЭШЗ** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.
Условия транспортирования: температура от минус 40 до 50°С, относительная влажность до 100% при температуре 25°С.

6.2 ЭШЗ должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах при температуре от минус 40 до 40°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С. Не допускается хранение **ЭШЗ** совместно с кислотами и щелочами.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку корпуса **ЭШЗ** производите отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором, или жидкостью, растворяющей воск, кроме лицевой наклейки (при наличии). Не допускайте попадания жидкости внутрь **ЭШЗ**. По окончании очистки - протрите сухой мягкой тканью.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

8 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - **60 месяцев** (на блок питания – **12 месяцев**) с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Гарантия не распространяется на ручку **ЭШЗ** и ее кабель.
Средний срок службы - **6 лет**. По истечении срока службы Изготовитель не несет ответственность за обеспечение возможности использования **ЭШЗ** по назначению, включая его безопасность.
Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие Электрошпателя зуботехнического ЭШЗ-01 "АВЕРОН" требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.

8.2 Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

9 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ЭШЗ** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ЭШЗ** не требуется.

10 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечень неисправностей, методы их устранения:

Неисправность	Причины	Методы устранения
Отсутствие индикации и нагрева насадки ручки **ЭШЗ**	Блок питания ненадежно подключен к сети	Проверить надежность подключения
	Неисправный блок питания	☎
	Поврежден/неисправен кабель блока питания	
	Неисправный блок управления	

Примечание ☎ - если дефект не устранен, то обратитесь к продавцу или в ближайшее представительство АВЕРОН

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО" www.averon.ru
Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,
г.Екатеринбург, ул.Фурманова, д.127, пом. 1,
тел.: +73433111121 feedback@averon.ru
Адрес производства: 620902, Екатеринбург, Николы Тесла, стр.4
бесплатный звонок по РФ: 88007001220
Сервис-центр:
бесплатный звонок по РФ 88007001102

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ЭШЗ 1.1 СТАРТ	Зав.номер
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Мобильное Приложение АВЕРОН:

для Android	для iOS	для Huawei
ДОСТУПНО В Google Play	ДОСТУПНО В App Store	ДОСТУПНО В APPGALLERY

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ