stomdevice

АВЕРОН

ЭЛЕКТРОШПАТЕЛЬ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ
с установкой температуры и сменными насадками
ЭШЗ-01-«АВЕРОН



Руководство по эксплуатации
АВЕ 459.000.000 РЭ
1.3

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство распространяется на Электрошпатель зуботехнический с установкой температуры и сменными насадками ЭШ3-01-"АВЕРОН" – рег. удостоверение №ФСР 2009/05430 от 30.07.2009, ТУ 9452-004-41752545-2001, ОКП 945220. 1.3, далее – **ЭШ3**.

1.2 ЭШ3 предназначен для выполнения моделировочных работ различными видами восков, в том числе в стоматологических учреждениях.

1.3 ЭШ3 обеспечивает поддержание заданной температуры ручки-насадки моделировочного ножа при колебаниях напряжения сети.

1.45 Условия эксплуатации

окружающая температура	10...35°С
влажность при 30°С, не более	80%

1.5 Основные технические характеристики

диапазон задаваемых температур ручки-насадки моделировочного ножа	40…220°С
электропитание	~100-240В 50/60Гц 0,14А
потребляемая мощность	12 ВА
режим работы	продолжительный
масса блока управления, не более	0,2 кг
габариты блока управления, не более	80×65×120 мм

Нанесенная маркировка по безопасности:


- До начала работ внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации


- Изделие класса II

https://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Остерегаться прикосновения к нагретой ручке-насадке и попадания расплавленного воска на открытые участки кожи.

При размещении ручки-насадки исключить возможность касания разогретым наконечником сетевого провода.

Запрещается разбирать ручку-насадку и вставлять ее в вентиляционные щели блока управления.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ (рис.1)

1 - Блок управления - 1 шт

2 - Моделировочный нож с несъемной ручкой-насадкой и кабелем (разъем "тюльпан") **РШ 5.1** - 1 шт

3 - Подставка ПН 2.1 БЛЕСК - 1 шт

Руководство по эксплуатации АВЕ 459.000.000 РЭ

✉ - Моделировочный нож с другой формой наконечника рабочей части сменной ручки-насадки РШ х.1 рис.3

✉ - Вискозная губка БЛЕСК 2.1

Примечание:
✉ - поставка по дополнительной заявке

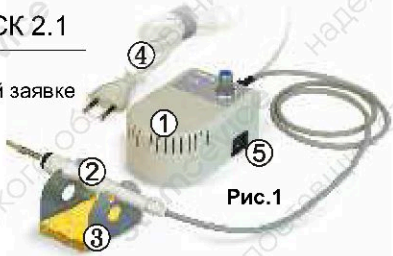


Рис.1

Внимание !

Для лучшего результата используйте **влажную** губку БЛЕСК 2.1.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

4 ПОДГОТОВКА

4.1 Разместить **ЭШ3** на ровной, устойчивой горизонтальной поверхности, обеспечив свободный доступ к его органам управления, индикации, разъемам, а также сетевой розетке.
4.2 Подключить разъем кабеля РШ х.1 к соответствующему разъему на блоке управления.

5 РАБОТА

5.1 Подключить сетевой шнур **(4)** к розетке ~220/230В 50/60Гц (см. Меры безопасности).
5.2

- Включение/выключение – сетевым выключателем I/0 **(5)**.
- Включение нагрева отображается светодиодом T°C **(6)**, рис.2.
  - не светится (не мигает) – нагрев выключен, ручка **(7)** в крайнем левом положении,
  - при включенном нагреве – кратковременно светится после подключения к сети, а также увеличения температуры ручкой **(7)**, или мигает при поддержании заданной температуры.
  Частота мигания увеличивается с ростом заданной температуры.



Рис.2

- Задание температуры - вращением ручки **(7)**:
  по часовой стрелке – увеличение температуры,
  против часовой стрелки – уменьшение температуры.

https://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

5.3 По окончании работ выключить **ЭШ3**. При длительных перерывах в работе отключить **ЭШ3** от сетевой розетки.

5.4 ЭШ3 по дополнительной заявке доукомплектовывается РШ х.1 (рис. 3) с нужной формой наконечника рабочей части сменной ручки-насадки. Нагреватель насадки размещен непосредственно у рабочей части, что исключает перегрев ручки моделировочного ножа. Возможна работа с ручками-насадками МОДЕЛЛЕР М 1.1…9.1 от устройств серии МОДИС при использовании **переходника РНМ 1.0 МОДИС** (поставка по дополнительной заявке).



Рис.3 Форма насадок РШ х.1

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование **ЭШ3** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.
Условия транспортирования: температура от минус 40 до 50°С, относительная влажность до 100% при температуре 25°С.

6.2 ЭШ3 должно храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 40 до 40°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С. Не допускается хранение **ЭШ3** совместно с кислотами и щелочами.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку корпуса **ЭШ3** производить отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором, или жидкостью, растворяющей воск. Не допускать попадания жидкости внутрь **ЭШ3**. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

8 ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие Электрошпателя зуботехнического с установкой температуры и сменными насадками ЭШ3-01-"АВЕРОН" требованиям действующей технической документации в случае соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.



Гарантийный срок - 60 месяцев с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Срок службы - не менее 6 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **ЭШ3**.

Гарантия не распространяется на моделировочный нож с несъемной ручкой-насадкой и кабелем **РШ 5.1**.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену **ЭШ3** в течение

https://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

гарантийного срока эксплуатации по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего руководства, копии документа, подтверждающего покупку (чек, платежное поручение), а также изделия в ЧИСТОМ виде и комплектации:

- для замены – согласно покупной комплектации, в упаковке Изготовителя;
- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

Гарантийный и постгарантийный ремонт в первую очередь осуществляется Поставщиком или в ближайших сервисных представительствах АВЕРОН.

Доставка оборудования для ремонта производится владельцем за свой счет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Электрошпателя зуботехнического с установкой температуры и сменными насадками ЭШЗ-01-"АВЕРОН" требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

	1.3
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ