stomdevice

ЭЛЕКТРОШПАТЕЛЬ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ ЭШЗ-01-«АВЕРОН»

2.1 НЬЮ



РУ №ФСР 2009/05430 30.01.2024

Руководство по эксплуатации
АВЕ 622.000.001 РЭ

Нанесенная маркировка по безопасности:

⚠	До начала работ внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации
⎓ 12В 1,2А	Указаны номинальные значения параметров электропитания

https://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство распространяется на Электрошпатель зуботехнический ЭШЗ-01-«АВЕРОН», ТУ 9452-004-41752545-2001, далее – **ЭШЗ**.

1.2 ЭШЗ предназначен для моделирования воском в стоматологических учреждениях.

1.3 Условия эксплуатации

окружающая температура..... 10...35°С
влажность при 30°С, не более.....80%

1.4 Технические характеристики

диапазон температуры .....40…220°С
дискрет индицируемой температуры .....1°С
электропитание ..... ⎓ 12В 1,2А
электропитание адаптера ..... 100-240В 50/60 Гц
масса блока управления.....0,2 кг
габариты блока управления, не более .... 85×80×55 мм
индикация ..... цифровая
режим работы.....продолжительный

1.5 Особенности

Ручка электрошпателя (далее ручка **ЭШ**) из твердых пород дерева. Встроенный нагреватель с термопарой обеспечивают точную температуру.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Остерегайтесь прикосновения к нагретой насадке и попадания расплавленного воска на кожу.
Исключите касания разогретой насадкой кабеля ручки **ЭШ** и провода блока питания.

http://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ (рис.1)

1 - Блок управления с ручкой **ЭШ** - 1 шт
2 - Блок питания - 1 шт
3 - Съемная насадка НС 5.0 НЬЮ "лопатка прямая" - 1 шт
4 - ПОДСТАВКА 2.0 МОДИС с вискозной губкой БЛЕСК 1.0 КЕРАМИКА **(5)** - 1 шт
6 - Ключ для снятия насадок - 1 шт
7- Кольцо силиконовое – 1 шт.
Руководство по эксплуатации АВЕ 622.000.001 РЭ



Рис.1 НС 5.0 НЬЮ

✉ - Насадка НС х.0 НЬЮ - поставка по дополнительной заявке

ВНИМАНИЕ!
Для очистки насадки используйте **влажную** губку БЛЕСК 1.0 КЕРАМИКА.
Меняйте насадки только в горячем состоянии.
Для смены насадки НС х.0 НЬЮ пользуйтесь ключом для снятия насадок.
При необходимости подожмите насадку, сняв ее.


4 ПОДГОТОВКА

- Установите съемную насадку **(3)** в ручку **ЭШ**. Кольцо силиконовое **(7)** препятствует стеканию воска на стык насадки **(3)** и нагревательного стержня ручки **ЭШ.**
- Подключите кабель блока питания **(2)** к разъему блока управления **(1)**.
- Включите блок питания **(2)** в сетевую розетку.
- На индикаторе кратковременно отобразится версия ПО, затем справа внизу высветится точка [.] – признак «***ждущего***» режима (напряжение на нагреватели не подается).

ВНИМАНИЕ!

Обеспечьте надежный контакт блока питания с сетевой розеткой.

5 РАБОТА

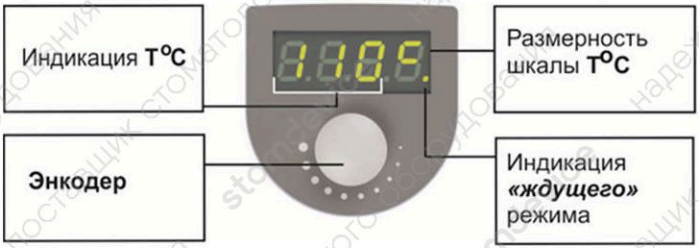

- Для перехода в «рабочий» режим нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку энкодера.
- На индикаторе установленная ранее температура (первоначальная заводская установка 40°С).

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

http://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

- Нужная температура задается поворотом энкодера.
- При быстром повороте на 90° включается автоматическое изменение температуры.
- Для остановки набора поверните энкодер в противоположную сторону.
- Символ «^{C}» - нагрев или охлаждение насадки.
- Постоянно светится «^{C}» - измеренная температура насадки равна заданной.
- Мигание [.] - включение/выключение нагрева.
- Для просмотра измеренной температуры нажмите кнопку энкодера.
- Возврат к заданной температуре – нажатием на кнопку энкодера или через 10 секунд автоматически.
- «Три прочерка» - отказ датчика температуры.
- Для перехода из «***рабочего***» в «***ждущий***» режим нажмите и удерживайте энкодер.
- По окончании работ выключите **ЭШЗ**.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование **ЭШЗ** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.
Условия транспортирования: температура от минус 40 до 50°С, относительная влажность до 100% при температуре 25°С.

6.2 ЭШЗ должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах при температуре от минус 40 до 40°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С. Не допускается хранение **ЭШЗ** совместно с кислотами и щелочами.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку корпуса **ЭШЗ** производите отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором, или жидкостью, растворяющей воск. Не допускайте попадания жидкости внутрь **ЭШЗ**. По окончании очистки - протрите сухой мягкой тканью.

8 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - **60 месяцев** (на блок питания – **12 месяцев**) с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Средний срок службы - **6 лет**.

Гарантия не распространяется на ручку **ЭШ** и ее кабель.

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие Электрошпателя зуботехнического ЭШЗ-01 "АВЕРОН" требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.

8.2 Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **ЭШЗ**.

8.3 Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

http://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

9 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ЭШЗ** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ЭШЗ** не требуется.

10 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечень неисправностей, методы их устранения.

Неисправность	Причины	Методы устранения
Отсутствие индикации и нагрева насадки ручки **ЭШ**	Блок питания ненадежно подключен к сети	Проверить надежность подключения
	Неисправен блок питания	☎
	Поврежден/неисправен кабель блока питания	
	Неисправен блок управления	

Примечание ☎ - если дефект не устранен, то обратитесь к продавцу или в ближайшее представительство АВЕРОН

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Электрошпателя зуботехнического ЭШЗ-01-"АВЕРОН" требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

2.1 НЬЮ	Зав.№
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО" www.averon.ru
Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,
тел.: +73433111121 feedback@averon.ru
Адрес производства: 620902, Екатеринбург, Ник. Тесла, стр.4
бесплатный звонок по РФ: 88007001220
Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ 88007001102

http://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ