stomdevice

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛЮКС 1.0 МИНИ НЬЮ

Руководство по эксплуатации АВЕ 628.000.000 РЭ

Сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.АЛ16.В.06987 от 29.09.2015

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного ЛЮКС 1.0 МИНИ НЬЮ (далее – ЛЮКС), ТУ 3461-050-52331864-2015.

ЛЮКС предназначен для освещения рабочего места при технических лабораторных и паяльно-монтажных работах, наладке и ремонте оборудования.

1.2 Особенности

- многофункциональный светодиодный светильник для общего освещения рабочего места зубного техника;
- адаптирован для столов МАСТЕР, МАСТЕР МИНИ;
- возможность изменения интенсивности и направления освещения за счет перемещения плафона в горизонтальной плоскости вперед/назад с перемещением выдвижного ящика;
- светодиодная лампа с цоколем 2G11 обеспечивает освещенность на рабочей поверхности до 3400 лк и цветовую температуру 5000 К (нейтральный белый цвет);
- развитая система хранения: лоток, выдвижной ящик, полка над ящиком, предподготовка для установки КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК, магнит под основанием - для крепления инструментов;
- предподготовка для установки точечного светильника ЛЮКС 2.1 с гибким кронштейном для локальной подсветки рабочей зоны;
- возможность крепления к стене кронштейном из комплекта поставки;
- установка на горизонтальную поверхность столешницы с использованием СТРУБЦИНА 1.1/2.0 с держателем инструмента, поставка по дополнительной заявке.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10-35ºС
- влажность при 25ºС, не более 80%

2.2 Основные технические характеристики

- электропитание ..... ~220 В 50 Гц
- максимальная потребляемая мощность, не более..... 32 ВА
- цветовая температура..... 5000 К
- габариты, не более ..... 665×670×680 мм
- масса, не более..... 8,0 кг
- толщина столешницы при использовании СТРУБЦИНА 1.1/2.0 ..... до 42 мм

feedback@averon.ru https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ www.averon.ru

stomdevice


3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1 – Плафон – 1 шт
2 – Основание с выдвижным ящиком **(б)** и крышкой **(а)***
3 – Стойка-труба (Ø= 25 мм L~ 600 мм) – 1 шт
4 – Фальшпланка -1 шт
5 – Скоба для стойки – 2 шт
6 – Накладка боковая – 2 шт
7 – Лоток – 1 шт
8 – Уголок – 1 шт
9 – Кронштейн для крепления к стене – 1шт


Крепеж: винт М 4х20 – 4 шт; гайка-барашек М4 – 4 шт; шайба 4 – 4 шт,

Руководство по эксплуатации АВЕ 628.000.000 РЭ

☒ - КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК
☒ - СТРУБЦИНА 1.1

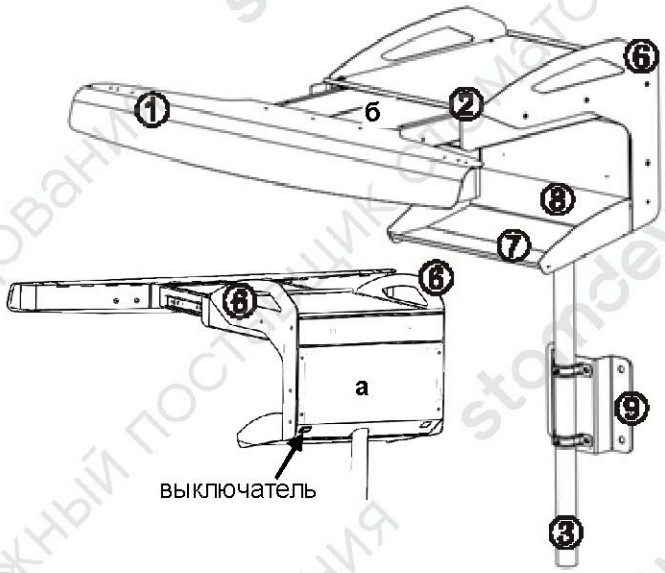

☒- поставка по дополнительной заявке
* - установлены по месту

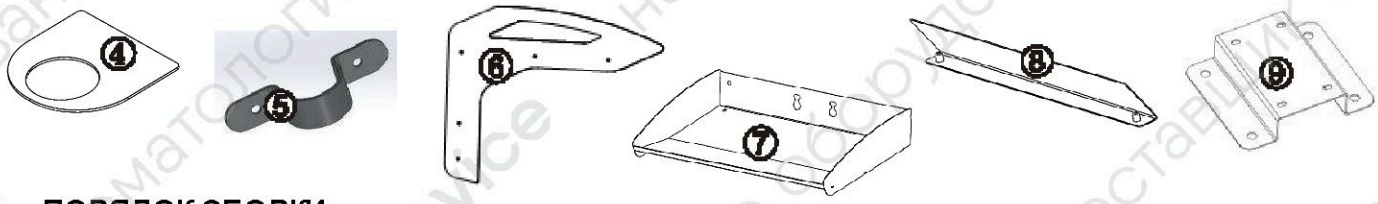

4 ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Распаковать. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.
Выдержать при комнатной температуре 4 часа, если находился в холоде.

ВНИМАНИЕ! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не допускать переломов, зажимов и других повреждений сетевого шнура при сборке.


Выполнение работ по электромонтажу - электротехническим (электротехнологическим) персоналом, имеющим III группу электробезопасности по ПОТР М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).


4.2 Снять крышку **(а)** с основания **(2)**, крепится на 4 самореза, и декоративный уголок **(в)** – крепится на 2 самореза, расположенных изнутри основания.

Установить стойку **(3)** на основание **(2)** с выдвижным ящиком, зафиксировав скобами. Нижняя скоба одновременно фиксирует лоток **(7)**, дополнительно зафиксировать его двумя винтами М3х8 к задней стенке.

Установить и зафиксировать к лотку **(7)** уголок **(8)** двумя винтами М3х8 снизу.

4.3 Установить и закрепить декоративный уголок **(в)**, накладки боковые **(6)**, крышку **(а)**.

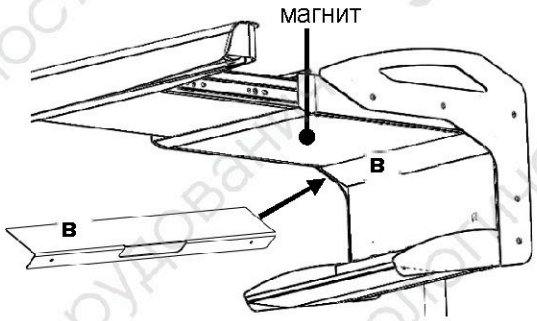

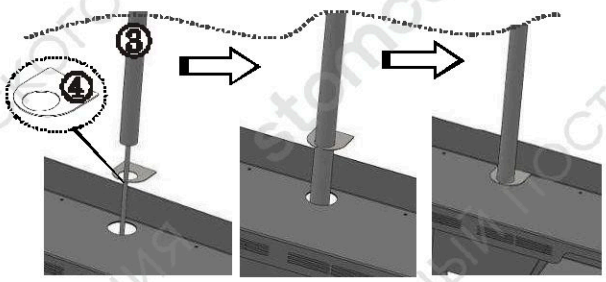

4.4 На верхней полке СЗТ(СУЛ) удалить заглушку (при наличии).


Через фальшпланку **(4)** опустить стойку **(3)** в открывшееся отверстие, **не защемляя сетевой шнур**.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4.5 Выставить нужное положение ЛЮКС по высоте и затянуть винты скоб **(5)** на задней стенке СЗТ. Максимальная высота – при совмещении нижних краев стойки и нижней скобы СЗТ.

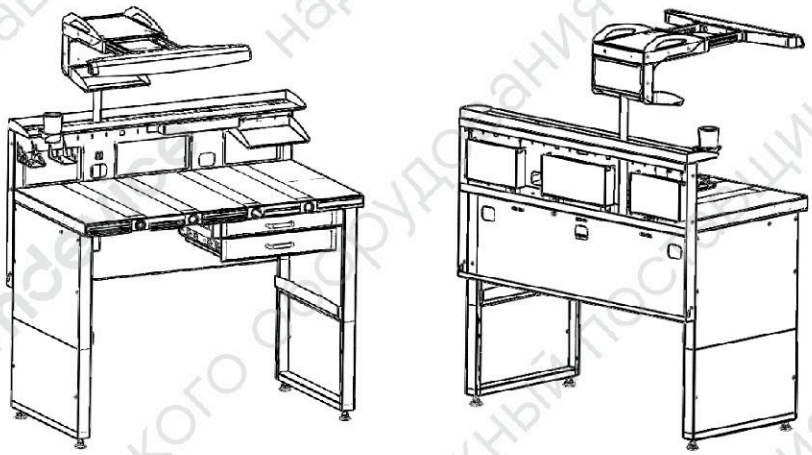

Пример установки ЛЮКС на СЗТ 4.3 МАСТЕР

5 РАБОТА

Подключить сетевую вилку ЛЮКС к источнику электропитания.

Для удобства в работе возможно крепление держателя лотков до 2-х шт. КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК.

Отключать сетевую вилку ЛЮКС от источника электропитания при длительных перерывах.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание проводить после отключения ЛЮКС от сети.

Замена ламп:



7 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛЮКС не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛЮКС не требуется.

8 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца (для лампы – 6 месяцев) с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности ЛЮКС.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации.

Исправления не допускаются

ЛЮКС 1.0 МИНИ НЬЮ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ