stomdevice

НОЖ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов НТ-01 «Аверон»

Рег. удостоверение №ФСР 2009/05819 от 06.10.2009

Руководство по эксплуатации АВЕ 240.000.000 РЭ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Нож термоэлектрический для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов НТ-01 «Аверон», ТУ 9452-029-25014322-2004, ОКП 945220, 5.0 (далее - **НТ**).

1.2 НТ предназначен для:

- срезания пучков гуттаперчевых штифтов в области устья канала с возможностью конденсации;
- срезания центрального пластмассового штифта при работе с термопластической гуттаперчей;
- локальной, неглубокой гингивотомии при кариозных полостях II класса, тотально разрушенных коронках зубов.

Поставщик стоматологическое и зуботехническое оборудование по ставкам по России и СНГ

1.3 Особенности

- быстрая смена насадок;
- малые вес и габариты;
- питание от сети переменного тока.

1.4 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°С
- влажность при 25°С, не более 80%

1.5 Основные технические характеристики

- электропитание ~220/230В 50/60Гц 200мА
- масса, не более
  - ручки ножа 80 г
  - блока питания 600 г
- габариты блока питания, не более 65×100×95 мм

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	шт
• блок питания ~220/+12В	1
• ручка ножа	1
• насадка сменная **НАСАДКА 1.0 У НТ** (узкая 1,3 мм)	2

Руководство по эксплуатации АВЕ 240.000.000 РЭ

Нанесенная маркировка по безопасности:


- До начала работ внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации


- Рабочая часть типа В


- Изделие класса II

stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Проверять перед работой надежность установки насадки в ручку.


Остерегаться прикосновения к нагретой части насадки.

4 УСТРОЙСТВО

1 – блок питания
2 – ручка ножа
3 – насадка сменная
4 – кнопка включения/выключения
5 – светодиод для подсветки рабочей части



НАСАДКА 1.0 У НТ

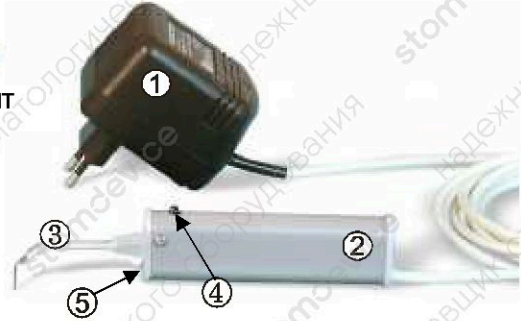

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Подготовка

Установить насадку **(3)** в ручку **(2)**.

ВНИМАНИЕ! **РЕКОМЕНДАЦИИ**

Для надежной фиксации насадки (при износе, усталости контактов в ручке или ослаблении фиксации по другим причинам) слегка подогнуть контакты.

5.2 Работа

- подключить блок питания **(1)** к розетке ~220/230В 50/60Гц;
- нагрев включается на время удержания кнопки **(4)** на ручке **(2)**, при этом загорается светодиод **(5)**;



- по окончании работ отсоединить **НТ** от сети.

5.3 Предупреждения и рекомендации

Не деформировать рабочую часть насадки во избежание ее обрыва.

ВНИМАНИЕ!

Изделие укомплектовано блоком питания с диаметром штырей евровилки 4 мм. Необходим контроль надёжности контакта вилка-розетка, особенно, после включения в эту розетку вилок с более толстыми штырями.
Повторное включение не ранее, чем через 1 мин.

stomdevice

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование **НТ** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.
Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50°С, относительная влажность до 100% при температуре 25°С.
6.2 **НТ** должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С. Не допускается хранение **НТ** совместно с кислотами и щелочами.

7 ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Методы дезинфекции, стерилизации съемных насадок – химические, по МУ 287-113-00.
Очистку корпуса **НТ** производить отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Не допускать попадания жидкости внутрь **НТ**. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

8 ГАРАНТИИ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие Ножа термоэлектрического для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов НТ-01 «Аверон» требованиям технической документации в случае соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему руководству.

Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

8.2 Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 6 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **НТ**.

Гарантия не распространяется на сменные насадки.

8.3 Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного изготовителем доступа в конструкцию.

8.4 Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену продукции в течение гарантийного срока эксплуатации, при выполнении п.п.8.1, 8.3, по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего Руководства или копии документа, подтверждающих покупку (чек, платежное поручение) и комплектацию продукции, предоставляемой:
- для замены – согласно покупной комплектации;
- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования

stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург
Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»
www.averon.ru feedback@averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02

Полный перечень авторизованных сервисных представительств и центров, осуществляющих гаратийное и постгарантийное обслуживание, а также ремонт оборудования АВЕРОН, приведен на сайте АВЕРОН:
https://www.averon.ru/service/servise_centr/.



Интернет-магазин стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Ножа термоэлектрического для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов НТ-01 «Аверон» требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

	5.0
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Copyright © stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ