stomdevice

Инструкция
по замене графитовых щеток
в двигателе НВХ-Д (HWX-D)
для
УПЗ 5.0 АРТ, УПЗ 7.2 КОМБИ,
ВМУ 3.2 БАЗИС, ВМУ 2.0 МАСТЕР НЬЮ,
СЗТ 3.0 ДРИМ/ДРИМ ЭКО,
ВМУ 1.0 КОМПЛИТ

АВЕ 592.100.000 И2

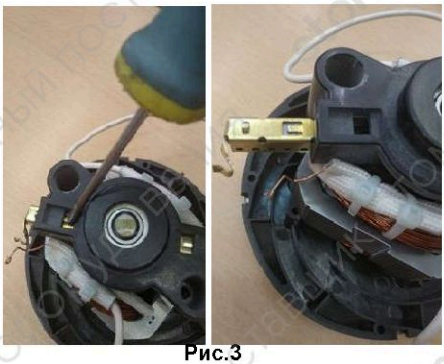
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Замена изношенных щеток в двигателе НВХ-Д (HWX-D)
обязательно производится парно

1. Извлечь двигатель из корпуса изделия, рис.1
2. С помощью инструмента (отвертки или др.) отсоединить обойму щетки от провода, рис.2.
3. Нажать отверткой на язычок защелки и извлечь щетку из держателя, рис.3.


Рис.1


Рис.2


Рис.3

4. Обязательно произвести чистку коллектора двигателя от продукта износа щеток, рис.4.
5. Сборку производить в обратном порядке: установить в держатель новую щетку, надавить до характерного щелчка, рис.5.
6. Инструментом обжать провод в обойме щетки, добиться надежного контакта, рис.6.
7. Установить двигатель в изделие и проверить работоспособность.


Рис.4




Рис.5


Рис.6

