stomdevice

СТУЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА
модель СТУЛ 1.1 МАСТЕР



Этикетка
АВЕ 484.000.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.ОС13.В.00482 от 25.03.2016

многофункциональный стул
со встроенным тренажером и отсеками для хранения

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления недопускаются

модель СТУЛ 1.1 МАСТЕР	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Стула зубного техника модель **СТУЛ 1.1 МАСТЕР** (далее – стул). ТО 5621-39-52331864-2016, ТН ВЭД ТС 9403 10 580 9.

1.2 Стул предназначен для укомплектования автономного рабочего места зубного техника.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35°С
- влажность при 25 °С, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- габариты, не более ..... 630×600×920 мм
- ширина сиденья ..... 440 мм
- глубина сиденья ..... 400 мм
- высота сиденья ..... 500-570 мм
- максимальная нагрузка ..... 110 кг
- масса, не более ..... 8,5 кг

1.5 Особенности

- компактный, мобильный – легко перемещается на колесах;
- встроенный тренажер для выполнения упражнений, снимающих утомление;
- на задней стенке карманы, позволяющие убирать лишние вещи из рабочей зоны;
- ручки эспандера можно убрать в нижний задний карман или повесить на зацепы.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	шт
1 – сиденье со спинкой	- 1
2 – крестовина	- 1
3 – колесная опора	- 5
4 – пневмолифт с регулировочной ручкой **(5)**	- 1
6 – эспандер с хомутами	-1
8 – опорная площадка	-1

Этикетка АВЕ 484.000.000 ЭТ







Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

3 ПОРЯДОК СБОРКИ


Во избежание перекосов стул собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.

I Собрать крестовину: вставить ножки в основание и зафиксировать винтами. Прикрепить колесные опоры к крестовине.

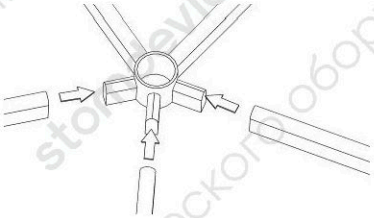

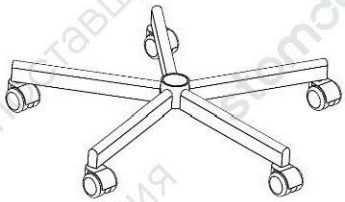

II Прикрепить пневмолифт, установив его основание в отверстие крестовины

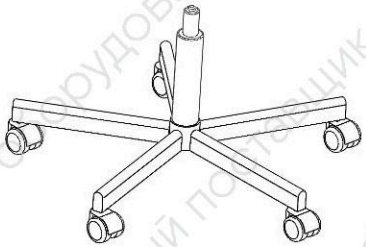

III УСТАНОВИТЬ

- эспандер **(6)** снизу сиденья и зафиксировать хомутами вокруг задних выступов крепления опорной площадки **(8)**, рис.а;
- опорную площадку **(8)** на четырех выступах снизу сиденья, рис.б;
- сиденье на крестовину с пневмолифтом.

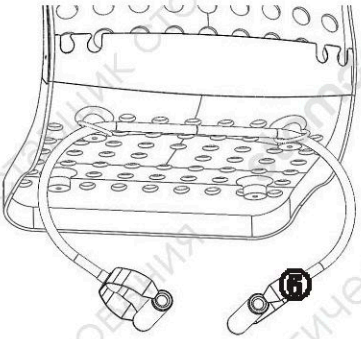


рис.а

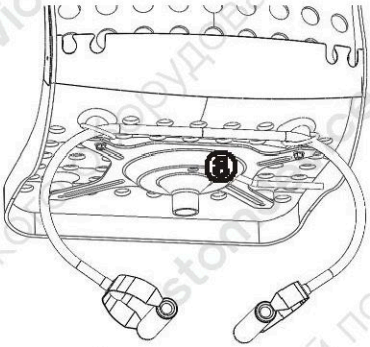


рис.б

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Высота сиденья регулируется с помощью ручки пневмолифта.

При необходимости, убрать из рабочей зоны и разместить в карманах **(7)** не используемые в текущей работе инструменты, материалы и др.

Для снятия утомления при длительных работах рекомендуется выполнить комплекс разминочных упражнений.

Видеокурс с упражнениями, разработанными специально для выполнения на СТУЛ 1.х МАСТЕР, смотрите на странице «Рабочие места и принадлежности/Столы зубного техника/СТУЛ 1.1 МАСТЕР» (вкладка «Видео») на сайте **www.averon.ru**.



ВНИМАНИЕ!
Соблюдать осторожность при пользовании эспандером – следить за исправностью, не прилагать излишних усилий во избежание травм.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02