stomdevice

СТОЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА модель СЗТ 4.2 МАСТЕР

Декларация о соответствии
ТС N RU D-RU.АИ16.В.02124 от 30.07.2015

Этикетка
АВЕ 401.000.000 ЭТ

Стол зубного техника модель СЗТ 4.2 МАСТЕР (далее – **СЗТ**) предназначен для оснащения индивидуального рабочего места зубного техника и может использоваться в зуботехнических и литейных лабораториях стоматологических учреждений. ТО 5621-39-52331864-2015, ТН ВЭД 9403105800.

СЗТ 4.2 МАСТЕР может доукомплектовываться:
- светильником ЛЮКС НЬЮ, ЛЮКС ЛИНЗА
- ПОЛКОЙ 1.1 БРИДЖ/ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ для эффективного использования пространства между двумя **СЗТ**
- вытяжным модулем ВМУ 3.1 БАЗИС (СТАРТ)
- подкатной тумбой с ящиками ТУМБА 1.1 М (либо от ИКЕИ)
- модулем выдвижных ящиков со встроенным вытяжным модулем КОМПЛЕКТ 1.0 М
- блоком регулятора мощности БРМ 2.1 ВМУ
- электроблоком на 5 розеток с заземлением ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 (общий выключатель с индикацией, защита от превышения нагрузки, фильтр помех, максимальный ток 10 А)

Особенности:
- столешница из постформинга, остальное – из металла с полимерным покрытием;
- универсальность – левое или правое размещение (по выбору потребителя):
  - ВМУ 3.1 БАЗИС и КОМПЛЕКТ 1.0;
  - тумбы с ящиками (АВЕРОН) под столешницей;
  - светильников ЛЮКС НЬЮ, ЛЮКС ЛИНЗА;
  - подлокотников и финагеля;
  - переставляемого съемного мобильного наклонного лотка;
- «карманы» в боковых стойках, с внутренней стороны, для хранения предметов, инструментов или документов;
- стационарная полка в длину столешницы;
- большой встроенный отсек (глубина 50 мм) на вертикальной панели для хранения инструментов.

Условия эксплуатации
- окружающая температура ..... 10...35°С
- влажность при 25 °С, не более 80%

Основные технические характеристики
- габариты **СЗТ**, без подлокотников ..... 1150×836×1126 мм
- верх столешницы от пола ..... 850 мм
- масса, не более ..... 65 кг
- максимальная нагрузка ..... 120 кг

Комплектность согласно УПАКОВОЧНОМУ ЛИСТУ АВЕ 401.000.000 Д2.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

УСТРОЙСТВО

(рис.1,2, см. позиции Упаковочный лист)

1 – левая/правая боковая стойка
2 – столешница
3/3А – нижняя и верхняя перекладина для хранения инструментов, документов
4 – УПОР 2.0 ЭЛАСТИК (подлокотники и финагель)
5 – КОМПЛЕКТ 1.0 модуль выдвижных ящиков
6 – СО 2.0 сопло обдувочное
7 – «карман» для хранения инструментов
8 – ЛОТОК 1.0 МАСТЕР наклонный лоток
9 – электроблок
10 – задняя многофункциональная стенка с окнами для проводов
11 – коврик износостойкий
12 – полка верхняя
13 – светильник ЛЮКС НЬЮ* (✉)
14 – модуль вытяжной ВМУ 3.1 БАЗИС* (✉)
15 – комбинированная подвесная подставка
16 – места крепления светильника ЛЮКС НЬЮ* **(13)** (✉)
17 – места крепления светильника ЛЮКС ЛИНЗА* (✉)
18 – подставка для пульта бормашины с магнитами
19 – стакан
20 – фальшпанель
21 – емкость для мелкого мусора

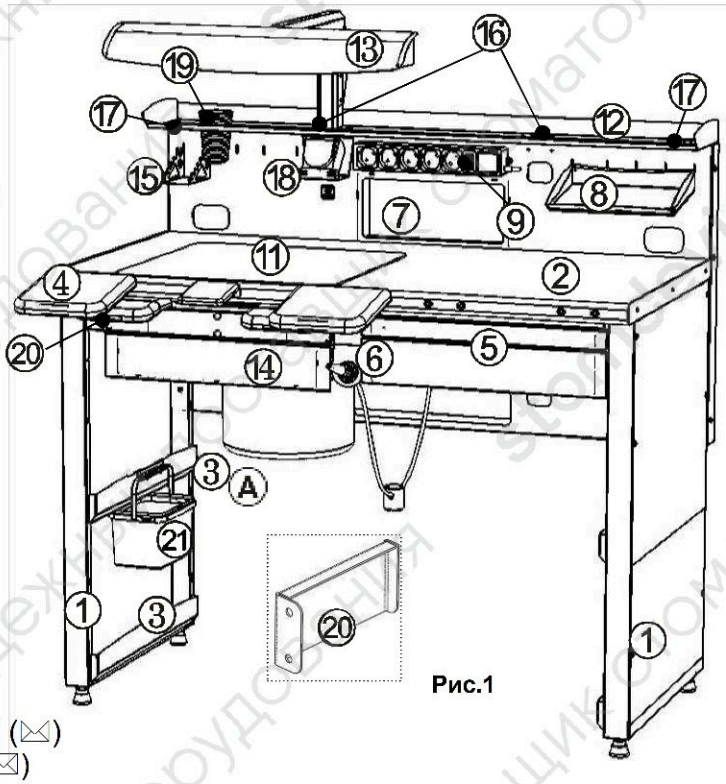


Рис.1

* - поставка по дополнительной заявке (✉)

Коврик **(11)** защищает поверхность столешницы **(2)** от истира
бормашиной.

Подставка **(18)** предназначена для удобного размещения пуль

За прорезями на подставке **(18)** закреплены дисковые маг
размещения и быстрого фиксирования/снятия используем
инструмента и т.д. При необходимости, возможно перемещени

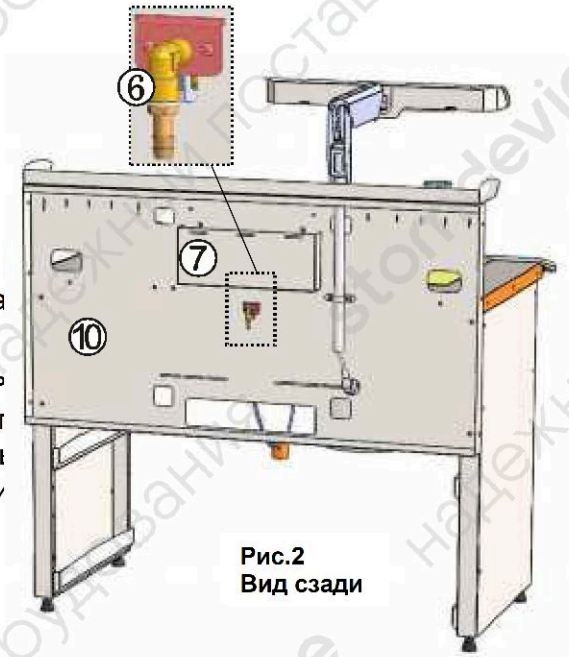


Рис.2
Вид сзади

Внимание! **Предупреждение**

Перед сборкой рекомендуется (см. рис.3) разместить столешницу нижней стороной вверх на любой устойчивой подставке с ровной горизонтальной поверхностью (например, ящик, тумба).

При переворачивании конструкции во время сборки/разборки не прилагать чрезмерных усилий на стойки, соединенные со столешницей.

Рекомендуется стойки, столешницу, заднюю стенку и др. узлы крепить без затяжки крепежа (наживить). После состыковки всех деталей провести окончательную протяжку креплений.

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).


Рис.3

stomdevice

ПОРЯДОК СБОРКИ

Во избежание перекосов СЗТ собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.

Выполнить последовательно операции I-VII, см. рисунки ниже.


Крепеж, кроме саморезов, установлен по месту. На нижней плоскости столешницы нанесена разметка - сверления для соответствующих деталей.

УСТАНОВИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ:

Ⓘ

правую, левую стойки **(1)** к столешнице **(2)**

саморезы 4,5х30

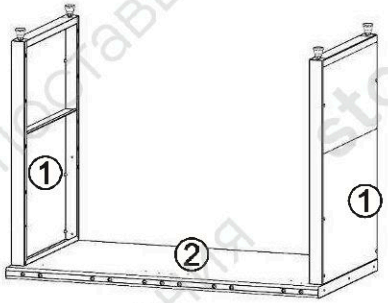


Ⓘⓘ

заднюю стенку **(10)** к стойкам

винты М5х10

к торцу столешницы

саморезы 4,5х30

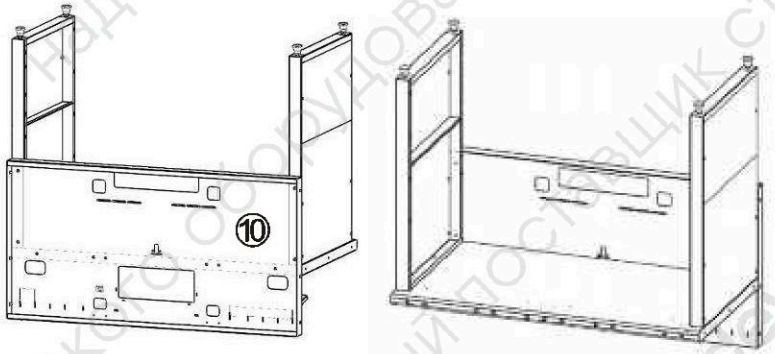


Ⓘⓘⓘ

раму КОМПЛЕКТ 1.0 **(5)** снизу столешницы

крепеж из его комплектности

фальшпанель **(20)** снизу столешницы


саморезы 3,5х13

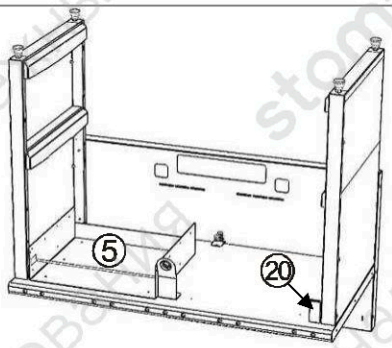

ПРИ НАЛИЧИИ в комплекте


ВМУ 3.1 БАЗИС – раму от ВМУ устанавливать одновременно с рамой КОМПЛЕКТ 1.0;

ВМУ 2.0 – короб воздуховода от ВМУ установить, по разметке у передней кромки столешницы, под передние два самореза.

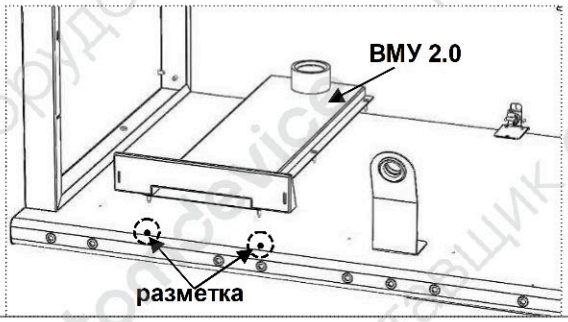

ⓘⓥ

СО 2.0 **(6)** саморезами из его комплекта: уголок с фитингами закрепить в окне на задней стенке стола (завести сзади), уголок с ловителем закрепить снизу столешницы у ее передней кромки.

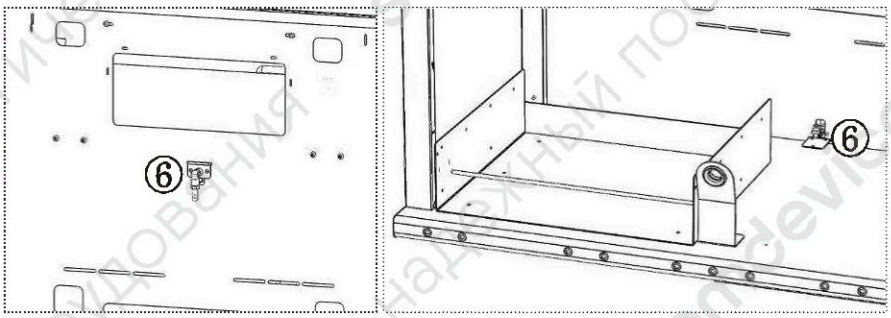


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

V

Перевернуть и установить **С3Т** на стойки, если собирался на подставке (см. Предупреждение). Установить сопло **(6)** в кронштейн и подсоединить пневмотрубку. Подключение – см. Этикетку АВЕ 228.000.000 ЭТ

VI УСТАНОВИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ

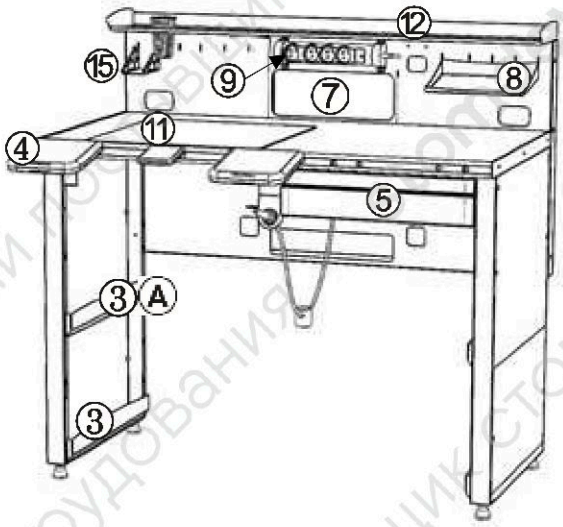

- верхнюю полку **(12)**, винты М5х10;
- электроблок **(9)**, крепеж из его комплектности;
- «карман» **(7)**, одев крючками в соответствующие пазы на задней стенке **(10)**;
- наклонный лоток **(8)** и подставку **(15)**, заведя их крепления в пазы на задней стенке (слева или справа);
- ящики КОМПЛЕКТ 1.0 **(5)** в раму;
- разместить в пазах на боковых стойках перекладины **(3)** и **(3А)** – две на левой, две на правой. Пазы имеют четыре положения по высоте стойки;
- на одну из перекладин надеть зацеп емкости **(21)** для мелкого мусора;
- комплект УПОР 2.0 ЭЛАСТИК **(4)** и положить коврик **(11)** на столешницу.


Отрегулировать вращением ножек устойчивое положение стола.

VII УСТАНОВИТЬ, ПРИ НАЛИЧИИ, см. также рис.1,2



- модуль вытяжной ВМУ 3.1 БАЗИС **(14)**;
- светильник ЛЮКС НЬЮ **(13)** в место **(16)**, слева или справа, для чего удалить металлическую заглушку на торце задней стенки (раскачав ее вверх-вниз);
- светильник ЛЮКС ЛИНЗА в место **(17)**, слева или справа;
- подставку **(18)** для пульта бормашины или другого инструмента (при установке подставки и ЛЮКС НЬЮ, крепление скобы светильника и подставки выполнить совместно одними винтами).

Возможна установка второго электроблока **(22)** (поставка по дополнительной заявке) под столешницей. Для удобства рекомендуется включить его вилку в одну из розеток первого **(9)**, а выключатель оставить в положении «включено» для управления от выключателя первого электроблока. В розетки второго электроблока включить оборудование длительного применения (светильник, вытяжка, бормашина и пр.). Свободные розетки первого электроблока – в рабочей зоне для подключения оборудования временного пользования.

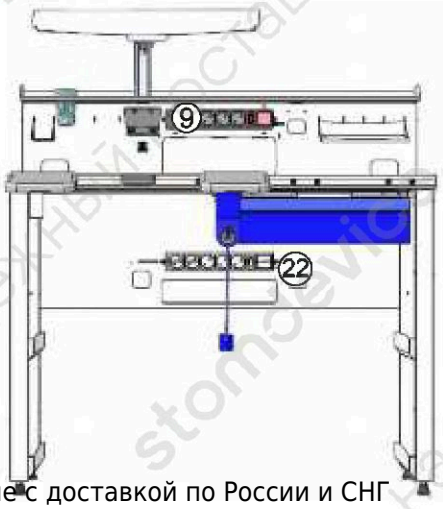

Внимание !

Обесточить электроблок при подключении/отключении оборудования и по завершении работ.

Не допускать воздействия на столешницу и подлокотники абразива, режущего инструмента, а также длительного воздействия влаги.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снаружи несколько **СЗТ** могут соединяться полками БРИДЖ/КОНЕР/ДЕЛЬТА и панелями БРИДЖ, рис.4.

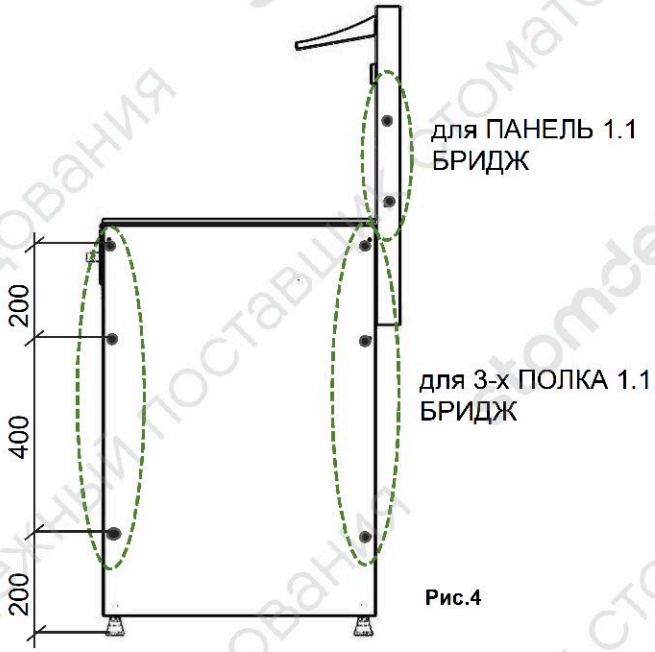


Рис.4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку поверхностей **СЗТ** проводить влажной мягкой тканью (губкой), смоченной в слабом мыльном растворе, при отключенной вилке блока электропитания от сетевой розетки.

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23, бесплатный звонок по России 8 804 333-88-20



Пример размещения столов и оборудования
в зуботехнической лаборатории

stomdevice

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель СЗТ 4.2 МАСТЕР	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ