
stomdevice

РАЗРАБОТКА ВЕГА-ПРО ПРОИЗВОДСТВО

АВЕРОН

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОЗДУШНОГО КАНАЛА модель ВВК 1.0



Этикетка АВЕ 390.000.000 ЭТ

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель ВВК 1.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Выключатель воздушного канала ВВК 1.0 (далее - **ВВК**) предназначен для перекрывания вытяжной магистрали между рабочим местом и вытяжкой. Может использоваться с Устройством пылевсасывающим зуботехническим УПЗ-Бокс-01 «Аверон»*, также с вытяжками других производителей. Предусмотрено использование с гофрированным шлангом (наружный D=42…44 мм), типа ШГВ 1.м АВЕРОН.

1.2 Основные характеристики

Число входов/выходов..... 1/1
Габариты ..... 80×150×85 мм
Внутренний диаметр входа/выхода .... 41 мм
Масса, не более..... 0,5 кг

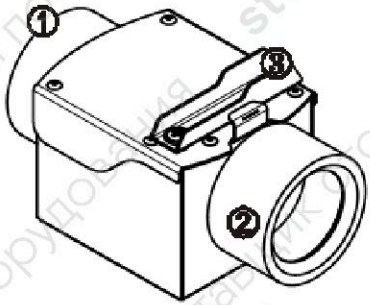


Рис. 1

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Выключатель **ВВК 1.0** 1 шт
Этикетка АВЕ 390.000.000 ЭТ 1 шт

☒ - Поставка по дополнительной заявке
☒ - МАГНИТ 1.0 ДИСК к-т магнитов
☒ - ШГВ 1.м гофрированный шланг

3 УСТРОЙСТВО, РАБОТА (рис. 1)

1 – выход для соединения с входом вытяжки
2 – вход для подсоединения выхода исполнительного устройства (бокс-пылесборник, пылеуловитель и пр.)
3 – ручка управления заслонкой

Для работы включить **ВВК** между вытяжкой и исполнительным устройством, соединив соответствующие шланги с входом **(2)** и выходом **(1)** (до упора). Возможна установка **ВВК** последовательно с переключателем ПВК АВЕРОН или разветвителем РВК АВЕРОН. Возможно крепление к металлической (ферромагнитной) поверхности при помощи МАГНИТ 1.0 ДИСК (поставка по дополнительной заявке).

Для исключения затруднения в открывании/закрывании заслонки из-за накапливания отходов в корпусе **ВВК** рекомендуется располагать его входом **(2)** вертикально вниз. Поворотом ручки **(3)** заслонка перекрывает или открывает выход **(1)**.



4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку корпуса **ВВК** производить продувкой сжатым воздухом и отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Не допускать попадания жидкости внутрь **ВВК**. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия/

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии - согласно его сопроводительной документации.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ