stomdevice

BEING
FOSHAN

инструкция по эксплуатации

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК
модель: Lotus 302 PBQ

Being Foshan Medical Equipment Co., Ltd
Add: 2/Fl., Lihua Building, 2/St., Lianhe Industrial Zone(West), Lucun,
Nanhai District, Foshan, 528226, Guangdong, China

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации нового наконечника необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней.

1.1. Назначение наконечника.



Наконечник турбинный с подсветкой с кнопочной фиксацией бора, с трёхточечным распылителем охлаждающего спрея. Предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) 1,59-1,60 мм и приведении их во вращение при выполнении зубоврачебных работ . Область применения- терапевтическая и ортопедическая стоматология.

1.2 2 Наконечник Lotus "302 PBQ " оснащён жестким световодом для подсветки рабочей зоны, источник света - галогеновая лампа, расположена в быстросменяемом переходнике, поставляемым с наконечником. Соединение с шлангом установки: разъём Midwest с электрическими контактами..

1.3. Технические характеристики:

Рабочее давление воздуха, KPa(kgf/cm)	206 –231(2.1-2.35)
Частота вращения, об/мин	300000-320000
Расход воздуха, л/мин, не более	45
Расход воды, мл/мин, не менее	50
Давление воды, не более KPa(kgf/cm)	198(2)
Рекомендуемая длинна боров, мм:	21-23
Уровень шума, не более dB	70
Интенсивность света, lx	25000
Напряжение питания лампы, V, не более	3.2
Температура паровой стерилизации, C, не более	135



1.4. Правила техники безопасности.

ВНИМАНИЕ! Для установки требуемого инструкцией рабочего давления воздуха, воды для наконечника и напряжения питания лампы подсветки необходимо воспользоваться услугами квалифицированного технического специалиста. Невыполнение этих требований ведёт к поломке изделия!

- Не ронять, не подвергать ударам!
- Не включайте и не храните наконечник без бора или тест-бора.
- Наконечник должен храниться в очищенном, смазанном состоянии.
- Никогда не включайте наконечник с не полностью вставленным бором.
- Не вынимайте и не вставляйте бор во время вращения ротора. Дождитесь его полной остановки .
- Следует пользоваться борами с полусферической частью хвостовика (стандарт ISO 1797) диаметр бора : 1.60-0.01 мм.
- Никогда не отсоединяйте переходник от работающего наконечника.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1.5. Подготовка наконечника к работе.

ВНИМАНИЕ! Запрещается нажимать полностью или частично кнопку фиксации во время вращения бора: как при работе в полости рта, так и начале замены бора! Дождитесь его полной остановки!!!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ СМАЗКИ.

Насадка устанавливается на носик баллончика смазывающего спрея.

СМАЗЫВАНИЕ НАКОНЕЧНИКА

1. Производите смазку в течение 1 секунды перед каждой стерилизацией, но не реже двух раз в день. Рекомендуется смазка наконечника через 20 минут рабочего времени.
2. Процедура смазывания: присоедините переходник к носику баллончика смазывающего спрея. Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в хвостовик наконечника до упора и распыляйте спрей в течение 1 секунды.
3. Еженедельно проводите очистку цангового устройства распыляйте спрей в отверстие для бора в течении 1 сек.
4. Включить наконечник с установленным бором и дать поработать на холостом ходу 15-20 секунд.
5. После остановки бора удалить с наконечника салфеткой излишки смазки.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием, всегда проверяйте работу наконечника вне полости рта пациента

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОСЪЁМНОГО ПЕРЕХОДНИКА


1. Отсоединение наконечника: стянуть наконечник с переходника, преодолевая сопротивление пружины фиксатора, до рассоединения.
2. Присоединение наконечника : вставить переходник в наконечник до щелчка фиксатора, убедиться в надёжности соединения потянув наконечник назад.
3. Использование поворотного кольца для точного изменения объема аэрозоля.

При совмещении меток на поворотном кольце и корпусе переходника – подача воды максимальная, при повороте вправо пропорционально уменьшается до нуля.

ЗАМЕНА БОРА

1.Извлечение бора: нажмите на кнопку головки наконечника большим пальцем и, не отпуская кнопки, извлеките бор.
2.Фиксация бора: вставьте бор в наконечник, нажмите на кнопку головки наконечника большим пальцем и, не отпуская кнопки, вставьте бор до упора. Отпустите кнопку.



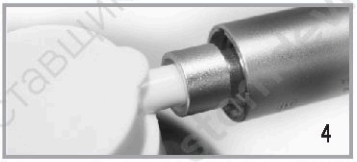









1.6. Стерилизация наконечника.

Стерилизацию наконечника необходимо проводить перед началом эксплуатации и после каждого приёма пациента. ВНИМАНИЕ! При сильном загрязнении следует производить предварительную очистку поверхностей с помощью готовых дезинфекционных салфеток

Очистите наружные поверхности наконечника, произведите смазку (см.п. смазка) и запечатайте в стерилизационный пакет. Автоклавируйте наконечник в течении 5 мин. при температуре 135 С под давлением 2.2 МПа. После автоклавирования, перед началом работы проверьте работоспособность наконечника, зажимного устройства. Если замечена неисправность, не используйте наконечник и обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Быстросъёмный переходник автоклавированию не подлежит!

1.7. Замена роторной группы.

Для замены роторной группы необходимо воспользоваться услугами специализированного сервисного центра.

1.8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Наконечники могут транспортироваться и храниться в заводской упаковке, при температуре от минус 50 до плюс 40 С, при относительной влажности не более 80%.

1.9. ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует безотказную работу наконечника в течении гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации наконечника – 6 (шесть) месяцев с момента даты продажи, о чём делается отметка в гарантийном талоне.

ВНИМАНИЕ! В гарантийный ремонт наконечник принимается в чистом виде, после стерилизации. При сдаче в гарантийный ремонт наконечник должен быть в полной комплектации, в штатной заводской упаковке, не иметь механических повреждений (следов от ударов, постороннего вмешательства) , с гарантийным талоном с отметкой продажи и иметь сопроводительный документ (акт-заявление с указанием характера дефекта). В противном случае претензия рассматривается как не гарантийная.

Сделано в КНР Being Foshan Medical Equipment Co., Ltd.

CE
0123

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВНИМАНИЕ! Вы приобрели сложный прибор, который требует регламентного технического обслуживания специалистами сервисной организации. Наличие технического обслуживания является необходимым условием для выполнения фирмой-продавцом гарантийных обязательств. Не доверяйте Ваш инструмент случайным людям, требуйте только квалифицированного обслуживания.

Гарантийные обязательства продавца (то есть устранение скрытых дефектов, происшедших по вине завода-изготовителя) сохраняются только при квалифицированном монтаже инструмента, произведенном либо специалистами продавца, либо сотрудниками специализированного сервисного предприятия (в этом случае обязателен акт произведенных работ с указанием названия монтажной организации, ее лицензии и сертификатов специалистов).

В случае самостоятельного монтажа и обнаружении скрытых дефектов, Вам необходимо самостоятельно обращаться к изготовителю или его представителю, адрес которого можно узнать у фирмы - продавца.

Гарантийные обязательства сохраняются только в случае регулярного технического обслуживания инструмента (смотрите инструкцию по эксплуатации) специалистами либо фирмы - продавца (по отдельному договору), либо специалистами профильного сервисного предприятия. В случае отсутствия технического обслуживания, фирма - продавец ответственности за качественную работу инструмента не несет.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения изделия прямо или косвенно вызванные внешним воздействием (нарушения РЕКОМЕНДУЕМЫХ параметров электропитания, давления и качества воды и воздуха).

Инструмент вышедший из строя в период гарантийного срока, доставляется для экспертизы и ремонта в сервисную организацию за счет покупателя.

Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их чрезмерным износом.

Диагностика инструментов в случае обстоятельств не гарантийного характера, необоснованных претензий к их работоспособности является платной услугой и оплачивается покупателем.

ВНИМАНИЕ! В гарантийный (и вообще) в ремонт инструмент принимается только в чистом виде и после дезинфекции. При сдаче в гарантийный ремонт инструмент должен быть в полной комплектации, в штатной заводской упаковке, не иметь механических повреждений наружных частей (следов от ударов, постороннего вмешательства), с гарантийным талоном, отметкой продажи и сопроводительным документом (актом - заявлением с указанием характера дефекта).

В противном случае дефект рассматривается как не гарантийный.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПОКУПАТЕЛЬ:

ГОРОД:

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ:

ОРГАНИЗАЦИЯ - ПРОДАВЕЦ:

ДАТА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ:

СРОК ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

С правилами эксплуатации и условиями гарантийного ремонта ознакомлен: _____ / /

ПРОДАВЕЦ _____ / /

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ: _____ / /

Дата приема изделия на гарантийный ремонт: _____

Описание дефекта: _____

_____

_____

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ