stomdevice

BEING
FOSHAN

инструкция по эксплуатации

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК
модель: Lotus 302 PQ

Being Foshan Medical Equipment Co., Ltd
Add: 2/Fl., Lihua Building, 2/St., Lianhe Industrial Zone(West), Lucun,
Nanhai District, Foshan, 528226, Guangdong, China

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации нового наконечника необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней.

1.1. Назначение наконечника.



Наконечник турбинный с кнопочной фиксацией бора, с трёхточечным распылителем охлаждающего спрея, с быстросъёмным переходником.

1.2 Назначение.

Предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) диаметром 1,59-1,60 мм и приведении их во вращение при выполнении зубоврачебных работ. Область применения - терапевтическая и ортопедическая стоматология.

1.3. Технические характеристики:

Рабочее давление, KPa(kgf/cm)	206 –231(2.1-2.35)
Частота вращения, об/мин	300000-320000
Расход воздуха, л/мин, не более	45
Расход воды, мл/мин, не менее	50
Давление воды, не более KPa(kgf/cm)	198(2)
Рекомендуемая длинна боров, мм:	21-23
Уровень шума, не более dB	70
Температура паровой стерилизации, С, не более	135



1.4 Правила техники безопасности.

Если при работе наконечника обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.

- Не ронять, не подвергать ударам!
- Не включайте и не храните наконечник без бора или тест-бора.
- Наконечник должен храниться в очищенном, смазанном состоянии.
- Никогда не включайте наконечник с не полностью вставленным бором.
- Не вынимайте и не вставляйте бор во время вращения ротора. Дождитесь его полной остановки .
- Следует пользоваться борами с полусферической частью хвостовика (стандарт ISO 1797) диаметр бора : 1.60-0.01 мм.
- Никогда не отсоединяйте переходник от работающего наконечника.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


1.5. Подготовка наконечника к работе.

ВНИМАНИЕ! Запрещается нажимать полностью или частично кнопку фиксации во время вращения бора: как при работе в полости рта, так и начале замены бора! Дождитесь его полной остановки!!!



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ СМАЗКИ.

Насадка устанавливается на носик баллончика смазывающего спрея.

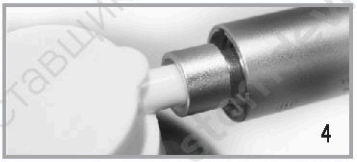

СМАЗЫВАНИЕ НАКОНЕЧНИКА

1. Производите смазку в течение 1 секунды перед каждой стерилизацией, но не реже двух раз в день. Рекомендуется смазка наконечника через 20 минут рабочего времени.
2. Процедура смазывания: присоедините переходник к носику баллончика смазывающего спрея. Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в хвостовик наконечника до упора и распыляйте спрей в течение 1 секунды.
3. Еженедельно проводите очистку цангового устройства распыляйте спрей в отверстие для бора в течении 1 сек.
4. Включить наконечник с установленным бором и дать поработать на холостом ходу 15-20 секунд.
5. После остановки бора удалить с наконечника салфеткой излишки смазки.



ВНИМАНИЕ! Перед использованием, всегда проверяйте работу наконечника вне полости рта пациента

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОСЪЁМНОГО ПЕРЕХОДНИКА

1. Отсоединение наконечника: стянуть наконечник с переходника, преодолевая сопротивление пружины фиксатора, до рассоединения.
2. Присоединение наконечника : вставить переходник в наконечник до щелчка фиксатора, убедиться в надёжности соединения потянув наконечник назад.
3. Использование поворотного кольца для точного изменения объема аэрозоля.

При совмещении меток на поворотном кольце и корпусе переходника – подача воды максимальная, при повороте вправо пропорционально уменьшается до нуля.



ЗАМЕНА БОРА

1.Извлечение бора: нажмите на кнопку головки наконечника большим пальцем и, не отпуская кнопки, извлеките бор.
2.Фиксация бора: вставьте бор в наконечник, нажмите на кнопку головки наконечника большим пальцем и, не отпуская кнопки, вставьте бор до упора. Отпустите кнопку.



1.6. Стерилизация наконечника.

Стерилизацию наконечника необходимо проводить перед началом эксплуатации и после каждого приёма пациента. ВНИМАНИЕ! При сильном загрязнении следует производить предварительную очистку поверхностей с помощью готовых дезинфекционных салфеток

Очистите наружные поверхности наконечника, произведите смазку (см.п. смазка) и запечатайте в стерилизационный пакет. Автоклавируйте наконечник в течении 5 мин. при температуре 135 С под давлением 2.2 МПа. После автоклавирования, перед началом работы проверьте работоспособность наконечника, зажимного устройства. Если замечена неисправность, не используйте наконечник и обратитесь в сервисный центр.



ВНИМАНИЕ! Быстросъёмный переходник автоклавированию не подлежит!

1.7. Замена роторной группы.

Для замены роторной группы необходимо воспользоваться услугами специализированного сервисного центра.

1.8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Наконечники могут транспортироваться и храниться в заводской упаковке, при температуре от минус 50 до плюс 40 С, при относительной влажности не более 80%.

1.9. ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует безотказную работу наконечника в течении гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации наконечника – 6 (шесть) месяцев с момента даты продажи, о чём делается отметка в гарантийном талоне.

ВНИМАНИЕ! В гарантийный ремонт наконечник принимается в чистом виде, после стерилизации. При сдаче в гарантийный ремонт наконечник должен быть в полной комплектации, в штатной заводской упаковке, не иметь механических повреждений (следов от ударов, постороннего вмешательства) , с гарантийным талоном с отметкой продажи и иметь сопроводительный документ (акт-заявление с указанием характера дефекта). В противном случае претензия рассматривается как не гарантийная.

Сделано в КНР Being Foshan Medical Equipment Co., Ltd.

CE 0123

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВНИМАНИЕ! Вы приобрели сложный прибор, который требует регламентного технического обслуживания специалистами сервисной организации. Наличие технического обслуживания является необходимым условием для выполнения фирмой-продавцом гарантийных обязательств. Не доверяйте Ваш инструмент случайным людям, требуйте только квалифицированного обслуживания.

Гарантийные обязательства продавца (то есть устранение скрытых дефектов, происшедших по вине завода-изготовителя) сохраняются только при квалифицированном монтаже инструмента, произведенном либо специалистами продавца, либо сотрудниками специализированного сервисного предприятия (в этом случае обязателен акт произведенных работ с указанием названия монтажной организации, ее лицензии и сертификатов специалистов).

В случае самостоятельного монтажа и обнаружении скрытых дефектов, Вам необходимо самостоятельно обращаться к изготовителю или его представителю, адрес которого можно узнать у фирмы - продавца.

Гарантийные обязательства сохраняются только в случае регулярного технического обслуживания инструмента (смотрите инструкцию по эксплуатации) специалистами либо фирмы - продавца (по отдельному договору), либо специалистами профильного сервисного предприятия. В случае отсутствия технического обслуживания, фирма - продавец ответственности за качественную работу инструмента не несет.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения изделия прямо или косвенно вызванные внешним воздействием (нарушения РЕКОМЕНДУЕМЫХ параметров электропитания, давления и качества воды и воздуха).

Инструмент вышедший из строя в период гарантийного срока, доставляется для экспертизы и ремонта в сервисную организацию за счет покупателя.

Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их чрезмерным износом.

Диагностика инструментов в случае обстоятельств не гарантийного характера, необоснованных претензий к их работоспособности является платной услугой и оплачивается покупателем.

ВНИМАНИЕ! В гарантийный (и вообще) в ремонт инструмент принимается только в чистом виде и после дезинфекции. При сдаче в гарантийный ремонт инструмент должен быть в полной комплектации, в штатной заводской упаковке, не иметь механических повреждений наружных частей (следов от ударов, постороннего вмешательства), с гарантийным талоном, отметкой продажи и сопроводительным документом (актом - заявлением с указанием характера дефекта).

В противном случае дефект рассматривается как не гарантийный.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПОКУПАТЕЛЬ:

ГОРОД:

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ:

ОРГАНИЗАЦИЯ - ПРОДАВЕЦ:

ДАТА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ:

СРОК ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

С правилами эксплуатации и условиями гарантийного ремонта ознакомлен: _____ / /

ПРОДАВЕЦ _____ / /

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ: _____ / /

Дата приема изделия на гарантийный ремонт: _____

Описание дефекта: _____

_____

_____

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ