


stomdevice

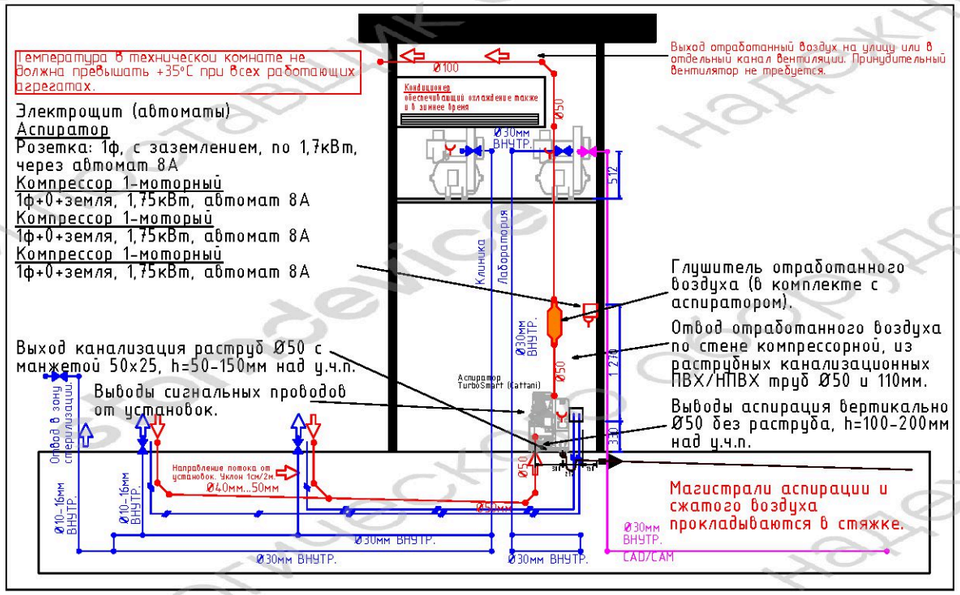

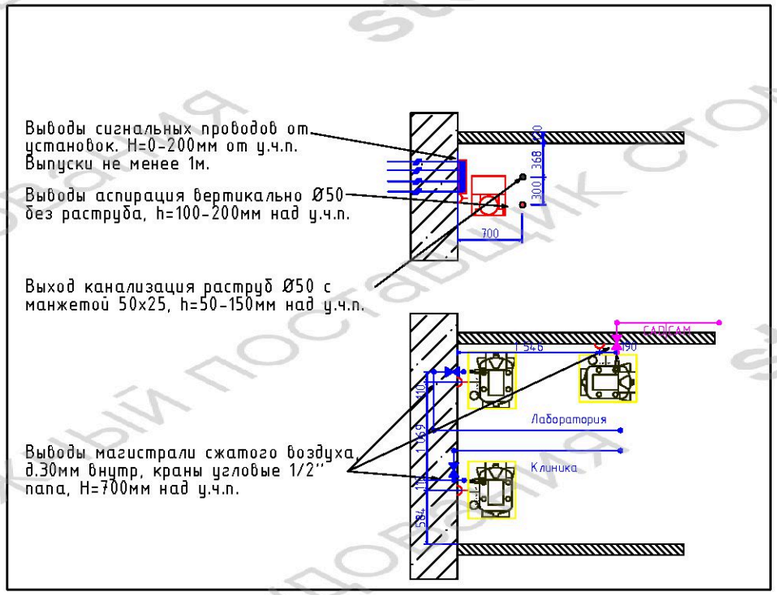

Подготовка сигнального провода для аспиратора
2 х 0,75 мм^2
1. возможно параллельное соединение,
2. возможно проводом от каждой установки
3. выпуск не менее 1м над у.ч.п.

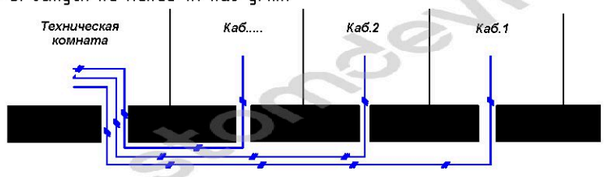


Расчет производительности вентилятора
(в случае невозможности кондиционирования и необходимости организации приточно-вытяжной вентиляции в технической комнате)

Вт х 0,3 = м.куб/час

Вт - потребляемая мощность приборов в технической комнате в Вattmax
0,3 - постоянный коэффициент
м.куб/час - количество воздуха для удаления из тех.комнаты

Потребляемая мощность прибора (Вт) = Напряжение х Рабочий ток х cos ф х 1,73

Полученная цифра (в куб.м /час) обозначает производительность постоянно функционирующего вытяжного вентилятора, не подключенного параллельно к аспиратору.

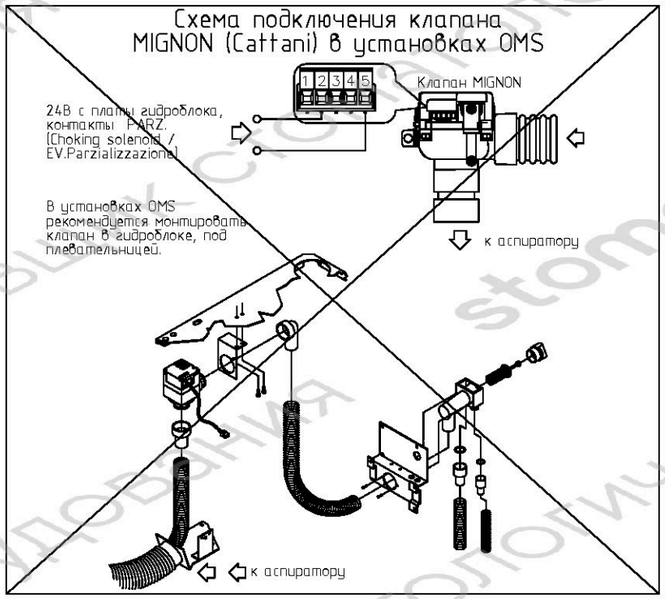

Примеры размещения оборудования в технической комнате



3.2 Аспирация детализация	СОГЛАСОВАНО Заказчик Строительно-монтажная организация дата/подпись	Заказчик г.Москва, Брошевский пер. 6с1 Омарова Зарема Кадиевна +7 (926) 649-70-00	Ремонтно-строительные работы:	А 3 19.10.2017

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ