stomdevice

Перед установкой аппарата необходимо убедиться в том, что параметры сети соответствуют заданным параметрам аппарата. Проводка должна быть пригодна для нормальной работы аппарата, и защищена от скачков напряжения в сети в соответствии с положением CEI 64-8.

Аппарат должен иметь защиту от косвенного контакта с персоналом в соответствии с положениями 64 - 8 и 64 - 4 для оборудования класса I.




Рисунок A

Сетевой шнур аспиратора имеет жилу заземления. Запрещается отключать заземление и розетка должна соответствовать евро-стандарту.

После переключения выключателя в положение 1 , загорится сетевой индикатор. Аспирация начинается при снятии одного из наконечников из держателя.

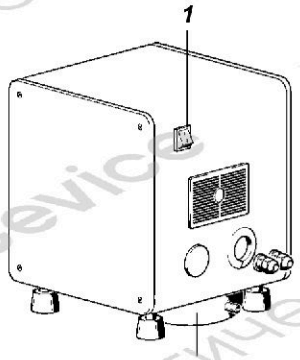


Рисунок B

При открывании дверцы аспиратора аспирация автоматически прекращается. При нормальной работе аспиратора аспирированный воздух выводится через глушитель 2. Для вывода отработанного воздуха наружу необходимо подсоединить трубку, отходящую от мотора к внешней трубке 3C . При этом воздух содержащий бактерии будет выведен в трубку а шум существенно снижен.

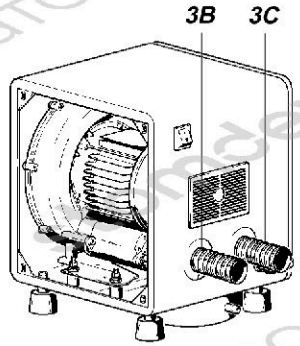


Рисунок C

Техническое обслуживание, проводимое сервисными инженером

По Вашему требованию фирма-производитель предоставит любые необходимые запасные части, литературу и рекомендации.
Фирма-производитель предоставляет все необходимые чертежи, электрические схемы, инструкции и информацию по обслуживанию и профилактике оборудования.

Гарантия не распространяется в случаях, если при обслуживании оборудования не были использованы детали рекомендуемые фирмой-производителем, при использовании оборудования не по назначению, а также если ремонт оборудования был произведен лицами, не уполномоченными фирмой-производителем.

CATTANI

Стоматологический всасывающий насос UNI - JET 75



Руководство по эксплуатации

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Технический паспорт

Модель	**UNI-JET 75**
Номинальное напряжение	220 В ~ ± 5%
Номинальная частота	50 Гц
Сила тока	3,1 А
Класс изоляции	I
Тип оборудования	B
Тип эксплуатации	Непрерывная работа
Защита от попадания агрессивных жидкостей	Общий
Уровень защиты от прямых и непрямых контактов с оборудованием	тип B
Выходная мощность	0,4 кВт
Максимальный поток жидкости	1250 л/мин
Максимальный рабочий уровень вакуума при непрерывной работе:	1300 мм/H_2O
Уровень шума*	58 Дб (А)

Переменный ток	IEC 417-5032
Заземление	IEC 417-5019
Выключен (отключен от сети)	IEC 417-5008
Включен (включен в сеть)	IEC 417-5007
Опасное напряжение	IEC 878-03-01

Стоматологический аспиратор

Моторы имеют механизм защиты от перегрева.
Запрещается включать аппарат при наличии в воздухе анестезирующих огнеопасных соединений, чистого кислорода или окиси азота.
По специальному заказу оборудование может быть рассчитано на различные напряжения и частоты электросети.

Уровень шума измерен в соответствии с ISO 3746-1979 (E).
Параметры: r=1, шумовой фон - ≤ 51 Дб (А) - Измерительный прибор: Brüel & Kjær, Тип: 2232.
Фирма-производитель: CATTANI S.P.A., Парма, Италия.

Описание компонентов

1	Сетевой выключатель
2	Глушитель трубки отработанного воздуха
3B	Трубка ваккума
3C	Трубка вывода аспирационного воздуха

Общие характеристики

Аспиратор Uni-Jet 75 предназначен для эксплуатации вместе со стоматологической установкой. Это легкий в обращении бесшумный аппарат, который был создан для работы в условиях непрерывной эксплуатации.

Установка аспиратора

Наиболее удачное положение аспиратора – рядом со стоматологической установкой, слева от кресла у ног пациента (рисунок А).

Установку аспиратора необходимо выполнять в соответствии с теми же положениями, которыми руководствовались при разработке и монтаже аспираторов **Uni-Jet** CEI 62-5/2ª 1991.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ