


stomdevice


(QUOTA INDICATIVA COMPRENSIVA DI TUBI = 540)

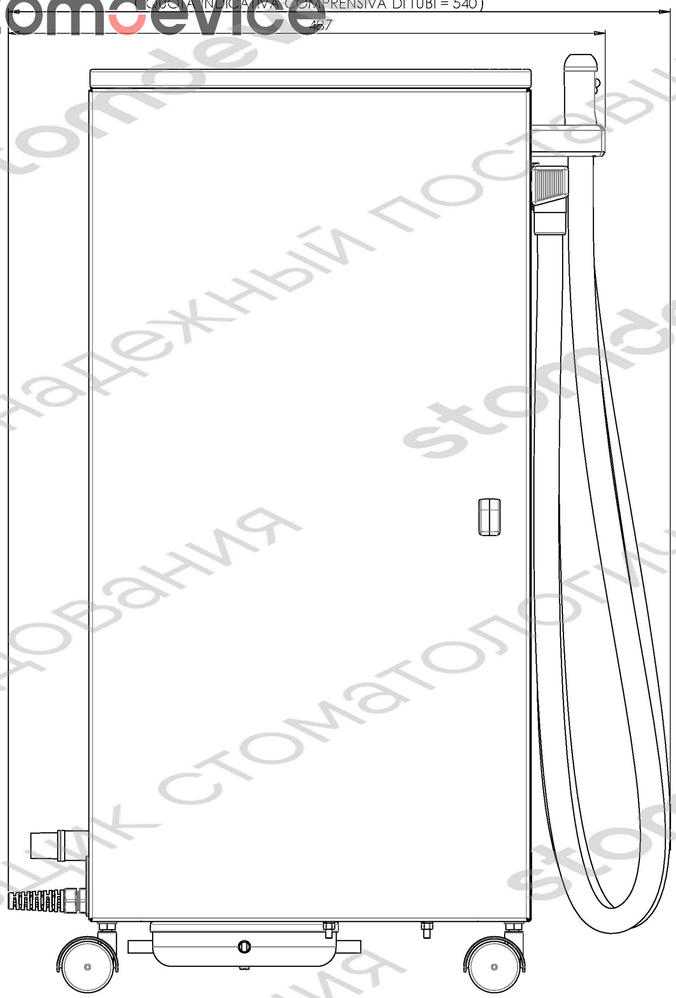


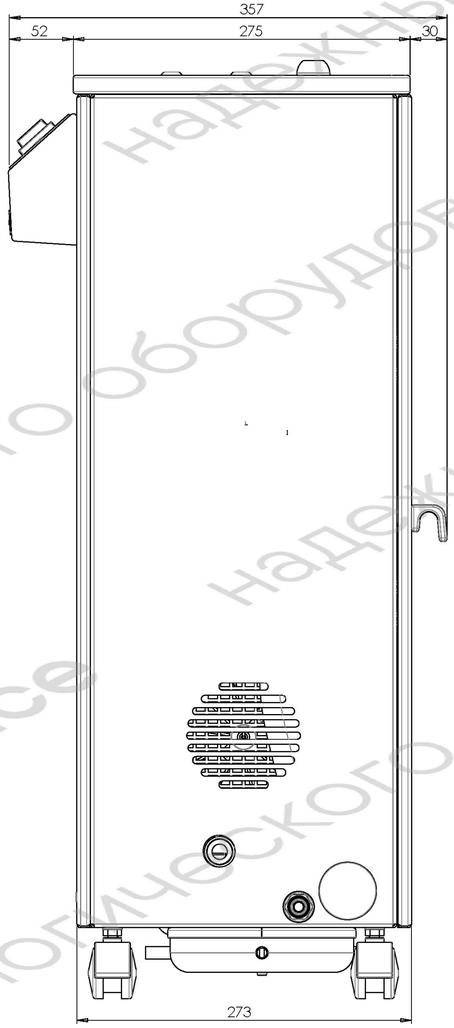



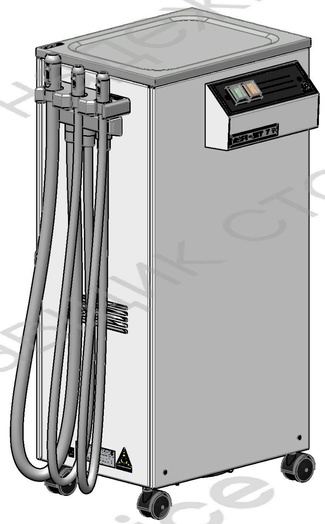


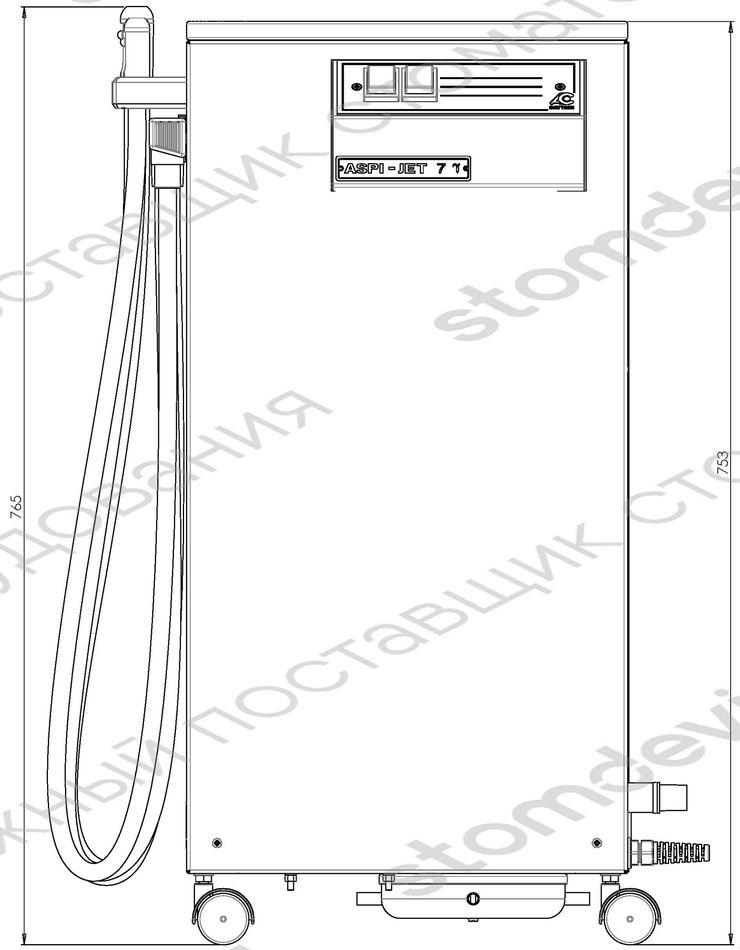
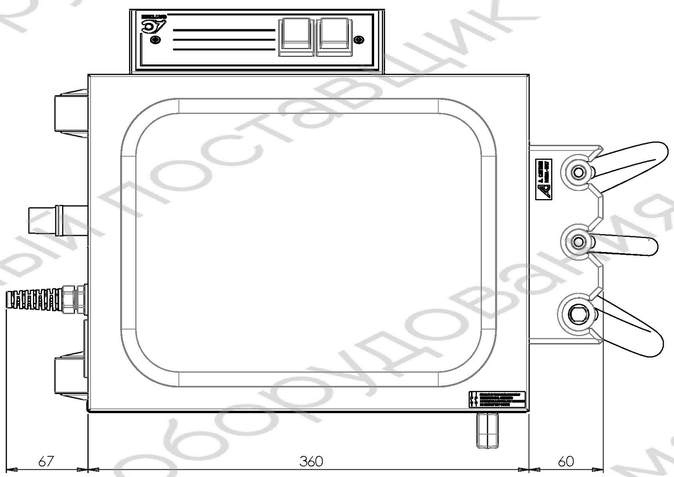
| N° | Modifica | Data | Firma |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

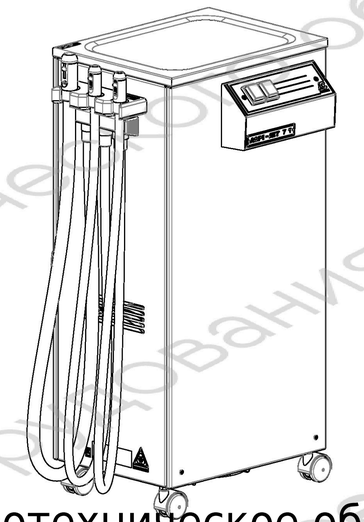

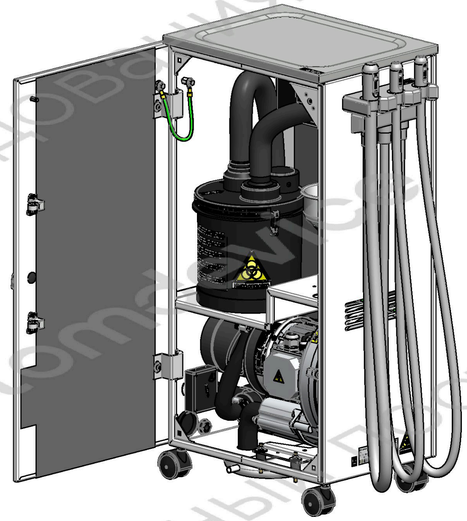



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | | |
| POS. | CODICE | MATERIALE GREZZO - DESCRIZIONE COMPONENTI | Q.TA' | DISEGNO NUMERO | |
| | DISEGNATO | APPROVATO | Trattamenti termici e/o superficiali | PesoKg | Modello |
| DATA | 14/06/2011 | | 0 | 34.0 | 0 |
| FIRMA | MORTALI | | ESEGUIRE LE QUOTE SENZA INDICAZIONE IN CLASSE DI TOLLERANZA **FINE** SECONDO UNI ISO 2768 DEL 1991 (FORI TOLLERANZA +/ ALBERI TOLLERANZA -) GOLE DI SCARICO PER PARTI DA RETTIFICA SECONDO UNI4384 FORME E/F | SCALA 1:2.5 | |

Cattani S.p.A.
Via Natta 6/A
43122 Parma - Italy
T. +39 0521 607 604
F. +39 0521 607 628
info@cattani.it
www.cattani.it

| DENOMINAZIONE | CODICE |
|---|---|
| ASPIJET 7 230V50HZ CE | 010020 |
| GRUPPO MACCHINA | DISEGNO NUMERO |
| ASPIJET 7 | 044-01-52 |

Integro di proprietà della CATTANI S.P.A. che ne vieta ogni copia non autorizzata
Del presente disegno e' valida solamente la copia con indice maggiore

надежный поставщик стоматологического оборудования
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ