stomdevice

Brite

Руководство пользователя

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Примечание: Не используйте острые предметы при распаковке бестеневого светильника.

1) Распаковка бестеневого светильника Brite

Аккуратно откройте упаковку, не используя острых предметов.

В упаковке содержатся следующие компоненты:


- Система крепежных тросов для монтажа бестеневого светильника к потолку.
- Бестеневой светильник Brite
- Пульт дистанционного управления и держатель (опция)




2) Размещение светильника Brite

Бестеневой светильник следует размещать таким образом, чтобы глаза пациента были устремлены на 1/3 светильника.

Высота размещения светильника должна находиться в диапазоне от 600 до 1000 мм над рабочей поверхностью.

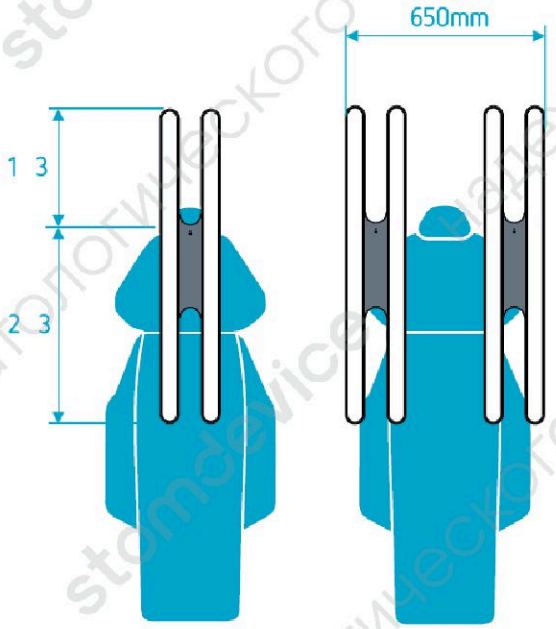


Примечание: Светильник должен быть размещен на высоте не менее 2,2 м над уровнем пола.

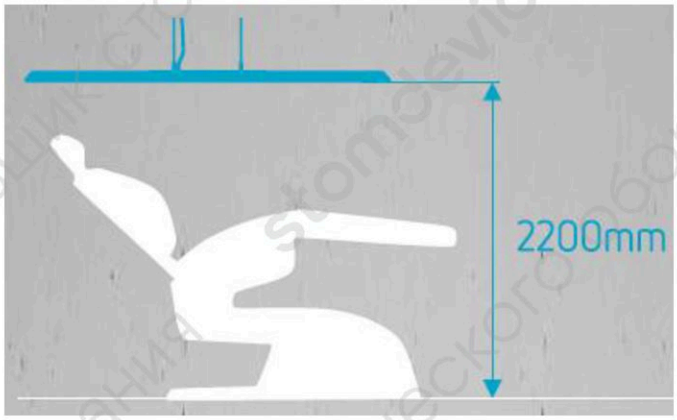

3) Подготовка к креплению бестеневого светильника Brite


После распаковки светильника, упаковку можно использовать в качестве ориентира - трафарета для отметки точек крепления на потолке.

1. Используйте переднюю часть упаковки, в качестве трафарета, проделав в ней отверстия в точках крепления при помощи отвёртки или подобного инструмента, как показано на рисунке.
2. Разместите трафарет от упаковки в месте, где вы хотите установить светильник и отметьте точки для крепления.
3. Просверлите отмеченные точки для крепления.

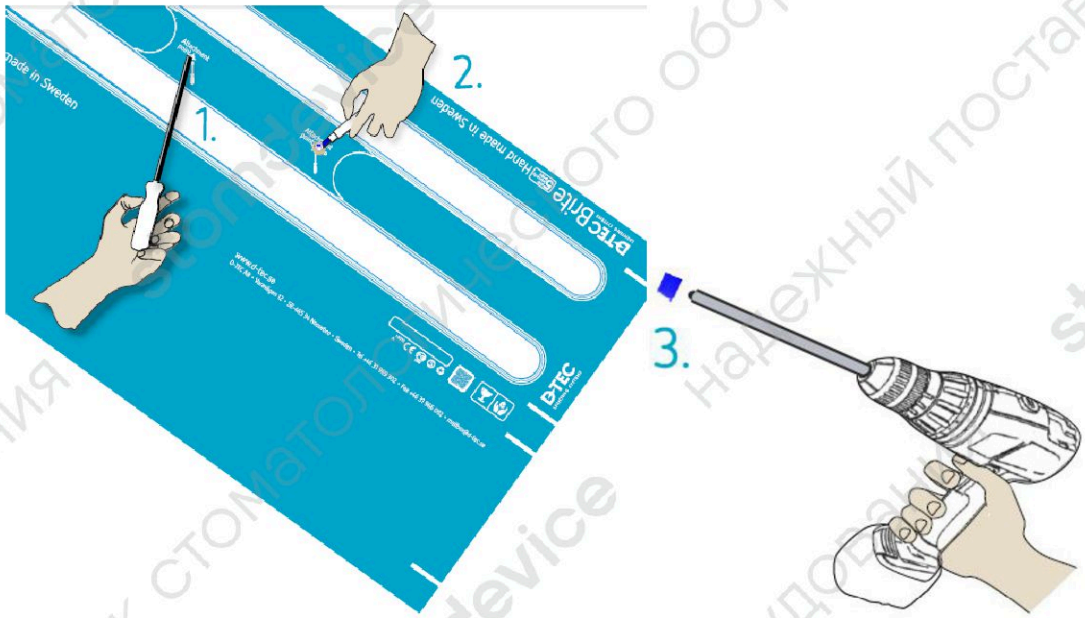

4) Крепление светильника Brite к потоку

Данные приспособления поставляются вместе со светильником. Используйте наиболее подходящий для вас вариант.

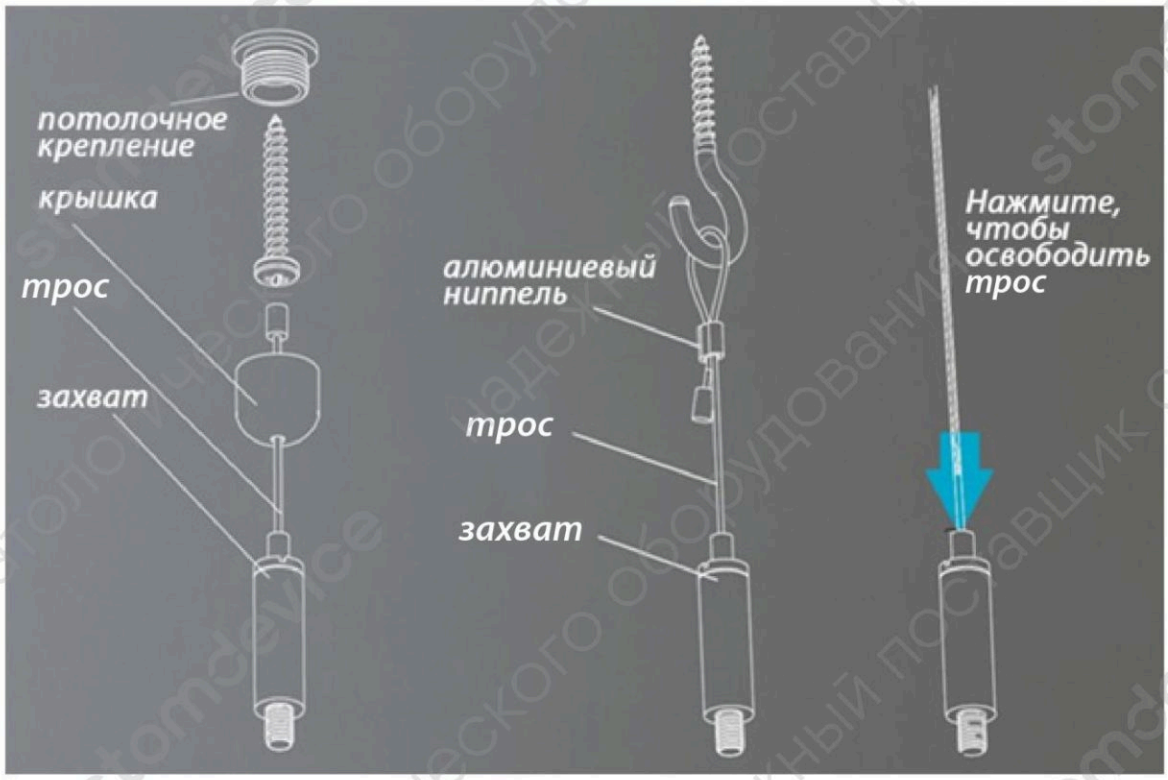


5) Управление светильником Brite при помощи пульта дистанционного управления.

Все доступные функции светильника Brite могут регулироваться при помощи пульта дистанционного управления. Пульт дистанционного управления поставляется вместе с держателем, который может быть прикреплён на стену, стол и т.д.


При работе со светоотверждаемыми композитными материалами вы можете уменьшить интенсивность освещения и тем самым снизить скорость полимеризации.

Возможность снижения уровня интенсивности освещения так же может облегчить проверку рентгеновских снимков. Светильник имеет две заводские установки, которые вы можете настроить по своему усмотрению: установите желаемый уровень яркости при помощи кнопок «+» и «-». Удерживайте кнопку 1 или 2 нажатой примерно 3 секунды. Значок «солнце» на светильнике замигает, отображая, что новая программа была установлена.

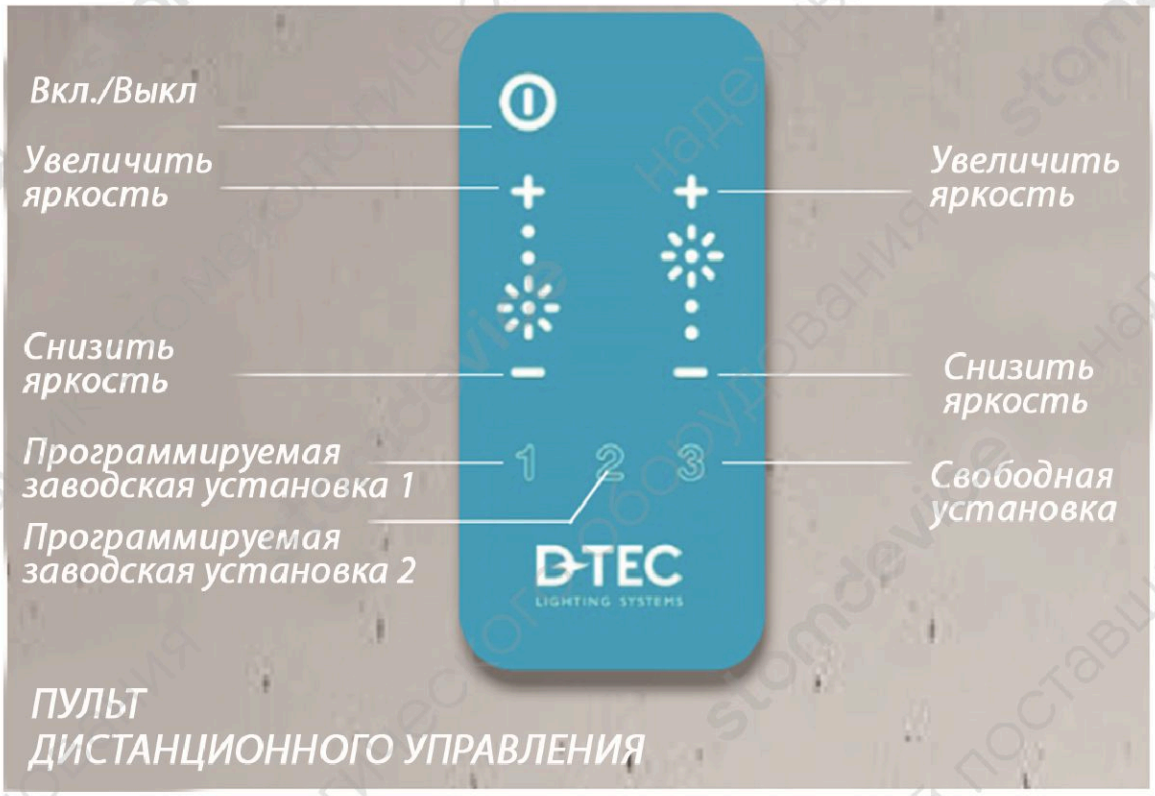

Бестеневым светильником Brite так же можно управлять при помощи шнура: Вкл./Выкл.: потяните шнур резким быстрым движением (<0.5с)

- Диммер: Потяните шнур плавным движением (>0.5 с), диммер изменяет яркость освещения после каждого натяжения шнура.

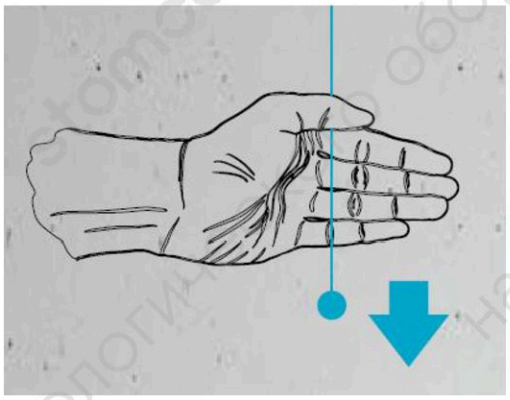


6) Интенсивность освещения для различных кабинетов

Рекомендуемая интенсивность освещения для операционной:

Зона 1: 20 000 – 30 000 Люкс

Зона 2: 3 000 – 5 000 Люкс


Зона 3: 500 – 1 000 Люкс

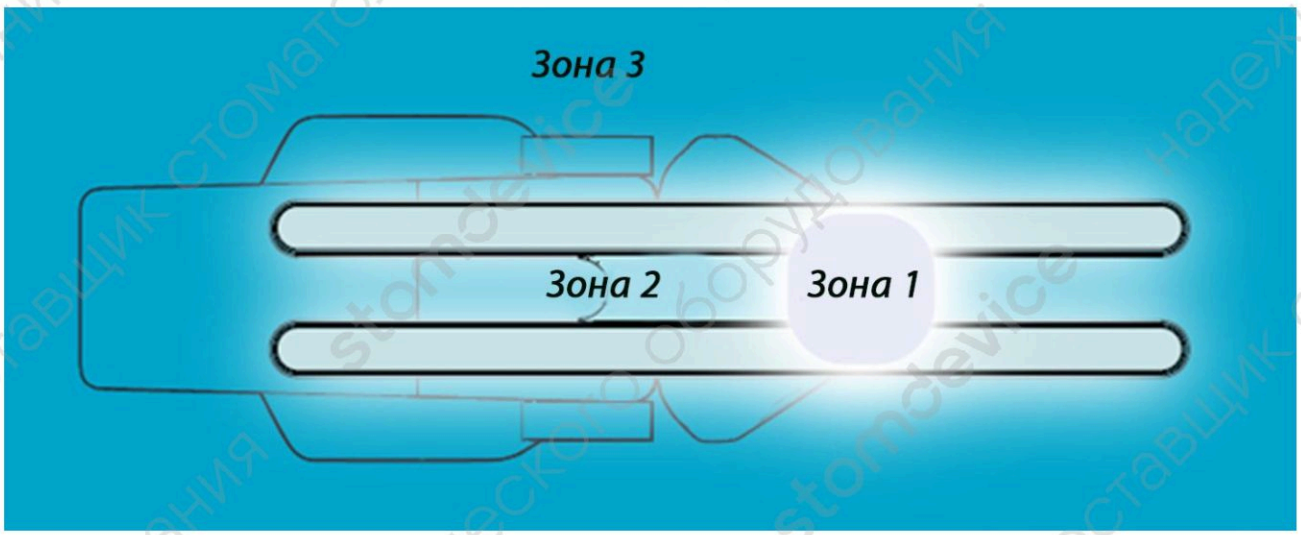

Рекомендуемая интенсивность освещения для смотровой:

Зона 1: 3 000 – 5 000 Люкс

Зона2: 500 – 1 000 Люкс

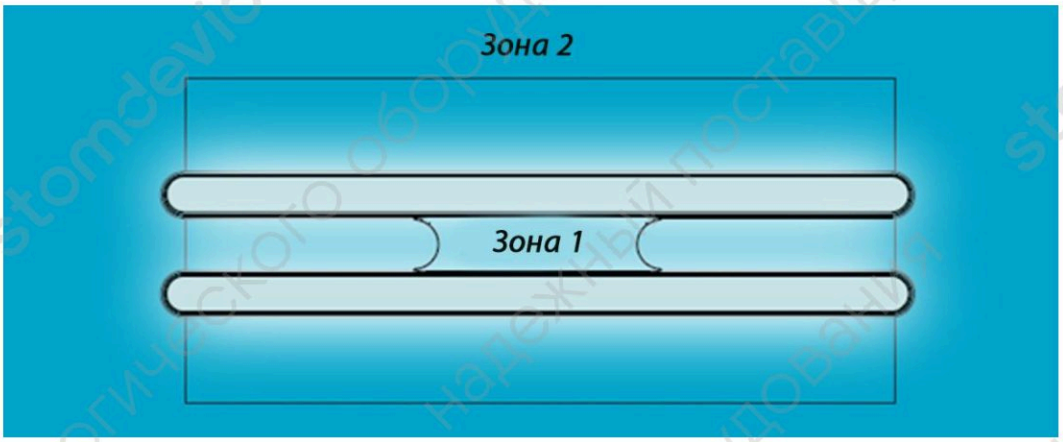

Внимание!

Помните о том что яркий белый свет может влиять на скорость отверждения композитных материалов.