stomdevice



Xive®

Каталог продукции

Dentsply Sirona Implants

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Универсальность и простота

Уже более десяти лет система имплантатов Xive обладает полным спектром реставрационных вариантов. От крайне узкого промежутка до полной адентии с атрофией, в кости высокой или низкой плотности, с использованием одно- или двухэтапного протокола, с субгингивальным или трансгингивальным заживлением, от немедленной до отложенной нагрузки — с Xive можно выбрать любую концепцию лечения.

Основанием для такой свободы выбора, как хирургической, так и ортопедической, является сочетание ряда выдающихся особенностей, которые обеспечивают универсальность и простоту.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Xive®

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор системы

Ассортимент Xive® D 3.0/D 3.4 4
Ассортимент Xive® D 3.8 6
Ассортимент Xive® D 4.5 8
Ассортимент Xive® D 5.5 10
Ассортимент Xive® TG 12
Рекомендуемые значения торка 14

Имплантаты

Xive® S 18
Xive® TG 20

Ортопедия

Менеджмент мягких тканей 21
Многофункциональный компонент TempBase 21
Формирователь десны 22
Временный абатмент EsthetiCap 25

Xive® S 26
Снятие оттиска на уровне имплантата 27
Снятие оттиска на уровне абатмента (MP) 35
Стандартные ортопедические компоненты 38
• Абатмент EstheticBase 38
• Абатмент Cercon® 41
• Абатмент CeraBase 42
• Абатмент AuroBase 43
• Телескопический абатмент 44
• Абатмент MP 45
• Мостовидные протезы 48
• Набор PassivFit, ретенционные гильзы MP 50
• Балочные конструкции 51
• Абатмент Locator® 54
• Шаровидный абатмент 56
Индивидуальные ортопедические компоненты 57
• Абатменты TitaniumBase и ScanBase 57
• Абатменты Atlantis® 57
Концепция WeldOne® 58

Xive® TG
Снятие оттиска 60
Стандартные ортопедические компоненты 61
Индивидуальные ортопедические компоненты 63

Инструменты

Компоненты для планирования 64

Хирургические инструменты
Хирургические наборы 66
Лоток Washtray 70
Хирургические инструменты 72
Инструменты для навигационной хирургии 84
Физиодиспенсер 89

Ортопедические инструменты 91

Дополнительные материалы 97

Указатель продукции 100

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ассортимент Xive®

D 3.0 D 3.4

Имплантаты	Винт-заглушка	Формирователь десны	Снятие оттиска на уровне имплантата	Стандартные абатменты
 **Имплантат Xive S plus D 3.0** L 11 26 – 2422 L 13 26 – 2423 L 15 26 – 2425	 Винт-заглушка Friadent 45 – 1120	 Формирователь десны Friadent GH 1 45 – 1421 GH 2 45 – 1422 GH 3 45 – 1423 GH 5 45 – 1425	 Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent GH 3 46 – 8223 GH 5 46 – 8225  Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent GH 3 46 – 8123 GH 5 46 – 8125  Аналог имплантата Friadent для фрезерования 45 – 2621  Аналог имплантата Friadent 45 – 4020	 Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0 GH 1 46 – 2121 GH 2 46 – 2122 GH 3 46 – 2123 GH 5 46 – 2125  Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15 GH 1 46 – 2221 GH 2 46 – 2222 GH 3 46 – 2223 GH 5 46 – 2225
 **Имплантат Xive S plus D 3.4** L 9.5 26 – 2431 L 11 26 – 2432 L 13 26 – 2433 L 15 26 – 2435 L 18 26 – 2438	 Винт-заглушка Friadent 45 – 1130	 Формирователь десны Friadent GH 1 45 – 1431 GH 2 45 – 1432 GH 3 45 – 1433 GH 5 45 – 1435  Формирователь десны Friadent тонкий GH 2 45 – 1232 GH 3 45 – 1233 GH 5 45 – 1235  Формирователь десны Friadent с отверстиями GH 3 45 – 1333 GH 5 45 – 1335	 Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent GH 3 46 – 8233 GH 5 46 – 8235  Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent GH 3 46 – 8133 GH 5 46 – 8135  Трансфер Friadent тонкий 45 – 1239  Аналог имплантата Friadent для фрезерования 45 – 2631  Аналог имплантата Friadent 45 – 4030	**Одиночная коронка**  Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0 GH 1 46 – 2131 GH 2 46 – 2132 GH 3 46 – 2133 GH 5 46 – 2135  Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15 GH 1 46 – 2231 GH 2 46 – 2232 GH 3 46 – 2233 GH 5 46 – 2235 **Мостовидный протез**  Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0 GH 1 46 – 2131 GH 2 46 – 2132 GH 3 46 – 2133 GH 5 46 – 2135  Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15 GH 1 46 – 2231 GH 2 46 – 2232 GH 3 46 – 2233 GH 5 46 – 2235 **Перекрывающий протез / протез на балке**  Абатмент Friadent MP прямой A 0 GH 1 46 – 2831 GH 2 46 – 2832 GH 3 46 – 2833 GH 5 46 – 2835  Абатмент Xive MP угловой A 15 GH 2 46 – 2932 GH 3 46 – 2933 GH 5 46 – 2935 A 30 GH 2 46 – 3032 GH 3 46 – 3033

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Стандартные ортопедические компоненты	Индивидуальные ортопедические компоненты	Снятие оттиска на уровне абатмента (только для MP)



Абатмент Friadent AuroBase
45 – 2420



Телескопический абатмент Friadent
45 – 2620



Абатменты Atlantis



Абатмент Friadent CeraBase
конический 45 – 2530



анатомический 45 – 2531



Абатмент Friadent AuroBase
45 – 2430



Абатмент Friadent MP прямой A 0
GH 1 46 – 2831
GH 2 46 – 2832
GH 3 46 – 2833
GH 5 46 – 2835



Абатмент Xive MP угловой

A 15	A 30
GH 2 46 – 2932	GH 2 46 – 3032
GH 3 46 – 2933	GH 3 46 – 3033
GH 5 46 – 2935	



Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста
46 – 9530



Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста
46 – 9930



Абатмент Friadent AuroBase
45 – 2430



Набор Friadent PassivFit
45 – 4830



Абатменты Atlantis для Xive



Супра-структуры Atlantis для Xive



Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP
46 – 8230



Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP
46 – 8130



Абатмент Xive Locator
GH 1 26 – 3301
GH 2 26 – 3302
GH 3 26 – 3303
GH 4 26 – 3304
GH 5 26 – 3305



Шаровидный абатмент Friadent
GH 1 45 – 3131
GH 2 45 – 3132
GH 3 45 – 3133



Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки
46 – 9630



Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки
46 – 9637



Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки
46 – 9638



Телескопический абатмент Friadent
45 – 2630

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ассортимент Xive®

D 3.8

Имплантаты	Винт-заглушка	Формирователь десны	Снятие оттиска на уровне имплантата	Стандартные абатменты
 **Имплантат Xive S plus D 3.8** L 8 26 – 2440 L 9.5 26 – 2441 L 11 26 – 2442 L 13 26 – 2443 L 15 26 – 2445 L 18 26 – 2448	 **Винт-заглушка Friadent** 45 – 1140	 **Формирователь десны Friadent** GH 1 45 – 1441 GH 2 45 – 1442 GH 3 45 – 1443 GH 5 45 – 1445  **Формирователь десны Friadent тонкий** GH 2 45 – 1242 GH 3 45 – 1243 GH 5 45 – 1245  **Формирователь десны Friadent с отверстиями** GH 3 45 – 1343 GH 5 45 – 1345	 **Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent** GH 3 46 – 8243 GH 5 46 – 8245  **Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent** GH 3 46 – 8143 GH 5 46 – 8145  **Трансфер Friadent тонкий** 45 – 1249  **Аналог имплантата Friadent для фрезерования** 45 – 2641  **Аналог имплантата Friadent** 45 – 4040	**Одиночная коронка**  **Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0** GH 1 46 – 2141 GH 2 46 – 2142 GH 3 46 – 2143 GH 5 46 – 2145  **Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15** GH 1 46 – 2241 GH 2 46 – 2242 GH 3 46 – 2243 GH 5 46 – 2245 **Мостовидный протез**  **Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0** GH 1 46 – 2141 GH 2 46 – 2142 GH 3 46 – 2143 GH 5 46 – 2145  **Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15** GH 1 46 – 2241 GH 2 46 – 2242 GH 3 46 – 2243 GH 5 46 – 2245 **Перекрывающий протез / протез на балке**  **Абатмент Friadent MP прямой A 0** GH 1 46 – 2841 GH 2 46 – 2842 GH 3 46 – 2843 GH 5 46 – 2845 GH 9 46 – 2849  **Абатмент Xive MP угловой** **A 15** GH 2 46 – 2942 GH 3 46 – 2943 GH 5 46 – 2945 **A 30** GH 2 46 – 3042 GH 3 46 – 3043
Переключение платформ	 **Винт-заглушка Xive PS D 3.4** 45 – 1110	 **Формирователь десны Xive PS** GH 1 45 – 1531 GH 2 45 – 1532 GH 3 45 – 1533 GH 5 45 – 1535  **Формирователь десны Xive PS тонкий** GH 2 45 – 1222 GH 3 45 – 1223 GH 5 45 – 1225	 **Трансфер Xive PS для открытой ложки** GH 3 45 – 1835 GH 5 45 – 1832  **Трансфер Xive PS для закрытой ложки** GH 3 45 – 1830 GH 5 45 – 1831  **Трансфер Xive PS тонкий** 45 – 1238	**Переключение платформ**  **Абатмент Xive EstheticBase PS прямой A 0** GH 1 46 – 2331 GH 2 46 – 2332 GH 3 46 – 2333 GH 5 46 – 2335  **Абатмент Xive EstheticBase PS угловой A 15** GH 1 46 – 2431 GH 2 46 – 2432 GH 3 46 – 2433 GH 5 46 – 2435

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Стандартные ортопедические компоненты	Индивидуальные ортопедические компоненты	Снятие оттиска на уровне абатмента (только для MP)
Абатмент Friadent Cercon прямой A 0 GH 1, neutral 47 – 1141 GH 2, neutral 47 – 1142 GH 1, dentine 47 – 2141 GH2, dentine 47 – 2142 **Абатмент Friadent Cercon угловой A 15** GH 1, neutral 47 – 1241 GH 2, neutral 47 – 1242 GH 1, dentine 47 – 2241 GH 2, dentine 47 – 2242 **Абатмент Friadent CeraBase** конический 45 – 2540 анатомический 45 – 2541 **Абатмент Friadent AuroBase** 45 – 2440		
Абатмент Friadent MP прямой A 0 GH 1 46 – 2841 GH 2 46 – 2842 GH 3 46 – 2843 GH 5 46 – 2845 GH 9 46 – 2849 **Абатмент Xive MP угловой** A 15 A 30 GH 2 46 – 2942 GH 2 46 – 3042 GH 3 46 – 2943 GH 3 46 – 3043 GH 5 46 – 2945 **Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста** 46 – 9540 **Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста** 46 – 9940 **Абатмент Friadent AuroBase** 45 – 2440 **Набор Friadent PassivFit** 45 – 4840	**Абатмент Xive TitaniumBase** 27 – 9040 **Абатмент Xive ScanBase** 27 – 9140 **Абатменты Atlantis для Xive** **Супра-структуры Atlantis для Xive**	**Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP** 46 – 8240 **Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP** 46 – 8140
Абатмент Xive Locator GH 1 26 – 3311 GH 2 26 – 3312 GH 3 26 – 3313 GH 4 26 – 3314 GH 5 26 – 3315 **Шаровидный абатмент Friadent** GH 1 45 – 3141 GH 2 45 – 3142 GH 3 45 – 3143 GH 5 45 – 3145 **Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки** 46 – 9640 **Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки** 46 – 9647 **Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки** 46 – 9648 **Телескопический абатмент Friadent** 45 – 2640		
Абатмент Xive MP PS GH 1 46 – 2921 GH 2 46 – 2922 GH 3 46 – 2923 GH 5 46 – 2925		**Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP** 46 – 8240 **Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP** 46 – 8140

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ассортимент Xive®

D 4.5

Имплантаты	Винт-заглушка	Формирователь десны	Снятие оттиска на уровне имплантата	Стандартные абатменты
 **Имплантат Xive S plus D 4.5** L 8 26 – 2450 L 9.5 26 – 2451 L 11 26 – 2452 L 13 26 – 2453 L 15 26 – 2455 L 18 26 – 2458	 **Винт-заглушка Friadent** 45 – 1150	 **Формирователь десны Friadent** GH 1 45 – 1451 GH 2 45 – 1452 GH 3 45 – 1453 GH 5 45 – 1455  **Формирователь десны Friadent тонкий** GH 2 45 – 1252 GH 3 45 – 1253 GH 5 45 – 1255  **Формирователь десны Friadent с отверстиями** GH 3 45 – 1353 GH 5 45 – 1355	 **Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent** GH 3 46 – 8253 GH 5 46 – 8255  **Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent** GH 3 46 – 8153 GH 5 46 – 8155  **Трансфер Friadent тонкий** 45 – 1259  **Аналог имплантата Friadent для фрезерования** 45 – 2651  **Аналог имплантата Friadent** 45 – 4050	**Одиночная коронка**  **Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0** GH 1 46 – 2151 GH 2 46 – 2152 GH 3 46 – 2153 GH 5 46 – 2155  **Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15** GH 1 46 – 2251 GH 2 46 – 2252 GH 3 46 – 2253 GH 5 46 – 2255 **Мостовидный протез**  **Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0** GH 1 46 – 2151 GH 2 46 – 2152 GH 3 46 – 2153 GH 5 46 – 2155  **Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15** GH 1 46 – 2251 GH 2 46 – 2252 GH 3 46 – 2253 GH 5 46 – 2255 **Перекрывающий протез / протез на балке**  **Абатмент Friadent MP прямой A 0** GH 1 46 – 2851 GH 2 46 – 2852 GH 3 46 – 2853 GH 5 46 – 2855 GH 9 46 – 2859  **Абатмент Xive MP угловой** A 15 GH 2 46 – 2942 GH 3 46 – 2943 GH 5 46 – 2945 A 30 GH 2 46 – 3042 GH 3 46 – 3043
Переключение платформ Параметры внутреннего шестигранного соединения у имплантатов Xive D 4.5 и D 3.8 одинаковы. Вы можете устанавливать абатменты D 3.8 на имплантаты Xive D 4.5 для переключения платформ. Подробная информация изложена в брошюре «Переключение платформ» и в Руководстве по ортопедии Xive.	 **Винт-заглушка Friadent** 45 – 1140	 **Формирователь десны Friadent** GH 1 45 – 1441 GH 2 45 – 1442 GH 3 45 – 1443 GH 5 45 – 1445  **Формирователь десны Friadent тонкий** GH 2 45 – 1242 GH 3 45 – 1243 GH 5 45 – 1245	 **Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent** GH 3 46 – 8243 GH 5 46 – 8245  **Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent** GH 3 46 – 8143 GH 5 46 – 8145  **Трансфер Friadent тонкий** 45 – 1249	**Переключение платформ**  **Абатмент Friadent EstheticBase прямой** GH 1 46 – 2141 GH 2 46 – 2142 GH 3 46 – 2143 GH 5 46 – 2145  **Абатмент Friadent EstheticBase угловой** GH 1 46 – 2241 GH 2 46 – 2242 GH 3 46 – 2243 GH 5 46 – 2245

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Стандартные ортопедические компоненты

Абатмент Friadent Cercon прямой A 0
GH 1, neutral 47 – 1151
GH 2, neutral 47 – 1152
GH 1, dentine 47 – 2151
GH 2, dentine 47 – 2152

Абатмент Friadent Cercon угловой A 15
GH 1, neutral 47 – 1251
GH 2, neutral 47 – 1252
GH 1, dentine 47 – 2251
GH 2, dentine 47 – 2252



Абатмент Friadent CeraBase
конический 45 – 2550



анатомический 45 – 2551



Абатмент Friadent AuroBase
45 – 2450



Абатмент Friadent MP прямой A 0
GH 1 46 – 2851
GH 2 46 – 2852
GH 3 46 – 2853
GH 5 46 – 2855
GH 9 46 – 2859



Абатмент Xive MP угловой

A 15	A 30
GH 2 46 – 2942	GH 2 46 – 3042
GH 3 46 – 2943	GH 3 46 – 3043
GH 5 46 – 2945	



Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста
46 – 9550



Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста
46 – 9950



Абатмент Friadent AuroBase
45 – 2450



Набор Friadent PassivFit
45 – 4850



Абатмент Xive Locator
GH 1 26 – 3321
GH 2 26 – 3322
GH 3 26 – 3323
GH 4 26 – 3324
GH 5 26 – 3325



Шаровидный абатмент Friadent
GH 1 45 – 3151
GH 2 45 – 3152
GH 3 45 – 3153
GH 5 45 – 3155



Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки
46 – 9650



Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки
46 – 9657



Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки
46 – 9658



Телескопический абатмент Friadent
45 – 2650



Абатмент Friadent MP прямой A 0
GH 1 46 – 2841
GH 2 46 – 2842
GH 3 46 – 2843
GH 5 46 – 2845
GH 9 46 – 2849



Абатмент Xive MP угловой D 3.8 – D 5.5

A 15	A 30
GH 2 46 – 2942	GH 2 46 – 3042
GH 3 46 – 2943	GH 3 46 – 3043
GH 5 46 – 2945	

Индивидуальные ортопедические компоненты



Абатмент Xive TitaniumBase
27 – 9050

Абатмент Xive ScanBase
27 – 9150



Абатменты Atlantis для Xive



Супра-структуры Atlantis для Xive

Снятие оттиска на уровне абатмента (только для MP)



Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP
46 – 8250



Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP
46 – 8150



Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP D 3.8
46 – 8240



Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP D 3.8
46 – 8140

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ассортимент Xive®

D 5.5

Имплантаты	Винт-заглушка	Формирователь десны	Снятие оттиска на уровне имплантата	Стандартные абатменты
 **Имплантат Xive S plus D 5.5** L 8 26 – 2460 L 9.5 26 – 2461 L 11 26 – 2462 L 13 26 – 2463 L 15 26 – 2465	 **Винт-заглушка Friadent** 45 – 1160	 **Формирователь десны Friadent** GH 1 45 – 1461 GH 2 45 – 1462 GH 3 45 – 1463 GH 5 45 – 1465  **Формирователь десны Friadent с отверстиями** GH 3 45 – 1363 GH 5 45 – 1365	 **Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent** GH 3 46 – 8263 GH 5 46 – 8265  **Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent** GH 3 46 – 8163 GH 5 46 – 8165  **Аналог имплантата Friadent для фрезерования** 45 – 2661  **Аналог имплантата Friadent** 45 – 4060	**Одиночная коронка**  **Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0** GH 1 46 – 2161 GH 2 46 – 2162 GH 3 46 – 2163 GH 5 46 – 2165  **Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15** GH 1 46 – 2261 GH 2 46 – 2262 GH 3 46 – 2263 GH 5 46 – 2265 **Мостовидный протез**  **Абатмент Friadent EstheticBase прямой A 0** GH 1 46 – 2161 GH 2 46 – 2162 GH 3 46 – 2163 GH 5 46 – 2165  **Абатмент Friadent EstheticBase угловой A 15** GH 1 46 – 2261 GH 2 46 – 2262 GH 3 46 – 2263 GH 5 46 – 2265 **Перекрывающий протез / протез на балке**  **Абатмент Friadent MP прямой A 0** GH 1 46 – 2861 GH 2 46 – 2862 GH 3 46 – 2863 GH 5 46 – 2865  **Абатмент Xive MP угловой A 15** GH 2 46 – 2942 GH 3 46 – 2943 GH 5 46 – 2945 **A 30** GH 2 46 – 3042 GH 3 46 – 3043

Переключение платформ

Параметры внутреннего шестигранного соединения у имплантатов Xive D 5.5, D 4.5 и D 3.8 одинаковы. Вы можете устанавливать абатменты D 3.8 и D 4.5 на имплантаты Xive D 5.5 для переключения платформ. Подробная информация изложена в брошюре «Переключение платформ» и в Руководстве по ортопедии Xive.

	 **Винт-заглушка Friadent** 45 – 1150	 **Формирователь десны Friadent** GH 1 45 – 1451 GH 2 45 – 1452 GH 3 45 – 1453 GH 5 45 – 1455  **Формирователь десны Friadent тонкий** GH 2 45 – 1252 GH 3 45 – 1253 GH 5 45 – 1255	 **Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent** GH 3 46 – 8253 GH 5 46 – 8255  **Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent** GH 3 46 – 8153 GH 5 46 – 8155  **Трансфер Friadent тонкий** 45 – 1259	**Переключение платформ**  **Абатмент Friadent EstheticBase прямой** GH 1 46 – 2151 GH 2 46 – 2152 GH 3 46 – 2153 GH 5 46 – 2155  **Абатмент Friadent EstheticBase угловой** GH 1 46 – 2251 GH 2 46 – 2252 GH 3 46 – 2253 GH 5 46 – 2255

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Стандартные ортопедические компоненты	Индивидуальные ортопедические компоненты	Снятие оттиска на уровне абатмента (только для MP)
 **Абатмент Friadent CeraBase** конический 45 – 2560  анатомический 45 – 2561  **Абатмент Friadent AuroBase** 45 – 2460		
 **Абатмент Friadent MP прямой A 0** GH 1 46 – 2861 GH 2 46 – 2862 GH 3 46 – 2863 GH 5 46 – 2865  **Абатмент Xive MP угловой** A 15: GH 2 46 – 2942, GH 3 46 – 2943, GH 5 46 – 2945 A 30: GH 2 46 – 3042, GH 3 46 – 3043  **Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста** 46 – 9560  **Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста** 46 – 9960  **Абатмент Friadent AuroBase** 45 – 2460  **Набор Friadent PassivFit** 45 – 4860	 **Абатмент Xive TitaniumBase** 27 – 9060  **Абатмент Xive ScanBase** 27 – 9160  **Абатменты Atlantis для Xive**  **Супраструктуры Atlantis для Xive**	 **Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP** 46 – 8260  **Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP** 46 – 8160
 **Абатмент Xive Locator** GH 1 26 – 3331 GH 2 26 – 3332 GH 3 26 – 3333 GH 4 26 – 3334 GH 5 26 – 3335  **Шаровидный абатмент Friadent** GH 1 45 – 3161 GH 2 45 – 3162 GH 3 45 – 3163 GH 5 45 – 3165		
 **Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки** 46 – 9660  **Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки** 46 – 9667  **Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки** 46 – 9668  **Телескопический абатмент Friadent** 45 – 2660		
 **Абатмент Friadent MP прямой A 0** GH 1 46 – 2851 GH 2 46 – 2852 GH 3 46 – 2853 GH 5 46 – 2855 GH 9 46 – 2859  **Абатмент Xive MP угловой D 3.8 – D 5.5** A 15: GH 2 46 – 2942, GH 3 46 – 2943, GH 5 46 – 2945 A 30: GH 2 46 – 3042, GH 3 46 – 3043		 **Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP D 4.5** 46 – 8250  **Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP D 4.5** 46 – 8150

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ассортимент Xive® TG

Имплантаты	Винт-заглушка	Оттиски
 **Имплантат Xive TG plus D 3.4** L 9.5 25 – 2431 L 11 25 – 2432 L 13 25 – 2433 L 15 25 – 2435  **Имплантат Xive TG plus D 3.8** L 8 25 – 2440 L 9.5 25 – 2441 L 11 25 – 2442 L 13 25 – 2443 L 15 25 – 2445  **Имплантат Xive TG plus D 4.5** L 8 25 – 2450 L 9.5 25 – 2451 L 11 25 – 2452 L 13 25 – 2453 L 15 25 – 2455	 **Винт-заглушка Xive TG D 3.4 – D 4.5** 25 – 1400	 **Аналог имплантата / аналог для пайки Xive TG D 3.4 – D 4.5** 25 – 4010

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Стандартные ортопедические компоненты	Индивидуальные балочные конструкции и мостовидные протезы
Одиночная коронка / мостовидный протез	
 Абатмент Xive TG, прямой / A 0 D 3.4 – D 4.5 25 – 4500	 Набор Friadent PassivFit D 3.8 45 – 4840
 Абатмент Xive TG, угловой / A 15 D 3.4 – D 4.5 25 – 4510	 Отливаемый колпачок Xive TG D 3.4 – D 4.5 25 – 4245
Абатмент Xive TG AuroBase D 3.4 – D 4.5 25 – 4520	Приливаемый колпачок Xive TG D 3.4 – D 4.5 25 – 4246
	 Супраструктуры Atlantis для Xive TG
Перекрывающий протез / протез на балке	
 Лабораторный набор с золотым колпачком для балки Xive TG D 3.4 – D 4.5 25 – 9600	 Аттачмент Xive TG D 3.4 – D 4.5 25 – 4401
 Лабораторный набор с титановым колпачком для балки Xive TG D 3.4 – D 4.5 25 – 9700	
 Лабораторный набор с отливаемым колпачком для балки Xive TG D 3.4 – D 4.5 25 – 9800	
	 Супраструктуры Atlantis для Xive TG

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Рекомендуемые значения торка

Ортопедические компоненты	Торк
Винт-заглушка Friadent, винт-заглушка Xive TG и винт-заглушка Xive PS D 3.4 	макс. 14 Нсм
Формирователь десны Friadent и формирователь десны Xive PS 	14 Нсм
Временный абатмент Friadent EstheticCap 	14 Нсм

Ортопедические компоненты	Торк
Абатменты Friadent EstheticBase и Xive EstheticBase PS прямые / A 0 и угловые / A 15 	24 Нсм
Абатмент Friadent AuroBase 	24 Нсм
Телескопический абатмент Friadent 	24 Нсм
Абатмент Friadent CeraBase 	24 Нсм
Абатмент Friadent Cercon прямой / A 0 и угловой / A 15 	24 Нсм
Абатмент Atlantis 	24 Нсм



Ручная шестигранная отвертка Friadent
14 Нсм
Ширина 0,9 мм
Арт. 45 – 5732 короткая
Арт. 45 – 5733 длинная (не показана)



Ручная шестигранная отвертка Friadent
24 Нсм
Ширина 1,22 мм
Арт. 45 – 5734 короткая
Арт. 45 – 5736 длинная (не показана)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ортопедические компоненты	Торк
Абатменты Xive TitaniumBase и Xive ScanBase	24 Нсм
Шаровидный абатмент Friadent	24 Нсм
Набор Friadent PassivFit	24 Нсм
Приливаемые втулки Friadent Xive MP и Xive TG	24 Нсм
Отливаемые втулки Friadent Xive MP и Xive TG	24 Нсм
Все балочные колпачки Friadent и Xive TG	24 Нсм

Ортопедические компоненты	Торк
Абатменты Friadent MP прямые и угловые, абатмент Xive MP PS	24 Нсм
Абатмент Xive Locator	30 Нсм



Ручная шестигранная отвертка Friadent
24 Нсм
Ширина 1,22 мм
Арт. 45 – 5734 короткая
Арт. 45 – 5736 длинная (не показана)



1 | Насадка для ключа-трещотки Friadent для платформы MP абатмента 24 Нсм
Арт. 46 – 5610

2 | ВСТАВКА FRIADENT Locator для ортопедического ключа-трещотки 30 Нсм
Арт. 45 – 3344

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Упаковка имплантата

Все имплантаты Xive поставляются в двойной стерильной блистерной упаковке, помещенной в картонную коробку. Такой тип упаковки гарантирует максимальную защищенность медицинского изделия в соответствии со строгими современными нормативами. Кроме того, эта форма упаковки эргономична в использовании, облегчает хранение и извлечение имплантата.



Внешняя упаковка

- Простая идентификация продукта благодаря бренд-специфичному дизайну, прозрачному окошку и цветовой маркировке диаметра имплантата
- Крупная наклейка с подробной информацией о продукте
- При складировании вся важная информация остается видна
- Инструкция по использованию на нескольких языках



Прозрачный внешний блистер

- Внешний стерильный блистер упаковки имплантата



Прозрачный внутренний блистер

- Внутренняя стерильная упаковка
- Содержит вкладыш с имплантатом и винт-заглушку
- Отрывная наклейка с номером партии для четкой документации при лечении



Пластмассовый вкладыш с имплантатом

- Надежно удерживает имплантат в упаковке и защищает его от повреждений в процессе транспортировки и извлечения из упаковки
- Обеспечивает простой бесконтактный захват и извлечение имплантата
- Имеет три крыла с шероховатой нескользящей поверхностью для простого и безопасного извлечения имплантата

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Имплантаты

Xive S

Xive упрощает достижение идеальной первичной стабильности в кости любой плотности. ActiveBoneControl — комбинация инновационного дизайна резьбы имплантата и особого протокола формирования ложа — позволяет добиваться нужных результатов с Xive S даже в кости неоптимального качества. Каждый имплантат Xive S комплектуется держателем TempBase, который можно использовать в качестве временного абатмента, поэтому сразу же после операции можно с минимальными затратами изготовить высококачественный эстетичный и функциональный временный протез.



Xive TG

Первичная стабильность трансгингивальных имплантатов Xive TG достигается в кости любой плотности. ActiveBoneControl — комбинация инновационного дизайна резьбы имплантата и особого протокола формирования ложа — позволяет добиваться нужных результатов с Xive TG даже в кости неоптимального качества. Имплантаты XiVE TG подходят для протезирования при полной адентии с изготовлением протеза на балке с опорой на 4 имплантата или мостовидного протеза с винтовой фиксацией на 6 или более имплантатах, а также для замещения одиночных включенных или концевых дефектов.







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Имплантаты Xive® S plus

Винт-заглушка Friadent²

Для имплантатов Ø D 3.0



Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.0
Арт.	45 – 1120

Для имплантатов Ø D 3.4



Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4
Арт.	45 – 1130

Для имплантатов Ø D 3.8 D 4.5 D 5.5



Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.8
Арт.	45 – 1140

Для имплантатов Ø D 4.5 D 5.5



Масштаб 1,2:1



Ø	D 4.5
Арт.	45 – 1150

Для имплантатов Ø D 5.5



Масштаб 1,2:1



Ø	D 5.5
Арт.	45 – 1160

Винт-заглушка Xive PS D 3.4

- Первичное переключение платформ на имплантатах D 3.8 и D 4.5.
- Переключение платформ следует начинать не с формирователя десны или абатмента, а с винта-заглушки. Это способствует достижению клинического успеха.

Винт-заглушку Xive PS D 3.4 необходимо заказывать отдельно.

Винт-заглушка Xive PS D 3.4

Для имплантатов Ø D 3.8 D 4.5



Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4
Арт.	45 – 1110

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Имплантат Xive S plus

Масштаб 1:1



Ø	D 3.0	D 3.0	D 3.0
Длина	11 мм	13 мм	15 мм
Арт.	26 – 2422	26 – 2423	26 – 2425

Масштаб 1:1



Ø	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Длина	9,5 мм	11 мм	13 мм	15 мм	18 мм
Арт.	26 – 2431	26 – 2432	26 – 2433	26 – 2435	26 – 2438

Масштаб 1:1



Ø	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Длина	8 мм	9,5 мм	11 мм	13 мм	15 мм	18 мм
Арт.	26 – 2440	26 – 2441	26 – 2442	26 – 2443	26 – 2445	26 – 2448

Масштаб 1:1



Ø	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Длина	8 мм	9,5 мм	11 мм	13 мм	15 мм	18 мм
Арт.	26 – 2450	26 – 2451	26 – 2452	26 – 2453	26 – 2455	26 – 2458

Масштаб 1:1



Ø	D 5.5	D 5.5	D 5.5	D 5.5	D 5.5
Длина	8 мм	9,5 мм	11 мм	13 мм	15 мм
Арт.	26 – 2460	26 – 2461	26 – 2462	26 – 2463	26 – 2465

Имплантат Xive S plus (стерильный)
Комплектация: имплантат[2], TempBase[4], винт-заглушка[2]

Показания к применению Xive D 3.4 – 5.5
- Замещение одного зуба
- Немедленное протезирование при адекватной первичной стабильности имплантатов
- Одиночные реставрации, мостовидные и съемные протезы

Показания к применению Xive D 3.0
- Одиночные реставрации во фронтальном отделе 12 + 22 и 32 - 42
- Объединенные одиночные реставрации во фронтальном отделе 32 - 42
- Нефункциональная немедленная нагрузка

Вид заживления
- Закрытое или открытое с формирователем десны или временным протезом

Упаковка имплантата
- Все имплантаты Xive поставляются в двойной стерильной упаковке (см. стр. 16).

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка имплантата:
Имплантовод Xive (стр. 81)

Раскручивание винта TempBase, фиксация винта-заглушки:
Шестигранная отвертка Xive 0,9 мм (стр. 81)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Имплантаты Xive® TG plus

Имплантат Xive TG plus (стерильный)
Комплектация: имплантат[3], установочная головка
Показания
- Замещение одного зуба
- Опора для мостовидных и съемных протезов

Вид заживления
- Открытое с формирователем десны или временным протезом

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка имплантата:
Имплантовод Xive для имплантатов Xive S D 3.4 и TempBase (стр. 81)

Раскручивание винта адаптера, фиксация винта-заглушки:
Шестигранная отвертка Xive 0,9 мм (стр. 81)

Имплантат Xive TG plus

Масштаб 1:1



Ø	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Длина Арт.	9,5 мм 25 – 2431	11 мм 25 – 2432	13 мм 25 – 2433	15 мм 25 – 2435

Масштаб 1:1



Ø	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Длина Арт.	8 мм 25 – 2440	9,5 мм 25 – 2441	11 мм 25 – 2442	13 мм 25 – 2443	15 мм 25 – 2445

Масштаб 1:1



Ø	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Длина Арт.	8 мм 25 – 2450	9,5 мм 25 – 2451	11 мм 25 – 2452	13 мм 25 – 2453	15 мм 25 – 2455

Винт-заглушка Xive TG[2]

Для имплантатов Ø D 3.4 D 3.8 D 4.5 Масштаб 1,2:1




Арт.	25 – 1400

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Многофункциональность: концепция TempBase 3 в 1

Многофункциональный компонент TempBase предустановлен на всех имплантатах Xive S plus и служит в первую очередь установочной головкой имплантата. TempBase можно впоследствии использовать в качестве временного абатмента, даже не снимая его с имплантата. Это позволит изготовить временную реставрацию без дополнительных расходов и без лишней травмы окружающих тканей. Стандартный колпачок TempBase Cap, который защелкивается на TempBase, дает возможность изготовить временный протез (внешне очень похожий на будущий постоянный) быстро и просто, не прибегая к помощи лаборатории, и сдать его пациенту в день операции максимум на 3 месяца (нефункциональное немедленное протезирование). Второй хирургический этап в виде раскрытия имплантата при этом отсутствует.


Если планируется двухэтапная имплантологическая операция, то сразу после установки имплантата можно снять оттиск, используя TempBase. На основе этого оттиска зубной техник сможет изготовить точно сидящий временный протез высокого качества, который будет зафиксирован на имплантатах в момент их раскрытия на втором хирургическом этапе.

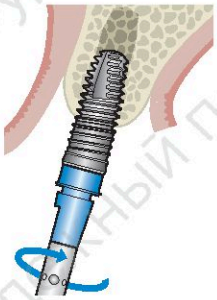

TempBase — установочная головка



TempBase — трансфер для индексационного оттиска



TempBase — основа временной реставрации



Friadent TempBase[4]
с винтом TempBase

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	46 – 1220	46 – 1230	46 – 1240	46 – 1250	46 – 1260

Колпачок Friadent TempBase Cap[28]

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.0 – D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	46 – 1235	46 – 1255	46 – 1265

Винт Friadent TempBase[4]

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.0	D 3.4 – D 5.5
Арт.	46 – 1279	46 – 1280

Friadent TempBase
- Держатель имплантата и установочная головка

Friadent TempBase с TempBase Cap
- Трансфер для снятия индексационного оттиска после имплантации
- Основа для изготовления временной реставрации

Friadent TempBase предустановлен на имплантате.
Friadent TempBase Cap необходимо заказывать отдельно.

ИНСТРУМЕНТЫ


Раскручивание и фиксация винта TempBase, фиксация винта-заглушки:
Шестигранная отвертка Xive 0,9 мм (стр. 81)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Формирователь десны

Формирователь десны Friadent
- Простое формирование контура мягких тканей вокруг имплантата
- Подбор формирователя по диаметру имплантата (D) и высоте десны (GH)





Примечание.
Формирователи десны высотой GH 1 не имеют дополнительного шлица.

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация формирователя десны:
Шестигранная отвертка Friadent 0,9 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Формирователь десны Friadent²

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø D 3.0



Ø / Высота десны	GH 1	GH 2	GH 3	GH 5
D 3.0	45 – 1421	45 – 1422	45 – 1423	45 – 1425

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø D 3.4



Ø / Высота десны	GH 1	GH 2	GH 3	GH 5
D 3.4	45 – 1431	45 – 1432	45 – 1433	45 – 1435

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø D 3.8 D 4.5 D 5.5



Ø / Высота десны	GH 1	GH 2	GH 3	GH 5
D 3.8	45 – 1441	45 – 1442	45 – 1443	45 – 1445

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø D 4.5 D 5.5



Ø / Высота десны	GH 1	GH 2	GH 3	GH 5
D 4.5	45 – 1451	45 – 1452	45 – 1453	45 – 1455

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø D 5.5



Ø / Высота десны	GH 1	GH 2	GH 3	GH 5
D 5.5	45 – 1461	45 – 1462	45 – 1463	45 – 1465

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Менеджмент мягких тканей

Формирователь десны Friadent² тонкий

Масштаб 1,2:1





Для имплантатов Ø

D 3.4

Ø Высота десны	D 3.4 GH 2	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.	45 – 1232	45 – 1233	45 – 1235

Масштаб 1,2:1





Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø Высота десны	D 3.8 GH 2	D 3.8 GH 3	D 3.8 GH 5
Арт.	45 – 1242	45 – 1243	45 – 1245

Масштаб 1,2:1





Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Ø Высота десны	D 4.5 GH 2	D 4.5 GH 3	D 4.5 GH 5
Арт.	45 – 1252	45 – 1253	45 – 1255

Формирователь десны Friadent тонкий

- Формирование идеального контура мягких тканей в условиях мезио-дистально ограниченного пространства
- Для снятия оттиска используется тонкий трансфер (стр. 31)




Для снятия оттиска используйте тонкий трансфер Friadent.

Формирователь десны Xive PS

Масштаб 1,2:1






Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5

Ø Высота десны	D 3.4 GH 1	D 3.4 GH 2	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.	45 – 1531	45 – 1532	45 – 1533	45 – 1535

Формирователь десны Xive PS тонкий

Масштаб 1,2:1





Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5

Ø Высота десны	D 3.4 GH 2	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.	45 – 1222	45 – 1223	45 – 1225

Формирователь десны Xive PS


- Формирование контура мягких тканей в случаях, когда планируется установить на имплантате абатмент меньшего диаметра (концепция переключения платформ)
- Обеспечивает долгосрочное поддержание достигнутого эстетического результата

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Формирователь десны

Формирователь десны Friadent с отверстиями

- Для простого закрепления шовной нити, что упрощает работу с мягкими тканями и делает ее более предсказуемой



Формирователь десны Friadent² с отверстиями

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1





Ø Высота десны	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.	45 – 1333	45 – 1335

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1





Ø Высота десны	D 3.8 GH 3	D 3.8 GH 5
Арт.	45 – 1343	45 – 1345

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1





Ø Высота десны	D 4.5 GH 3	D 4.5 GH 5
Арт.	45 – 1353	45 – 1355

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1





Ø Высота десны	D 5.5 GH 3	D 5.5 GH 5
Арт.	45 – 1363	45 – 1365

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Менеджмент мягких тканей

Временный абатмент EsthetiCap

Friadent EsthetiCap[24/52]
с винтом для EsthetiCap

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.4



Ø

D 3.4
овальный

Арт.	46 – 1730

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5





Ø

D 3.8
овальный

D 3.8
треугольный

Арт.	46 – 1740	46 – 1745

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5





Ø

D 4.5
овальный

D 4.5
треугольный

Арт.	46 – 1750	46 – 1755

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 5.5





Ø

D 5.5
овальный

D 5.5
треугольный

Арт.	46 – 1760	46 – 1765

Временный абатмент Friadent EsthetiCap

- Для изготовления высокоэстетичных временных коронок и мостовидных протезов
- Две анатомические формы поперечного сечения: овальная и треугольная
- Можно индивидуализировать путем сошлифовывания или наслоения материала
- Можно цементировать
- Рентгеноконтрастен (содержит диоксид циркония)

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта EsthetiCap:
Шестигранная отвертка Friadent 0,9 мм (стр. 93)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Универсальные и простые в использовании ортопедические компоненты

Xive так же индивидуален, как клинические ситуации. Вот уже более двух десятилетий врачи-ортопеды и зубные техники работают с абатментами Xive. Вне зависимости от того, планируете ли вы изготовить коронку, мостовидный или съемный протез, ассортимент стандартных и индивидуализируемых ортопедических компонентов настолько широк, что позволяет предложить пациенту любые решения как стандартного, так и премиум класса даже в самых сложных клинических условиях. Присмотритесь, и вы поймете, что отличает имплантационную систему Xive от других.

Ключевой особенностью дизайна Xive является скошенная структурно-полированная шейка имплантата с встроенным переключением платформ. Такой дизайн положительно сказывается на состоянии тканей вокруг имплантата, особенно при установке на имплантате абатмента меньшего диаметра. Для достижения успеха с концепцией переключения платформ крайне важно, чтобы все компоненты, последовательно сменяющиеся на имплантате, были уменьшенного диаметра, начиная с винта-заглушки. Все необходимые компоненты имеются в ортопедическом ассортименте Xive. Рядом с каждым артикулом указаны компоненты, которые потребуются для реализации концепции переключения платформ.





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снятие оттиска на уровне имплантата

Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent

Для имплантатов Ø

D 3.0

Масштаб 1,2:1





Ø Высота десны	D 3.0 GH 3	D 3.0 GH 5
Арт.	46 – 8223	46 – 8225

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1





Ø Высота десны	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.	46 – 8233	46 – 8235

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1





Ø Высота десны	D 3.8 GH 3	D 3.8 GH 5
Арт.	46 – 8243	46 – 8245

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1





Ø Высота десны	D 4.5 GH 3	D 4.5 GH 5
Арт.	46 – 8253	46 – 8255

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1





Ø Высота десны	D 5.5 GH 3	D 5.5 GH 5
Арт.	46 – 8263	46 – 8265

Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent
Комплектация: трансфер, длинный винт (D 3.0 с длинным винтом D 3.0), оттискной колпачок Friadent и аналог имплантата.

Трансфер Friadent

- Для переноса расположения имплантата на мастер-модель
- Имеются трансферы для открытой и закрытой ложек

Трансфер GH 3 используется при толщине десны ≤ 3 мм. Если толщина десны больше 3 мм, используйте трансфер GH 5.





GH 3 GH 5

Головка трансфера уплощена с двух сторон.

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация длинного винта, а также стандартного винта абатмента и D 3.0:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (D 3.4 – D 5.5) (стр. 93)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снятие оттиска на уровне имплантата

НАБОРЫ

Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent
Комплектация: трансфер, стандартный винт (D 3.0 со стандартным винтом D 3.0), оттискной колпачок Friadent и аналог имплантата.

Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.0

Ø	D 3.0	D 3.0
Высота десны	GH 3	GH 5
Арт.	46 – 8123	46 – 8125



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.4

Ø	D 3.4	D 3.4
Высота десны	GH 3	GH 5
Арт.	46 – 8133	46 – 8135



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø	D 3.8	D 3.8
Высота десны	GH 3	GH 5
Арт.	46 – 8143	46 – 8145



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Ø	D 4.5	D 4.5
Высота десны	GH 3	GH 5
Арт.	46 – 8153	46 – 8155



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 5.5

Ø	D 5.5	D 5.5
Высота десны	GH 3	GH 5
Арт.	46 – 8163	46 – 8165



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снятие оттиска на уровне имплантата

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Трансфер Friadent
(для открытой ложки)

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø
Высота десны

D 3.0





Арт.	45 – 1625	45 – 1622

Трансфер Friadent (для открытой ложки)
с длинным винтом (D 3.0 с длинным винтом D 3.0) и оттискным колпачком Friadent

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø
Высота десны

D 3.4





Арт.	45 – 1635	45 – 1632

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация длинного винта, а также стандартного винта абатмента и D 3.0:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (D 3.4 – D 5.5)
(стр. 93)

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø
Высота десны

D 3.8 D 4.5 D 5.5





Арт.	45 – 1645	45 – 1642

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø
Высота десны

D 4.5 D 5.5





Арт.	45 – 1655	45 – 1652

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

Ø
Высота десны

D 5.5





Арт.	45 – 1665	45 – 1662

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снятие оттиска на уровне имплантата

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Оттискный трансфер Friadent (метод закрытой ложки)
со стандартным винтом (D 3.0
со стандартным винтом D 3.0)
и оттискным колпачком Friadent

Оттискный трансфер Friadent (метод закрытой ложки)

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.0

Ø Высота десны	D 3.0 GH $3^{4,20}$	D 3.0 GH $5^{4,20}$
Арт.	45 – 1620	45 – 1621

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.4

Ø Высота десны	D 3.4 GH $3^{2,4,20}$	D 3.4 GH $5^{2,4,20}$
Арт.	45 – 1630	45 – 1631

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø Высота десны	D 3.8 GH $3^{2,4,20}$	D 3.8 GH $5^{2,4,20}$
Арт.	45 – 1640	45 – 1641

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Ø Высота десны	D 4.5 GH $3^{2,4,20}$	D 4.5 GH $5^{2,4,20}$
Арт.	45 – 1650	45 – 1651

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 5.5

Ø Высота десны	D 5.5 GH $3^{2,4,20}$	D 5.5 GH $5^{2,4,20}$
Арт.	45 – 1660	45 – 1661

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снятие оттиска на уровне имплантата

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Трансфер Friadent тонкий[2]
(без винта)

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø


D 3.4



Ø D 3.4

Арт.	45 – 1239

Трансфер Friadent базовый[2]
(с длинным винтом[4])



D 3.4

46 – 1632

Трансфер Friadent тонкий[2]

- В условиях мезио-дистально ограниченного пространства
- Для снятия слепков после тонкого формирователя десны (стр. 23)

Примечание.
Длинный винт для открытой ложки и стандартный винт необходимо заказывать отдельно (стр. 32)

Масштаб 1,2:1


Для implantатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5



Ø D 3.8

Арт.	45 – 1249



D 3.8

46 – 1642

Трансфер Friadent базовый

- Упрощает снятие оттиска при расхождении осей имплантатов

Масштаб 1,2:1


Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5



Ø D 4.5

Арт.	45 – 1259



D 4.5

46 – 1652

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 5.5

Ø

Арт.



D 5.5

46 – 1662

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снятие оттиска на уровне имплантата

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Длинный винт трансфера Friadent[4]

Масштаб 1,2:1




Ø	D 3.0	D 3.4 – D 5.5
Арт.	46 – 1605	45 – 1615

Стандартный винт абатмента Friadent[4]

Масштаб 1,2:1




Ø	D 3.0	D 3.4 – D 5.5
Арт.	46 – 4304	45 – 4305

Оттискной колпачок Friadent

- Обеспечивает максимальную точность при снятии оттиска
- Входит в комплект поставки трансферов для открытой и закрытой ложек

Набор оттискных колпачков Friadent[20] (3 шт.)

Масштаб 1,2:1








Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	45 – 1629	45 – 1639	45 – 1649	45 – 1659	45 – 1669

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снятие оттиска на уровне имплантата

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЛАТФОРМ

Трансфер Xive PS для открытой ложки с длинным винтом и оттискным колпачком Friadent

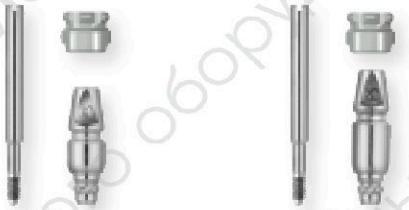

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø D 3.8

Ø Высота десны	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.	45 – 1835	45 – 1832

Трансфер Xive PS для закрытой ложки со стандартным винтом и оттискным колпачком Friadent



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø D 3.8

Ø Высота десны	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.	45 – 1830	45 – 1831

Трансфер Xive PS тонкий (без винта)



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø D 3.8

Ø	D 3.4
Арт.	45 – 1238

Примечание.
Все абатменты с переключением платформ имеют лазерную маркировку PS.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снятие оттиска на уровне имплантата

АНАЛОГИ ИМПЛАНТАТОВ

Аналог имплантата Friadent
- Для фиксации ортопедических компонентов на мастер-модели

Аналог имплантата Friadent[5]

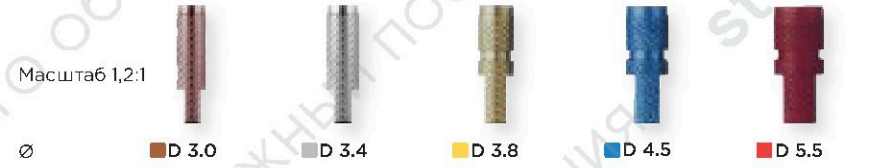

Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	45 – 4020	45 – 4030	45 – 4040	45 – 4050	45 – 4060

Аналог имплантата Friadent для фрезерования
- Предназначен для фиксации фрезеруемых ортопедических компонентов
- Изготовлен из специальной стали и имеет выраженные ретенционные элементы для противостояния силам ротации при фрезеровании абатмента

Аналог имплантата Friadent для фрезерования[6]



Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	45 – 2621	45 – 2631	45 – 2641	45 – 2651	45 – 2661

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снятие оттиска на уровне абатмента

НАБОРЫ

Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4
Арт.	46 – 8230

Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP



D 3.4
46 – 8130

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.8
Арт.	46 – 8240



D 3.8
46 – 8140

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø	D 4.5
Арт.	46 – 8250



D 4.5
46 – 8150

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø	D 5.5
Арт.	46 – 8260



D 5.5
46 – 8160

Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP
Комплектация: трансфер MP для открытой ложки, длинный винт MP, аналог MP

Трансфер Friadent

- Для переноса положения абатмента MP на мастер-модель
- Имеются трансферы для открытой и закрытой ложек
- В момент снятия оттиска абатмент MP остается на имплантате

Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP
Комплектация: трансфер MP для закрытой ложки, аналог MP

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация длинного винта трансфера MP (для открытой ложки):
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Фиксация короткого винта трансфера MP (для закрытой ложки):
Шестигранная отвертка Friadent 0,9 мм (стр. 93)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снятие оттиска на уровне абатмента

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Длинный винт трансфера Friadent MP[4]

Масштаб 1,2:1



Арт.	46 – 1615

Для имплантатов Ø	Масштаб 1,2:1	Трансфер Friadent MP для открытой ложки[2] с длинным винтом MP	Трансфер Friadent MP для закрытой ложки[2]
D 3.4			
	Ø	D 3.4	D 3.4
	Арт.	46 – 1630	46 – 1635
D 3.8 D 4.5 D 5.5			
	Ø	D 3.8	D 3.8
	Арт.	46 – 1640	46 – 1645
D 4.5 D 5.5			
	Ø	D 4.5	D 4.5
	Арт.	46 – 1650	46 – 1655
D 5.5			
	Ø	D 5.5	D 5.5
	Арт.	46 – 1660	46 – 1665

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Аналог Friadent MP[5]

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	46 – 4030	46 – 4040	46 – 4050	46 – 4060

Аналог Friadent MP
- Включен в состав лаб. наборов MP для слепков
- Передается в лабораторию вместе со слепком

Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для моста

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	45 – 4102

Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для балки



Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	45 – 4101

Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для моста
Комплектация: универсальный аналог Friadent для пайки и паечный винт для моста

Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для балки
Комплектация: универсальный аналог Friadent для пайки и паечный винт для балки

Аналог Friadent для пайки[6] универсальный

Винт Friadent для пайки для моста[4]

Винт Friadent для пайки для балки[4]

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 5.5	D 3.4 – D 5.5	D 3.4 – D 5.5
Арт.	45 – 4103	45 – 4207	45 – 4206

Аналог Friadent для пайки
- Для стабилизации каркаса на паечном основании


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Абатмент EstheticBase

Абатмент Friadent EstheticBase
- Для высокоэстетичных одиночных коронок и мостовидных протезов
- Прямые и угловые
- Можно обтачивать
- Цементная или винтовая фиксация (горизонтальная или трансверзальная)

Примечание.
Область применения абатментов D 3.0 ограничивается фронтальной зоной.

Горизонтальная винтовая фиксация
Во всех абатментах Friadent EstheticBase имеется горизонтальное отверстие с резьбой (M 1.4). Для горизонтальной фиксации реставрации потребуется дополнительный горизонтальный или трансверзальный винт (стр. 40).



GH 1 1 мм | GH 2 2 мм | GH 3 3 мм | GH 5 5 мм

Абатмент Friadent EstheticBase прямой / A 0 с винтом абатмента EstheticBase (D 3.0 со стандартным винтом D 3.0)

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.0



Ø / Высота десны	D 3.0 GH 1[4]	D 3.0 GH 2[4]	D 3.0 GH 3[4]	D 3.0 GH 5[4]
Арт.	46 – 2121	46 – 2122	46 – 2123	46 – 2125

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.4



Ø / Высота десны	D 3.4 GH 1[4]	D 3.4 GH 2[4]	D 3.4 GH 3[4]	D 3.4 GH 5[4]
Арт.	46 – 2131	46 – 2132	46 – 2133	46 – 2135

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5



Ø / Высота десны	D 3.8 GH 1[2]	D 3.8 GH 2[2]	D 3.8 GH 3[2]	D 3.8 GH 5[2]
Арт.	46 – 2141	46 – 2142	46 – 2143	46 – 2145

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта абатмента EstheticBase и стандартного винта абатмента D 3.0: Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм (стр. 93)

Для обтачивания абатментов рекомендуется использовать специальные титановые сверла (Gebr. Brasseler, Lemgo или Jota, Германия).

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5



Ø / Высота десны	D 4.5 GH 1[2]	D 4.5 GH 2[2]	D 4.5 GH 3[2]	D 4.5 GH 5[2]
Арт.	46 – 2151	46 – 2152	46 – 2153	46 – 2155

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 5.5



Ø / Высота десны	D 5.5 GH 1[2]	D 5.5 GH 2[2]	D 5.5 GH 3[2]	D 5.5 GH 5[2]
Арт.	46 – 2161	46 – 2162	46 – 2163	46 – 2165

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Абатмент Friadent EstheticBase угловой / A 15

с винтом абатмента EstheticBase
(D 3.0 со стандартным винтом D 3.0)

Для имплантатов Ø

D 3.0

Масштаб 1,2:1



Ø Высота десны	D 3.0 GH 1[4]	D 3.0 GH 2[4]	D 3.0 GH 3[4]	D 3.0 GH 5[4]
Арт.	46 – 2221	46 – 2222	46 – 2223	46 – 2225

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1



Ø Высота десны	D 3.4 GH 1[4]	D 3.4 GH 2[4]	D 3.4 GH 3[4]	D 3.4 GH 5[4]
Арт.	46 – 2231	46 – 2232	46 – 2233	46 – 2235

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø Высота десны	D 3.8 GH 1[2]	D 3.8 GH 2[2]	D 3.8 GH 3[2]	D 3.8 GH 5[2]
Арт.	46 – 2241	46 – 2242	46 – 2243	46 – 2245

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø Высота десны	D 4.5 GH 1[2]	D 4.5 GH 2[2]	D 4.5 GH 3[2]	D 4.5 GH 5[2]
Арт.	46 – 2251	46 – 2252	46 – 2253	46 – 2255

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø Высота десны	D 5.5 GH 1[2]	D 5.5 GH 2[2]	D 5.5 GH 3[2]	D 5.5 GH 5[2]
Арт.	46 – 2261	46 – 2262	46 – 2263	46 – 2265

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Абатмент EstheticBase

Абатмент Xive EstheticBase PS
- Реставрация с переключением платформ на имплантатах D 3.8 и D 4.5
- Обеспечивает долгосрочное поддержание результатов лечения

Примечание.
Все абатменты с переключением платформ имеют лазерную маркировку PS.

Абатмент Xive EstheticBase PS прямой / A 0 с винтом для EstheticBase

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø D 3.8 D 4.5

Ø Высота десны	D 3.4 GH 1	D 3.4 GH 2	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.	46 – 2331	46 – 2332	46 – 2333	46 – 2335

Абатмент Xive EstheticBase PS угловой / A 15 с винтом для EstheticBase

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø D 3.8 D 4.5

Ø Высота десны	D 3.4 GH 1	D 3.4 GH 2	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.	46 – 2431	46 – 2432	46 – 2433	46 – 2435

Стандартный винт абатмента Friadent[4]

Масштаб 1,2:1



D 3.0

Винт Friadent для EstheticBase[4]



D 3.4 – D 5.5

Посадочное кольцо для горизонтального винта Friadent[8]



Арт.	46 – 4304	46 – 4305	45 – 4410

Горизонтальный винт Friadent
- Винт, проходящий стенку коронки и абатмента в горизонтальном направлении с оральной стороны

Трансверзальный винт Friadent
- Фиксация коронки с оральной и с вестибулярной стенки абатмента
- Удвоенная длина резьбы для оптимальной стабильности
- Горизонтальный винт используется как трансверзальный для абатментов D 3.0 и D 3.4 для максимального задействования длины резьбы

Для моляров предпочтительнее использование длинных горизонтальных винтов из-за большей толщины коронок.

Набор с горизонтальным винтом Friadent
Стандартный[4] или длинный[4] горизонтальный винт и посадочное кольцо для горизонтального винта[8]

Набор с трансверзальным винтом Friadent
Стандартный[4] или длинный[4] трансверзальный винт и посадочное кольцо для горизонтального винта[8]

Масштаб 1,2:1



	стандартный	длинный	стандартный	длинный
Арт.	46 – 4403	46 – 4404	46 – 4407	46 – 4408

Горизонтальный винт Friadent[4]

Трансверзальный винт Friadent[4]

Масштаб 1,2:1



	стандартный	длинный	стандартный	длинный
Арт.	46 – 4401	46 – 4402	46 – 4405	46 – 4406

ИНСТРУМЕНТЫ
Фиксация горизонтального и трансверзального винтов:
Шестигранная отвертка Friadent 0,9 мм (стр. 93)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Абатмент Cercon®

Абатмент Friadent Cercon[52], прямой / A 0
с винтом Friadent
для EstheticBase[4]



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø Оттенок Высота десны	D 3.8 нейтральный GH 1	D 3.8 дентин GH 1	D 3.8 нейтральный GH 2	D 3.8 дентин GH 2
Арт.	47 – 1141	47 – 2141	47 – 1142	47 – 2142



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Ø Оттенок Высота десны	D 4.5 нейтральный GH 1	D 4.5 дентин GH 1	D 4.5 нейтральный GH 2	D 4.5 дентин GH 2
Арт.	47 – 1151	47 – 2151	47 – 1152	47 – 2152

Абатмент Friadent Cercon[52], угловой / A 15
с винтом Friadent
для EstheticBase[4]



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø Оттенок Высота десны	D 3.8 нейтральный GH 1	D 3.8 дентин GH 1	D 3.8 нейтральный GH 2	D 3.8 дентин GH 2
Арт.	47 – 1241	47 – 2241	47 – 1242	47 – 2242



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Ø Оттенок Высота десны	D 4.5 нейтральный GH 1	D 4.5 дентин GH 1	D 4.5 нейтральный GH 2	D 4.5 дентин GH 2
Арт.	47 – 1251	47 – 2251	47 – 1252	47 – 2252

Примечание.
Область использования керамических абатментов ограничивается фронтальным отделом.

Абатмент Friadent Cercon

- Для фронтальных цельнокерамических реставраций, максимально приближенных к естественным зубам
- Очень прочные, изготовлены из диоксида циркония
- Прямые и угловые
- Индивидуализируемые путем шлифования или литья
- Два оттенка белого: нейтральный и дентин
- Непревзойденная эстетика с великолепной светопередачей

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм (стр. 93)

Для обтачивания абатментов Friadent Cercon рекомендуется использовать набор боров для керамики Shaping Set компании DeguDent.

Обтачивание абатментов Cercon проводится с водным охлаждением.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Абатмент CeraBase

Абатмент Friadent CeraBase
- Двухкомпонентный абатмент для высококачественных одиночных керамических реставраций во фронтальном отделе
- Керамическая втулка на титановом основании
- Конический и анатомический дизайн

Абатмент Friadent CeraBase со стандартным винтом[4]

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.4

Ø	D 3.4 конический[30/4]	D 3.4 анатомический[30/4]
Арт.	45 – 2530	45 – 2531

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø	D 3.8 конический[30/3]	D 3.8 анатомический[30/3]
Арт.	45 – 2540	45 – 2541

Стандартный винт абатмента Friadent[4]

Масштаб 1,2:1



Ø D 3.4 – D 5.5

Арт.	45 – 4305

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Ø	D 4.5 конический[30/3]	D 4.5 анатомический[30/3]
Арт.	45 – 2550	45 – 2551

Для имплантатов Ø

D 5.5

Ø	D 5.5 конический[30/3]	D 5.5 анатомический[30/3]
Арт.	45 – 2560	45 – 2561

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация стандартного винта абатмента:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Обтачивание керамической втулки абатмента Friadent CeraBase:
Набор Friadent CeraBase (стр. 95)

При обтачивании водное охлаждение не требуется.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Абатмент AuroBase

Абатмент Friadent AuroBase[20/8] со стандартным винтом абатмента[4] (D 3.0 со стандартным винтом D 3.0)



Для имплантатов Ø D 3.0

Масштаб 1,2:1	
Ø	D 3.0
Арт.	45 – 2420

Абатмент Friadent AuroBase
- Для сложных клинических случаев, требующих изготовления индивидуальных компонентов для коронок, мостов и других типов протезов
- Для компенсации значительного расхождения осей имплантатов
- Для индивидуального воскового моделирования от уровня имплантата в случае тонкой десны



Для имплантатов Ø D 3.4

Масштаб 1,2:1	
Ø	D 3.4
Арт.	45 – 2430

Стандартный винт абатмента Friadent D 3.0[4]



Масштаб 1,2:1	
Ø	D 3.0
Арт.	46 – 4304



Для имплантатов Ø D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1	
Ø	D 3.8
Арт.	45 – 2440

Стандартный винт абатмента Friadent[4]



Масштаб 1,2:1	
Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	45 – 4305



Для имплантатов Ø D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1	
Ø	D 4.5
Арт.	45 – 2450

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация стандартного винта абатмента и D 3.0:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)



Для имплантатов Ø D 5.5

Масштаб 1,2:1	
Ø	D 5.5
Арт.	45 – 2460

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Телескопический абатмент

Телескопический абатмент Friadent
- Простой и недорогой способ изготовления съемных и несъемных протезов на телескопической фиксации
- Для индивидуальных одиночных коронок
- Компенсация расходящихся осей имплантатов путем фрезерования

Телескопические абатменты можно облицовывать керамикой для титана (например, Duceratin, Ducera или Vita Titankeramik, Vita Zahnfabrik) для изготовления одиночных коронок с окклюзионной винтовой фиксацией.

Используйте телескопические абатменты Friadent D 3.0 только для прямой облицовки. Прямая облицовка телескопических абатментов D 3.0 и D 3.4 керамикой для титана невозможна.

Телескопический абатмент Friadent со стандартным винтом[4] (D 3.0 со стандартным винтом D 3.0)

Для имплантатов Ø D 3.0

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.0[4]
Арт.	45 – 2620

Для имплантатов Ø D 3.4

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4[4]
Арт.	45 – 2630

Стандартный винт абатмента Friadent D 3.0[4]

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.0
Арт.	46 – 4304

Для имплантатов Ø D 3.8 D 4.5

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.8[2]
Арт.	45 – 2640

Стандартный винт абатмента Friadent[4]

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	45 – 4305

Для имплантатов Ø D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø	D 4.5[2]
Арт.	45 – 2650

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация стандартного винта абатмента и D 3.0:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Для имплантатов Ø D 5.5

Масштаб 1,2:1



Ø	D 5.5[2]
Арт.	45 – 2660

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Абатмент MP

Абатмент Friadent MP
Платформа MP и винт MP



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.4

Ø	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Высота десны	GH 1[4]	GH 2[4]	GH 3[4]	GH 5[4]
Арт.	46 – 2831	46 – 2832	46 – 2833	46 – 2835



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Высота десны	GH 1[2/4]	GH 2[2/4]	GH 3[2/4]	GH 5[2/4]	GH 9[2/4]
Арт.	46 – 2841	46 – 2842	46 – 2843	46 – 2845	46 – 2849



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Ø	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Высота десны	GH 1[2/4]	GH 2[2/4]	GH 3[2/4]	GH 5[2/4]	GH 9[2/4]
Арт.	46 – 2851	46 – 2852	46 – 2853	46 – 2855	46 – 2859



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 5.5

Ø	D 5.5	D 5.5	D 5.5	D 5.5
Высота десны	GH 1[2/4]	GH 2[2/4]	GH 3[2/4]	GH 5[2/4]
Арт.	46 – 2861	46 – 2862	46 – 2863	46 – 2865

Абатмент Friadent MP

- Для простого и точного изготовления мостовидных протезов с использованием приливаемых или более экономичных отливаемых втулок
- Для перекрывающих протезов на балках
- Абатменты остаются во рту, супраструктура изготавливается на аналогах абатментов MP
- Работа на наддесневом уровне: простое снятие оттиска, простая примерка супраструктуры

Абатмент MP состоит из платформы MP и винта MP. Абатмент подбирается по высоте (толщине) десны. Количество колец на головке винта указывает на десневую высоту соответствующей винту платформы MP.

GH 1 = 1 кольцо
GH 2 = 2 кольца
GH 3 = 3 кольца
GH 5 = 5 колец



ИНСТРУМЕНТЫ

Установка платформы абатмента MP на имплантате:
Инструмент для установки Friadent для платформ шаровидного и MP абатментов (стр. 95)

Фиксация платформы абатмента MP:
Шестигранная отвертка Friadent для платформы абатмента MP (стр. 95)

Фиксация винта-заглушки MP:
Шестигранная отвертка Friadent 0,9 мм (стр. 93)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Абатмент MP

Абатмент Xive MP PS
- Реставрация с переключением платформ на имплантатах D 3.8 и D 4.5
- Обеспечивает долгосрочное поддержание результатов лечения

Примечание.
Все абатменты с переключением платформ имеют лазерную маркировку PS.

Абатмент Xive MP PS
с винтом

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5

Ø Высота десны	D 3.4 GH 1	D 3.4 GH 2	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.	46 - 2921	46 - 2922	46 - 2923	46 - 2925

Винт-заглушка Friadent MP²

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	46 - 1430	46 - 1440	46 - 1450	46 - 1460

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Концепция SmartFix®



Ортопедическое решение на угловых имплантатах

Эффективная концепция лечения SmartFix экономит время за счет немедленной нагрузки реставраций с винтовой фиксацией на четырех имплантатах. Это обеспечивает стабильную ортопедическую посадку и позволяет обойти анатомически сложные области при помощи угловых абатментов Xive MP 15° или 30°.

Супраструктура может быть изготовлена как традиционным способом, так и CAD/CAM-методом (Atlantis), обеспечивающим высокую точность посадки.

Абатмент Xive MP, угловой[4] / A 15
(с головкой Xive MP[4], заранее установленной на имплантоводе)



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.4

Ø / Высота десны	D 3.4 GH 2	D 3.4 GH 3	D 3.4 GH 5
Арт.	46 – 2932	46 – 2933	46 – 2935

Платформа абатмента Xive MP[4] на держателе
(как запасная часть)



Масштаб 1,2:1

Арт.	46 – 3100



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø / Высота десны	D 3.8 – D 5.5 GH 2	D 3.8 – D 5.5 GH 3	D 3.8 – D 5.5 GH 5
Арт.	46 – 2942	46 – 2943	46 – 2945

Абатмент Xive MP, угловой[4] / A 30
(с головкой Xive MP[4], заранее установленной на имплантоводе)



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.4

Ø / Высота десны	D 3.4 GH 2	D 3.4 GH 3
Арт.	46 – 3032	46 – 3033



Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø / Высота десны	D 3.8 – D 5.5 GH 2	D 3.8 – D 5.5 GH 3
Арт.	46 – 3042	46 – 3043

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Мостовидный протез

НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста
Комплектация: отливаемая втулка, винт MP для втулки

Лаб. наборы Friadent MP для моста
- Для простого и точного изготовления мостовидных протезов с использованием приливаемых или более экономичных отливаемых втулок
- Можно также использовать для фрезеруемых балок

Отливаемая втулка:
Перед фиксацией мостовидного протеза следует обработать поверхность абатмента, прилегающую к супраструктуре, а также посадочную площадку винта шаберами Friadent (стр. 96).

Винт Friadent MP для отливаемой втулки[4]

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	46 – 4300

Для имплантатов Ø	**Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста**	**Отливаемая втулка Friadent**[21]
D 3.4	Масштаб 1,2:1 	
	Ø D 3.4	D 3.4
	Арт. 46 – 9530	45 – 4330
D 3.8 D 4.5 D 5.5	Масштаб 1,2:1 	
	Ø D 3.8	D 3.8
	Арт. 46 – 9540	45 – 4340
D 4.5 D 5.5	Масштаб 1,2:1 	
	Ø D 4.5	D 4.5
	Арт. 46 – 9550	45 – 4350
D 5.5	Масштаб 1,2:1 	
	Ø D 5.5	D 5.5
	Арт. 46 – 9560	45 – 4360

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта MP для отливаемой втулки:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста

Приливаемая втулка Friadent[20/8]

Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста
Комплектация: приливаемая втулка, винт MP для отливаемой втулки

Лаб. наборы Friadent MP для моста
- Для простого и точного изготовления мостовидных протезов с использованием приливаемых или более экономичных отливаемых втулок
- Можно также использовать для фрезеруемых балок

Приливаемая втулка:
Обработка шаберами не требуется.

Для имплантатов Ø

D 3.4

Масштаб 1,2:1





Ø	D 3.4	D 3.4
Арт.	46 – 9930	45 – 4630

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1





Ø	D 3.8	D 3.8
Арт.	46 – 9940	45 – 4640

Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Масштаб 1,2:1





Ø	D 4.5	D 4.5
Арт.	46 – 9950	45 – 4650

Винт Friadent MP для отливаемой втулки[4]

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	46 – 4300

Для имплантатов Ø

D 5.5

Масштаб 1,2:1





Ø	D 5.5	D 5.5
Арт.	46 – 9960	45 – 4660

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта MP для отливаемой втулки:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Набор PassivFit, ретенционные гильзы MP

Винт Friadent MP для отливаемой втулки[4]

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	46 – 4300

D 3.4

Винт Xive MP длинный

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	46 – 4301

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Набор Friadent PassivFit²

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	45 – 4830	45 – 4840	45 – 4850	45 – 4860

Ретенционная гильза Xive MP короткая



	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	46 – 3130	46 – 3140	46 – 3150	46 – 3160

Ретенционная гильза Xive MP длинная



	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	46 – 3230	46 – 3240	46 – 3250	46 – 3260

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Балочные конструкции

НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

	Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки	Золотой колпачок Friadent для балки[9] (без винта)
Для имплантатов Ø D 3.4	Масштаб 1,2:1  Ø D 3.4 Арт. 46 – 9630	 D 3.4 45 – 4230
Для имплантатов Ø D 3.8 D 4.5 D 5.5	Масштаб 1,2:1  Ø D 3.8 Арт. 46 – 9640	 D 3.8 45 – 4240
Для имплантатов Ø D 4.5 D 5.5	Масштаб 1,2:1  Ø D 4.5 Арт. 46 – 9650	 D 4.5 45 – 4250
Для имплантатов Ø D 5.5	Масштаб 1,2:1  Ø D 5.5 Арт. 46 – 9660	 D 5.5 45 – 4260

Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки
Комплектация: золотой колпачок для балки, винт для колпачка MP

Лаб. наборы Friadent MP для балки
- Для перекрывающих протезов на балках
- Простой стандартизованный зуботехнический протокол при использовании готовых круглых балок (см. отдельные компоненты)

Индивидуальные отфрезерованные балки изготавливаются с использованием отливаемых и приливаемых втулок (см. стр. 48–49).

Золотой колпачок Friadent для балки
- Золотосодержащий сплав для паечной техники

Винт Friadent MP для колпачка[4]

Масштаб 1,2:1

Ø D 3.4 – D 5.5
Арт. 46 – 4200

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта MP для колпачка:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Активация балочной клипсы:
Активатор балочной клипсы Friadent (стр. 96)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Балочные конструкции

НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки
Комплектация: титановый колпачок для балки, винт для колпачка MP

Лаб. наборы Friadent MP для балки
- Для перекрывающих протезов на балках
- Простой стандартизованный зуботехнический протокол при использовании готовых круглых балок (см. отдельные компоненты)

Индивидуальные отфрезерованные балки изготавливаются с использованием отливаемых и приливаемых втулок (см. стр. 48–49).

Титановый колпачок для балки Friadent
- Титан для лазерной сварки

Винт Friadent MP для колпачка[4]

Масштаб 1,2:1

Ø D 3.4 – D 5.5

Арт.	46 – 4200

Для имплантатов Ø	Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки	Титановый колпачок Friadent для балки[2] (без винта)
D 3.4	Масштаб 1,2:1 	
	Ø D 3.4	D 3.4
	Арт. 46 – 9637	45 – 4231
D 3.8 D 4.5 D 5.5	Масштаб 1,2:1 	
	Ø D 3.8	D 3.8
	Арт. 46 – 9647	45 – 4241
D 4.5 D 5.5	Масштаб 1,2:1 	
	Ø D 4.5	D 4.5
	Арт. 46 – 9657	45 – 4251
D 5.5	Масштаб 1,2:1 	
	Ø D 5.5	D 5.5
	Арт. 46 – 9667	45 – 4261

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта MP для колпачка:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Активация балочной клипсы:
Активатор балочной клипсы Friadent (стр. 96)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

D 3.4

Ø	D 3.4
Арт.	46 – 9638

Отливаемый колпачок Friadent для балки[21] (без винта)



D 3.4

D 3.4
45 – 4530

Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки
Комплектация: отливаемый колпачок для балки, винт для колпачка MP

Лаб. наборы Friadent MP для балки

- Для перекрывающих протезов на балках
- Простой стандартизованный зуботехнический протокол при использовании готовых круглых балок (см. отдельные компоненты)

Индивидуальные отфрезерованные балки изготавливаются с использованием отливаемых и приливаемых втулок (см. стр. 48-49).

Отливаемый колпачок для балки Friadent

- Для индивидуальной моделировки

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø	D 3.8
Арт.	46 – 9648



D 3.8
45 – 4540

Винт Friadent MP для колпачка[4]

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	46 – 4200

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Ø	D 4.5
Арт.	46 – 9658



D 4.5
45 – 4550

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта MP для колпачка:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Активация балочной клипсы:
Активатор балочной клипсы Friadent (стр. 96)

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

D 5.5

Ø	D 5.5
Арт.	46 – 9668



D 5.5
45 – 4560

Золотая круглая балка Friadent[9]

Уменьшенный масштаб



Длина 50 мм
45 – 4210

Титановая круглая балка Friadent[2]



Длина 50 мм
45 – 4212

Золотая клипса для балки Friadent[9]



Длина 50 мм
45 – 4215

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Концепция Locator®



Возможность простой и надежной фиксации съемного протеза с опорой на имплантаты является важным фактором успеха протезирования в пожилом возрасте. Xive Locator существенно упрощает правильное размещение съемных протезов в верхней и нижней челюстях даже у пациентов с ограниченной подвижностью, небольшим окклюзионным объемом или в случаях с расходящимися имплантатами.


Система Xive Locator

- Перекрывающие протезы на двух имплантатах (при полной адентии)
- Самоцентровка для простой фиксации во рту — посадка со щелчком
- Небольшая высота — удобно для постановки зубов при минимальной окклюзионной высоте
- Индивидуально подбираемая степень ретенции и возможность скомпенсировать расхождение осей имплантатов до 40°

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация абатмента Locator:
3-компонентная отвертка Locator или вставка Friadent Locator для ортопедического ключа-трещотки (стр. 96)

Для выбора подходящего абатмента Locator нужно знать диаметр имплантата и толщину десны. Толщина десны определяет десневую высоту абатмента. Правильно подобранный абатмент должен возвышаться над десной на 1,5 мм, что соответствует высоте функциональной части абатмента.



Примечание:
Функциональная часть абатмента должна быть расположена супрагингивально.

Абатмент Xive Locator⁴

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

D 3.4

Ø	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Высота десны	GH 1	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5
Арт.	26 – 3301	26 – 3302	26 – 3303	26 – 3304	26 – 3305

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Высота десны	GH 1	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5
Арт.	26 – 3311	26 – 3312	26 – 3313	26 – 3314	26 – 3315

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Ø	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Высота десны	GH 1	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5
Арт.	26 – 3321	26 – 3322	26 – 3323	26 – 3324	26 – 3325

Масштаб 1,2:1



Для имплантатов Ø

D 5.5

Ø	D 5.5	D 5.5	D 5.5	D 5.5	D 5.5
Высота десны	GH 1.3	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5
Арт.	26 – 3331	26 – 3332	26 – 3333	26 – 3334	26 – 3335

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Сменные патрицы Locator[41] (4 шт.)

Масштаб 1,2:1



	прозрачные, сильная ретенция	розовые, слабая ретенция	синие, очень слабая ретенция	расширенный спектр: серые, нулевая ретенция	расширенный спектр: зеленые, сильная ретенция	расширенный спектр: оранжевые, слабая ретенция	расширенный спектр: красные, очень слабая ретенция
Арт.	45 – 3349	45 – 3350	45 – 3351	45 – 3360	45 – 3352	45 – 3353	45 – 3354

Оттискные колпачки Locator[42] (4 шт.)

Масштаб 1,2:1



Арт.	45 – 3355

Набор аттачментов Locator (с 2 патрицами каждого типа)



	Титан[43]	Нержавеющая сталь[44]
Арт.	45 – 3347	45 – 3348

Матричные аналоги Locator[45] (4 шт.)



	D 4	D 5
Арт.	45 – 3356	45 – 3357

Состав набора аттачментов Locator:

- 2 матрицы
- 2 спейсерных кольца
- 2 сменные прозрачные патрицы, сильная ретенция
- 2 сменные розовые патрицы, слабая ретенция
- 2 сменные синие патрицы, очень слабая ретенция

Черные рабочие патрицы Locator[46] (4 шт.)

Масштаб 1,2:1



Арт.	45 – 3358

Спейсерные кольца Locator[47] (20 шт.)

Арт.	45 – 3359

Спейсерные колпачки Locator[48] (4 шт.)

Арт.	45 – 3361

Втулка держателя абатмента Locator[50] (4 шт.)

Арт.	45 – 3341

3-компонентная отвертка Locator[49] со втулкой держателя абатмента Locator

Уменьшенный масштаб



Арт.	45 – 3340

Вставка Friadent Locator для ортопедического ключа-трещотки[6]



Арт.	45 – 3344

Угломер Locator[51]



Арт.	45 – 3345

Штифты Locator для проверки параллельности осей[46] (4 шт.)



Арт.	45 – 3346

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Шаровидный абатмент

Шаровидный абатмент Friadent
Комплектация: платформа абатмента[2], винт абатмента[4], матрица абатмента, черное силиконовое кольцо[26] и белое силиконовое кольцо[26]

Шаровидный абатмент Friadent
- Для фиксации перекрывающих протезов на имплантатах на нижней челюсти
- Простой протокол с возможностью прямой перебазировки
- Компенсация расходящихся осей имплантатов

Матрица шаровидного абатмента Friadent[9] с белым силиконовым кольцом[26]

Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	45 – 3200

Аналог патрицы шар. абатмента Friadent[5] универсальный

Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	45 – 4105

Аналог патрицы шар. абатмента Friadent
- Для перебазировки и починки перекрывающих протезов
- Универсальный — для всех диаметров

Уплотнительное кольцо Friadent[26]

Арт.	45 – 3210

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка платформы:
Инструмент для установки Friadent для платформ шаровидного и MP абатментов (стр. 95)

Фиксация винта абатмента:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм (стр. 93)

Активация/деактивация матрицы абатмента:
Активатор/деактиватор Friadent для шаровидного абатмента (стр. 95)

Шаровидный абатмент Friadent



Для имплантатов Ø

D 3.4

Ø	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Высота десны	GH 1[4]	GH 2[4]	GH 3[4]
Арт.	45 – 3131	45 – 3132	45 – 3133



Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5

Ø	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Высота десны	GH 1[2]	GH 2[2]	GH 3[2]	GH 5[2]
Арт.	45 – 3141	45 – 3142	45 – 3143	45 – 3145



Для имплантатов Ø

D 4.5 D 5.5

Ø	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Высота десны	GH 1[2]	GH 2[2]	GH 3[2]	GH 5[2]
Арт.	45 – 3151	45 – 3152	45 – 3153	45 – 3155



Для имплантатов Ø

D 5.5

Ø	D 5.5	D 5.5	D 5.5	D 5.5
Высота десны	GH 1[2]	GH 2[2]	GH 3[2]	GH 5[2]
Арт.	45 – 3161	45 – 3162	45 – 3163	45 – 3165

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Индивидуальные ортопедические компоненты

Абатмент Xive TitaniumBase⁴
с винтом

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5



Ø	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	27 – 9040	27 – 9050	27 – 9060

Абатмент Xive ScanBase²⁴

Масштаб 1,2:1

Для имплантатов Ø

D 3.8 D 4.5 D 5.5



Ø	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	27 – 9140	27 – 9150	27 – 9160

Абатмент Xive TitaniumBase

- Для изготовления индивидуальных керамических абатментов с титановым основанием
- Керамический абатмент склеивается с титановым основанием, имеющим стандартное соединение с имплантатом
- Две плоские поверхности препятствуют ротации

Абатмент Xive ScanBase

- Для сканирования геометрии абатмента
- Дизайн тот же, что и у TitaniumBase; изготовлен из пластмассы; нет необходимости в использовании спрея или порошка для сканирования
- Подходит для всех обычных дентальных сканеров

Винт Friadent для EstheticBase⁴



Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	46 – 4305

Atlantis®

Абатменты и супраструктуры Atlantis для Xive

Для протезирования на имплантатах Xive S помимо стандартных абатментов и индивидуальных абатментов, изготовляемых традиционными методами, можно использовать индивидуальные абатменты CAD/CAM. Это расширяет диапазон возможностей врача в воссоздании эстетики и функции.
На абатментах Atlantis возможно изготовление одиночных реставраций с цементной и винтовой фиксацией. Такие абатменты производятся из биосовместимых материалов: титана, титана золотистого оттенка и диоксида циркония.
Atlantis — это широкие возможности при изготовлении индивидуальных супраструктур для протезирования при полной или частичной адентии. Супраструктура фиксируется на двух и более имплантатах, при этом протез может быть как несъемным, так и съемным на аттачментах. Супраструктуры изготавливаются из двух материалов: титан или кобальт-хром*; можно заказать супраструктуру с отполированной до блеска поверхностью.

За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю компании Dentsply Sirona Implants.



Индивидуальные абатменты Atlantis для Xive

- Выбор придесневого контура анатомической формы для превосходной функциональности и эстетики
- Границы уступа разработаны и размещены на идеальном уровне для простого и безопасного удаления избытков цемента
- Комплексная программа гарантийного обслуживания

Супраструктуры Atlantis для Xive

- Гибкость в подходе к протезированию при частичной и полной адентии
- Точная посадка супраструктуры без напряжений
- Материалы изготовления: титан и кобальт-хром

* Atlantis 2в1 изготавливаются только из титана.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Концепция WeldOne®



Временные реставрации на уровне имплантата

С помощью сварочного аппарата WeldOne и специальных инструментов для сварки титановая проволока прочно приваривается к абатменту. Точно рассчитанная доза электроэнергии обеспечивает оптимальное качество сварки титановых компонентов. Сварка осуществляется за несколько миллисекунд при прохождении электрического тока через точку контакта титановой проволоки с титановым абатментом. Крепкое, надежное соединение компонентов дает возможность изготовить стабильный иммедиат-каркас для оптимальной опоры временного или временно-постоянного протеза. Концепция WeldOne™ разработана эксклюзивно для имплантатов компании Dentsply Sirona Implants.

Примечание. Предварительным условием приобретения сварочного аппарата WeldOne является прохождение специализированных курсов. За дополнительной информацией, в т.ч. по специализированным курсам, обращайтесь к местному представителю компании.


Временный сварочный абатмент Xive
- Для внутриротового или внеротового изготовления титанового каркаса временного иммедиат-протеза на имплантатах Xive методом электросварки.

Винт Friadent для EstheticBase[4]

Ø	D 3.4 – D 5.5
Арт.	46 – 4305

Временный сварочный абатмент Xive[3] с винтом для EstheticBase[4]

Масштаб 1,2:1

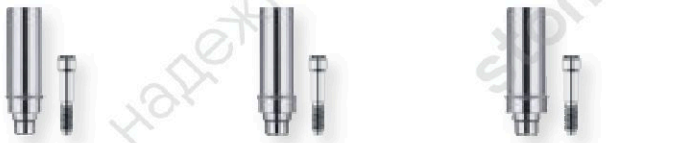

Ø	D 3.4	D 3.8	D 4.5
Арт.	46 – 1231	46 – 1241	46 – 1251

Реставрации на уровне абатмента

Сварочная втулка Xive MP
- Для внутриротового или внеротового изготовления титанового каркаса временного протеза на абатментах MP сразу после имплантации или в более поздние сроки.

Винт для сварочной втулки[4]

Арт.	46 – 1616

Сварочная втулка Xive MP[3] с винтом для сварочной втулки[4]

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 3.8	D 4.5
Арт.	45 – 4741	45 – 4751

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта абатмента:
Шестигранная отвертка Friadent короткая/длинная (стр. 93)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Титановая проволока Friadent (10 шт.)



Уменьшенный масштаб	D 1.2 / L 100 Титан 2 класса	D 1.5 / L 150 Титан 2 класса	D 2.0 / L 150 Титан 2 класса
Арт.	47 – 3012	47 – 3013	47 – 3014

Вместе со специальными сварочными абатментами служит для внутриротового или внеротового изготовления каркаса протеза на имплантатах Dentsply Sirona Implants методом электросварки. Толщина титановой проволоки подбирается в зависимости от целей.

- D 1,2 мм — для дополнительных ретенций
- D 1,5 мм — если расстояние между имплантатами составляет до 8 мм
- D 2,0 мм — если расстояние между имплантатами составляет от 8 до 15 мм

Сварочный аппарат WeldOne



Уменьшенный масштаб

Арт.	47 – 4710

Сварочный аппарат WeldOne

- WeldOne — это аппарат для точечной внутри- и внеротовой сварки электросопротивлением в дентальной имплантологии.
- Аппарат предназначен для сваривания в полости рта титановой проволоки со специальными титановыми абатментами, установленными на дентальных имплантатах Dentsply Sirona Implants.



Щипцы для крутого изгиба
для создания выраженных изгибов на одиночных абатментах



Щипцы для плавного изгиба
для изгиба титановой проволоки по челюстной дуге



Держатель
для плотного удержания титановой балки во время сваривания

Кусачки с твердосплавными щечками
для простого и аккуратного откусывания проволоки



USTOMED® INSTRUMENTE

При сварке рекомендуется использовать специально разработанные инструменты, производимые компанией USTOMED. Эти немногочисленные простые инструменты позволят быстро изготовить титановый каркас. За подробной информацией обращайтесь в компанию USTOMED: www.ustomed.de

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Снятие оттиска

Трансферы Xive TG
- Для переноса положения трансгингивального имплантата на мастер-модель
- Имеются трансферы для открытой и закрытой ложек
- Имеется короткий трансфер для снятия оттиска с использованием имеющегося перекрывающего протеза

Если при расхождении осей имплантатов перенос четырехгранника головки не требуется, то используется трансфер Friadent MP D 3.8 (стр. 36). Этот трансфер совместим с имплантатами Xive TG всех диаметров.

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация длинного винта трансфера TG:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Трансфер для открытой ложки Xive TG[2] с длинным винтом



Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.4 – D 4.5
Арт.	25 – 1805

Длинный винт трансфера Xive TG[4]



Ø	D 3.4 – D 4.5
Арт.	25 – 1701

Оттискный трансфер Xive TG[2]



Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.4 – D 4.5
Арт.	25 – 1600

Оттискный трансфер Xive TG (короткий)[2]



Ø	D 3.4 – D 4.5
Арт.	25 – 1605

Аналоги имплантатов

Аналог имплантата / аналог для пайки Xive TG
- Для фиксации ортопедических компонентов на мастер-модели, а также для стабилизации каркаса на паечной основе

Аналог имплантата / аналог для пайки Xive TG[6]



Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.4 – D 4.5
Арт.	25 – 4010

Лаб. набор Xive TG с аналогом имплантата / аналогом для пайки[4,6] (для моста)



Ø	D 3.4 – D 4.5 Аналог имплантата XiVE TG для пайки с винтом для абатмента
Арт.	25 – 4105

Лаб. набор Xive TG с аналогом для пайки (для балки)[4,6]



Ø	D 3.4 – D 4.5 Аналог имплантата XiVE TG для пайки с винтом для колпачка
Арт.	25 – 4106

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Мостовидный протез

Отливаемая втулка Xive TG[21]
с винтом абатмента TG

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 4.5
Арт.	25 – 4245

Приливаемый колпачок Xive TG[20/8] с винтом абатмента TG



D 3.4 – D 4.5
25 – 4246

Компоненты мостовидного протеза Xive TG
- Для простого и точного изготовления мостовидных протезов с использованием приливаемых или более экономичных отливаемых втулок
- Можно также использовать для фрезеруемых балок

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винтов абатментов Xive TG и AuroBase
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Абатмент Xive® TG

Абатмент Xive TG[2] прямой / A 0
с винтом абатмента TG

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 4.5
Арт.	25 – 4500

Абатмент Xive TG[2] угловой / A 15
с винтом абатмента TG



D 3.4 – D 4.5
25 – 4510

Абатмент Xive TG
- Для изготовления одиночных коронок и мостовидных протезов
- Прямые и угловые
- Можно обтачивать
- Горизонтальная винтовая фиксация

Горизонтальный винт
Во всех абатментах Xive TG имеется горизонтальное отверстие с резьбой (M 1.4).
Для горизонтальной фиксации реставрации потребуется дополнительный горизонтальный или трансверзальный винт (стр. 40).

Для обтачивания абатментов рекомендуется использовать специальные титановые сверла (Gebr. Brasseler, Lemgo или Jota, Германия).

Абатмент Xive® TG AuroBase

Абатмент Xive TG AuroBase[20/8]
с винтом абатмента TG

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 4.5
Арт.	25 – 4520

Абатмент Xive TG AuroBase
- Для изготовления индивидуальной основы под коронку и индивидуальных абатментов для мостовидных протезов
- Для компенсации расходящихся осей имплантатов

Винт абатмента Xive TG[4]

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 4.5
Арт.	25 – 4300

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Балочные конструкции

Компоненты балочной конструкции Xive TG
- Для перекрывающих протезов на балках
- Простой стандартизованный зуботехнический протокол при использовании готовых круглых балок (см. отдельные компоненты)

Колпачки для балок Friadent
- Золотосодержащий сплав для паечной техники
- Титан для лазерной сварки
- Для индивидуальной моделировки

Индивидуальные отфрезерованные балки изготавливаются с использованием приливаемых втулок TG (стр. 61)

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация винта TG для колпачка:
Шестигранная отвертка Friadent 1,22 мм или шлицевая отвертка Friadent 2,0 мм (стр. 93)

Активация балочной клипсы:
Активатор балочной клипсы Friadent (стр. 96)

Винт для колпачка Xive TG[4]

Масштаб 1,2:1




Арт.	25 – 4200

Золотой колпачок для балки Xive TG[9] с винтом для колпачка TG

Титановый колпачок для балки Xive TG[2] с винтом для колпачка TG

Отливаемый колпачок для балки Xive TG[21] с винтом для колпачка TG

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.4 – D 4.5	D 3.4 – D 4.5	D 3.4 – D 4.5
Арт.	25 – 4240	25 – 4241	25 – 4242

Золотая круглая балка Friadent[9]

Титановая круглая балка Friadent[2]

Золотая клипса для балки Friadent[9]

Уменьшенный масштаб



	Длина 50 мм	Длина 50 мм	Длина 50 мм
Арт.	45 – 4210	45 – 4212	45 – 4215

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Шаровидный абатмент Xive® TG

Шаровидный абатмент Xive TG[2/4]



Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.4 – D 4.5
Арт.	25 – 4401

Шаровидный абатмент Xive TG
- Для фиксации перекрывающих протезов на имплантатах на нижней челюсти
- Простой протокол с возможностью прямой перебазировки
- Компенсация расходящихся осей имплантатов

Патрица абатмента Xive TG, двухкомпонентная

Арт.	25 – 4406

Матрица шаровидного абатмента Xive TG

Арт.	25 – 4411

Atlantis®

Супраструктуры Atlantis для Xive
Atlantis — это широкие возможности при изготовлении индивидуальных супраструктур для протезирования на Xive TG при полной или частичной адентии. Супраструктура фиксируется на двух и более имплантатах, при этом протез может быть как несъемным, так и съемным на аттачментах. Супраструктуры изготавливаются из двух материалов: титан или кобальт-хром*; можно заказать супраструктуру с отполированной до блеска поверхностью.

За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю компании Dentsply Sirona Implants.



Супраструктуры Atlantis для Xive
- Гибкость в подходе к протезированию при частичной и полной адентии
- Точная посадка супраструктуры без напряжений
- Материалы изготовления: титан и кобальт-хром

* Atlantis 2в1 изготавливаются только из титана.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Примерочные абатменты Friadent®

Примерочные абатменты Friadent
- Определение оро-вестибулярного и мезио-дистального расположения имплантата, а также расстояния от имплантата до соседних зубов
- Определение толщины десны, ангуляции и положения горизонтального винта (GH 2) для всех абатментов Friadent и Xive

Примерочный абатмент Friadent² / A 0 (прямой)

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	45 – 2119	45 – 2120	45 – 2121	45 – 2122	45 – 2123

Примерочный абатмент Friadent² / A 15 (угловой 15°)

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8
Арт.	45 – 2219	45 – 2220	45 – 2221

Набор примерочных абатментов Friadent² A 0 (прямые)
(3 шт.)

Ø	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	45 – 2193	45 – 2194	45 – 2195	45 – 2196

Набор примерочных абатментов Friadent² A 15 (угловые)
(3 шт.)

Ø	D 3.4	D 3.8
Арт.	45 – 2293	45 – 2294

Примерочная втулка Friadent
- Точный перенос плана в полость рта

Пин для примерочной втулки Friadent²

Масштаб 1,2:1



Арт.	91 – 4502

Примерочная втулка Friadent² по проф. Ф. Кури без пина

Масштаб 1,2:1



Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	45 – 5025	45 – 5035	45 – 5045	45 – 5055	45 – 5065

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Компоненты для планирования

Примерочный имплантат Xive²



Масштаб 1,2:1

Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	26 – 1520	26 – 1530	26 – 1540	26 – 1550	26 – 1560

Примерочные имплантаты Xive

- Проверка положения и оси имплантата, конгруэнтности имплантата и кости, а также расстояния до края десны во время операции

Глубиномер Xive²

D 2.0



Масштаб 1,2:1

Арт.	26 – 1510

Прочее

Рентгеноконтрастные шарики Friadent для предоперационной диагностики и планирования⁶



Рентгенологический шаблон Xive

	Ø 5 мм, 12 шт.	Xive S (субгингивальный)	Xive TG (трансгингивальный)
Арт.	49 – 1211	26 – 9020	25 – 5206

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Хирургические наборы

Простые, индивидуализируемые, экономичные, с минимальным количеством необходимых инструментов, модульный дизайн.

- При желании можно добавлять требуемые модули
- Инструменты надежно фиксируются в силиконовых вставках
- Простая и понятная последовательность использования инструментов во время операции
- Встроенный бокс для использованных инструментов
- Легко проводится тщательная очистка

Хирургический набор Xive D 3.0 – D 5.5 / S+L

Уменьшенный масштаб



D 3.0 – D 5.5

Все инструменты, необходимые для установки имплантатов Xive D 3.0 – D 5.5, длина инструментов: S (короткие) и L (длинные)

Арт.	26 – 6000

Хирургический набор Xive D 3.0 – D 3.8 / S



D 3.0 – D 3.8

Все инструменты, необходимые для установки имплантатов Xive D 3.0 – D 3.8, длина инструментов: S (короткие)

Арт.	26 – 6005

Хирургический набор Xive D 3.0 / S+L

Уменьшенный масштаб



D 3.0

Все инструменты, необходимые для установки имплантатов Xive D 3.0, длина инструментов: S (короткие) и L (длинные)

Арт.	26 – 6003

Хирургический набор Xive GS (навигационная хирургия)



D 3.0 – D 4.5

Все инструменты, необходимые для установки имплантатов Xive D 3.0 – D 4.5 L 8 – L 15 с использованием хирургического шаблона CAD/CAM

Арт.	26 – 5000

Состав наборов Xive	Модуль инструментов	Модуль сверл D 3.0	Модуль сверл D 3.4 & D 3.8	Модуль сверл D 4.5 & D 5.5	Пустой модуль для сверл по личному выбору	Модульная вставка
D 3.0 – D 5.5 / S + L	•	•	•	•		
D 3.0 – D 3.8 / S	•	•	•			•
D 3.0 / S + L	•	•			•	•

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Хирургические инструменты



Модуль сверл Xive (пустой)

	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	26 – 7025	26 – 7035	26 – 7045	26 – 7055	26 – 7065

Модуль инструментов Xive (пустой)

Модульная вставка Xive

Арт.	26 – 7200	26 – 7170

Лоток под хирургический набор Xive (пустой)

Лоток под хирургический набор Xive GS (пустой)

Арт.	26 – 7010	26 – 5010

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Хирургические наборы

Шаровидный бор Xive
D 3.0 */**
Арт. 26 – 1710

Вставка для трещотки для инструментов Xive */**
Арт. 26 – 6120 и 2 свободных гнезда

Ключ-трещотка Xive */**
Арт. 45 – 6020

Имплантовод Xive
D 3.0 / S */**
Арт. 26 – 6030
Имплантовод для имплантатов и TempBase Xive
D 3.4 / S */**
Арт. 26 – 6040
Имплантовод Xive
D 3.8 – D 5.5 / S **
Арт. 26 – 6050

Имплантовод Xive
D 3.0 / L *
Арт. 26 – 6035
Имплантовод для имплантатов и TempBase Xive
D 3.4 / L *
Арт. 26 – 6045
Имплантовод Xive
D 3.8 – D 5.5 / L
Арт. 26 – 6055

Винтовое сверло Xive
D 2.0 / S */**
Арт. 26 – 1715
Винтовое сверло Xive
D 2.0 / L *
Арт. 26 – 1718


3 штифта для проверки параллельности Friadent
D 2.0 / D 3.0 */**
Арт. 45 – 5106

3 свободных гнезда

Удлинитель Xive */**
Арт. 26 – 6130

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Хирургические инструменты

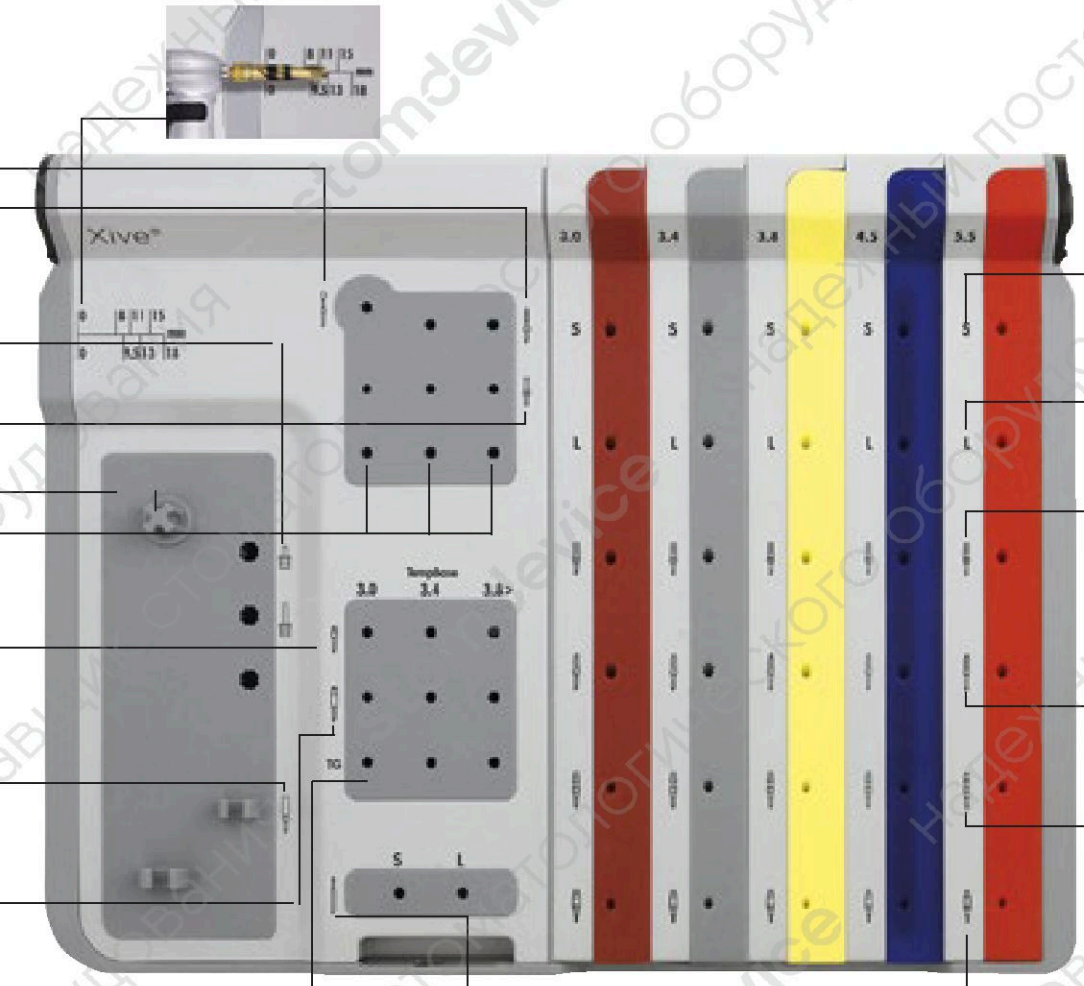

S Винтовое сверло Xive
D 3.0 / S Арт. 26 – 1725 */**
D 3.4 / S Арт. 26 – 1735 **
D 3.8 / S Арт. 26 – 1745 **
D 4.5 / S Арт. 26 – 1755
D 5.5 / S Арт. 26 – 1765

L Винтовое сверло Xive
D 3.0 / L Арт. 26 – 1728*
D 3.4 / L Арт. 26 – 1738
D 3.8 / L Арт. 26 – 1748
D 4.5 / L Арт. 26 – 1758
D 5.5 / L Арт. 26 – 1768

Кортикальное сверло Xive
D 3.0 Арт. 26 – 1720 */**
D 3.4 Арт. 26 – 1730 **
D 3.8 Арт. 26 – 1740 **
D 4.5 Арт. 26 – 1750
D 5.5 Арт. 26 – 1760

Метчик Xive
D 3.0 Арт. 26 – 1122 */**
D 3.4 Арт. 26 – 1132 **
D 3.8 Арт. 26 – 1142 **
D 4.5 Арт. 26 – 1152
D 5.5 Арт. 26 – 1162

Примерочный имплантат Xive
D 3.0 Арт. 26 – 1520 *
D 3.4 Арт. 26 – 1530
D 3.8 Арт. 26 – 1540
D 4.5 Арт. 26 – 1550
D 5.5 Арт. 26 – 1560

Имплантовод Xive TG
Арт. 25 – 6010 ** и 2 свободных гнезда

Шестигранная отвертка Xive
0,9 мм / S
Арт. 26 – 6190 */**
Шестигранная отвертка Xive
0,9 мм / L
Арт. 26 – 6195 *

Примерочный абатмент Friadent

D 3.0 / A 0 (прямой)	Арт. 45 – 2119 *
D 3.4 / A 0 (прямой)	Арт. 45 – 2120
D 3.8 / A 0 (прямой)	Арт. 45 – 2121
D 4.5 / A 0 (прямой)	Арт. 45 – 2122
D 5.5 / A 0 (прямой)	Арт. 45 – 2123

* Включено в хирургический набор Xive D 3.0 / S + L

** Включено в хирургический набор Xive D 3.0 – D 3.8 / S

Полный комплект инструментов содержится в хирургическом наборе Xive D 3.0 – D 5.5 / S + L

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Лоток Washtray

Лоток Washtray позволяет выполнять машинную очистку, дезинфекцию и последующую стерилизацию инструментов паром.

- Один лоток для всех этапов повторной обработки: быстро и выгодно
- Инструменты разложены и зафиксированы в лотке во время использования и на всех этапах повторной обработки
- Съемная накладка по структуре очень похожа на имеющиеся пластмассовые хирургические наборы, что позволяет интуитивно выбирать нужные инструменты во время операции
- Отдельно можно заказать контейнер для простой, быстрой и безопасной стерилизации

Очистка и стерилизация
Необходимо снять накладку с лотка Washtray перед очисткой и установить на место перед стерилизацией.

Обратите внимание, что перед использованием необходимо ознакомиться с Инструкцией Dentsply Sirona Implants по стерилизации инструментов и уходу за ними.

Лоток Washtray Xive (с металлическим лотком и накладкой)

Уменьшенный масштаб



Контейнер для стерилизации лотка Washtray Xive (с 2 многоразовыми фильтрами для контейнера для стерилизации лотка Washtray)



Арт.	3226 7800	3226 7802

Накладка Washtray Xive

Уменьшенный масштаб



Многоразовый фильтр для контейнера для стерилизации лотка Washtray (2 шт.)



Арт.	3226 7801	3107 1003


Держатель для стержня стандарта ISO (5 шт.)

Держатель для вставки в трещотку (5 шт.)

Арт.	3107 1004	3107 1006

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Хирургические инструменты

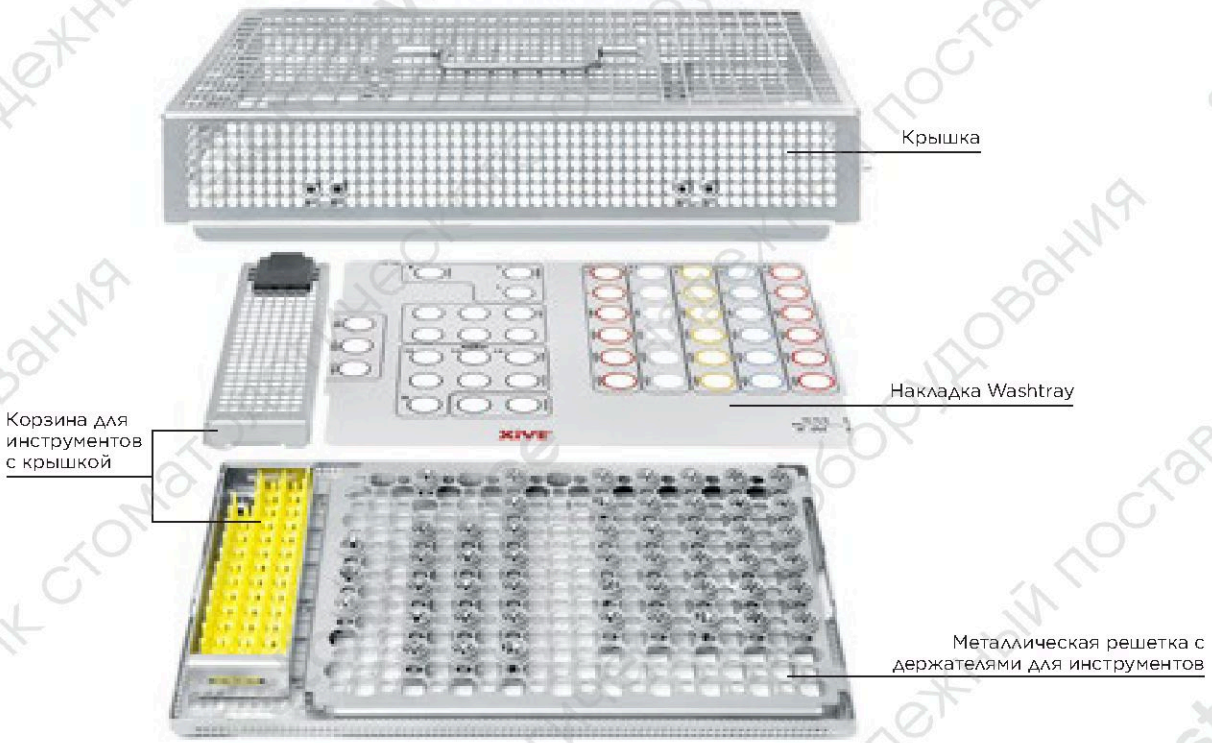


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Хирургический протокол Xive®

Адекватная подготовка костного ложа — это первый этап на пути достижения оптимальной стабильности имплантата. В системе Xive предусмотрена адаптация хирургического протокола к плотности кости.

Итоговая глубина погружения кортикального сверла и дополнительное использование метчика в кости класса D I позволяют управлять степенью конденсации кости и добиваться нужного торка при вкручивании имплантата.

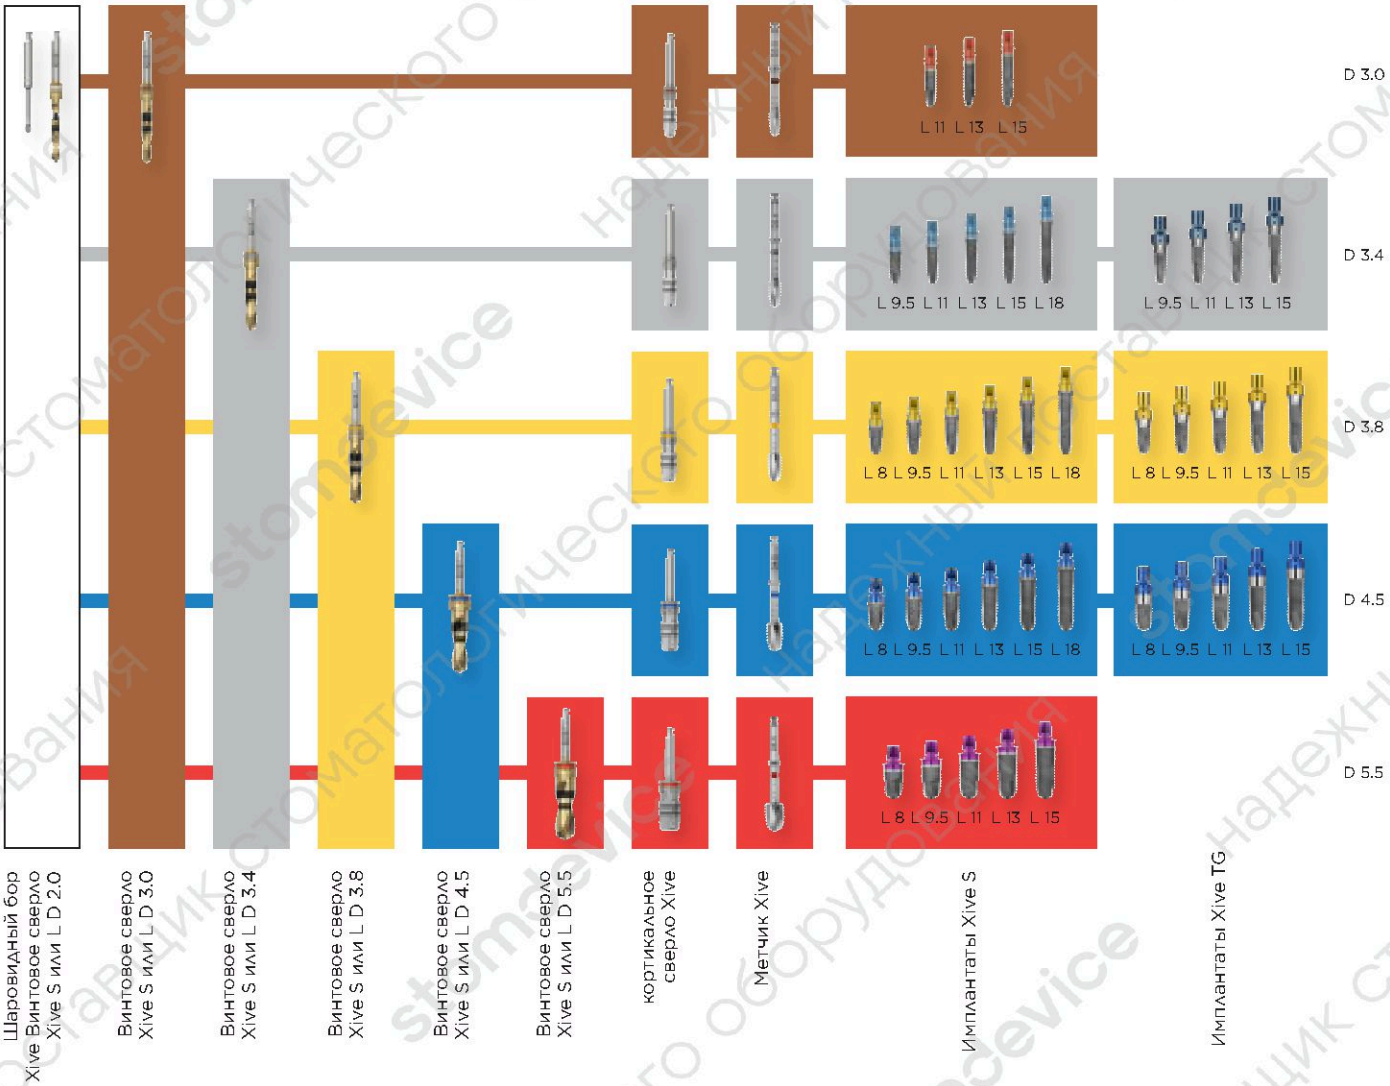


Пилотное сверление: винтовое сверло Xive D 2.0

Винтовые сверла и кортикальные сверла Xive используются на скорости не более 1500 об./мин. Убедитесь в адекватности внутреннего и внешнего водного охлаждения при сверлении. Оптимальный ток жидкости гарантируется при наличии разных источников внутреннего и внешнего охлаждения.

Маркировка кости: шаровидный бор Xive


Подготовка ложа: Винтовое сверло Xive
Пилотный канал расширяют последовательно, начиная с винтового сверла D 3.0 и заканчивая сверлом, диаметр которого соответствует диаметру имплантата

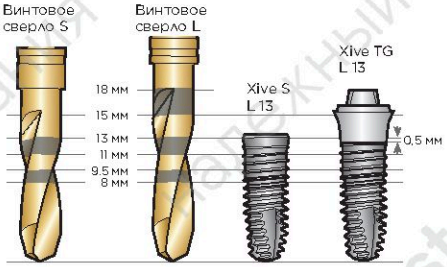


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Хирургические инструменты

1–2 | Расширение кортикальной части ложа для достижения оптимальной внутренней конденсации — кортикальное сверло Xive
Глубина погружения кортикального сверла варьирует от 2 до 6 мм в зависимости от плотности кости. Это позволяет добиваться оптимальной первичной стабильности имплантата в кости любой плотности.

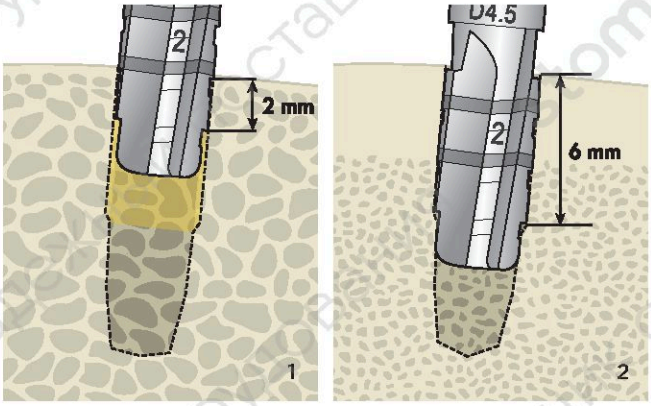

3–4 | При необходимости в канале нарезается резьба
В очень плотной кортикальной кости перед вкручиванием имплантата следует нарезать резьбу метчиком (15 об./мин) на глубину ок. 6 мм. Это снизит избыточный торк при вкручивании имплантата.

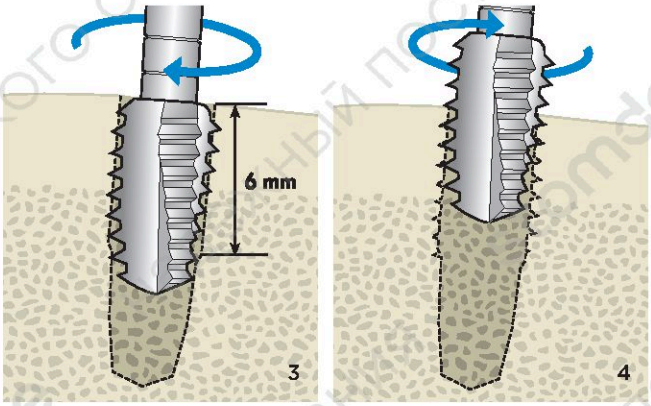

Дополнительные возможности: остеотом Xive
Очень мягкую кость можно уплотнить путем латеральной и апикальной конденсации остеотомами Xive.

При улучшении качества кости первичная стабильность имплантата увеличивается.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Одноразовые сверла Xive®

Одноразовые сверла Xive
- Винтовые сверла для подготовки ложа до указанного диаметра (на одного пациента)

Продолжение процедуры:

После расширения ложа до нужного диаметра необходимо дополнительно пройти ложе кортикальным сверлом Xive (стр. 76).

В очень плотной кости (D 1) необходимо дополнительно использовать метчик (стр. 76).

Инструменты для установки имплантатов и протезирования представлены на стр. 81–82.

Одноразовые сверла Xive — по отдельности (стерильные)

Масштаб 1:1



Ø Длина	D 2.0 L 8 – L 15	D 3.0 L 8 – L 15	D 3.4 L 8 – L 15
Арт.	26 – 1015	26 – 1025	26 – 1035

Масштаб 1:1



Ø Длина	D 3.8 L 8 – L 15	D 4.5 L 8 – L 15	D 5.5 L 8 – L 15
Арт.	26 – 1045	26 – 1055	26 – 1065

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Хирургические инструменты

Многоразовые сверла Xive®

Шаровидный бор Xive[6]
(стерильный)

Масштаб 1:1



Арт.	26 – 1710

Винтовое сверло Xive S[6] (короткое)
для имплантатов длиной 8–15 мм
(стерильное)

Масштаб 1:1



Ø Длина	D 2.0 L 8 – L 15	D 3.0 L 8 – L 15	D 3.4 L 8 – L 15	D 3.8 L 8 – L 15	D 4.5 L 8 – L 15	D 5.5 L 8 – L 15
Арт.	26 – 1715	26 – 1725	26 – 1735	26 – 1745	26 – 1755	26 – 1765

Винтовое сверло Xive L[6] (длинное)
для имплантатов длиной 8–18 мм
(стерильное)

Масштаб 1:1





Ø Длина	D 2.0 L 8 – L 18	D 3.0 L 8 – L 18	D 3.4 L 8 – L 18	D 3.8 L 8 – L 18	D 4.5 L 8 – L 18	D 5.5 L 8 – L 18
Арт.	26 – 1718	26 – 1728	26 – 1738	26 – 1748	26 – 1758	26 – 1768

Винтовые сверла Xive S и L

- Для расширения костного ложа до диаметра имплантата
- Без внутреннего охлаждения
- Индивидуализация длины сверла Xive за счет ограничителей погружения (стр. 77–78)

Винтовые сверла Xive S и L легко различимы благодаря цветным кольцам.

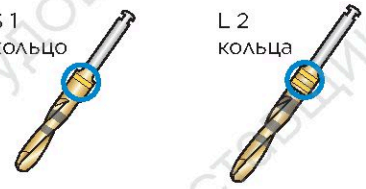

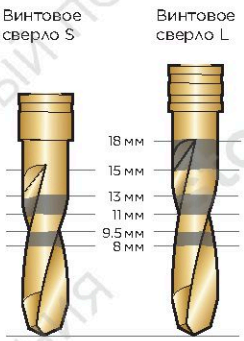

Примечание.
Режущие инструменты рассчитаны примерно на 10 циклов использования. Поврежденные и затупившиеся инструменты подлежат немедленной замене.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Многоразовые сверла Xive®

кортикальное сверло Xive
- Для расширения кортикальной части ложа на определенную глубину в соответствии с плотностью кости. Используется после прохождения ложа сверлом конечного диаметра
- Кортикальное сверло необходимо использовать всегда

Кортикальное сверло Xive[6]
(стерильное)

Масштаб 1:1



Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	26 – 1720	26 – 1730	26 – 1740	26 – 1750	26 – 1760

Метчик Xive
- Для создания резьбы в ложе (в плотной кортикальной кости D 1)

Метчик Xive[6]

Масштаб 1:1



Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	26 – 1122	26 – 1132	26 – 1142	26 – 1152	26 – 1162

Продолжение процедуры:
Инструменты для установки имплантатов и протезирования представлены на стр. 81–82.

Примечание.
Режущие инструменты рассчитаны примерно на 10 циклов использования. Поврежденные и затупившиеся инструменты подлежат немедленной замене.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ограничители глубины для винтовых сверл Xive®

НАБОРЫ

	Полный набор ограничителей Xive / S+L	**Стандартный набор ограничителей Xive / S**
	Все ограничители для универсальных винтовых сверл Xive длиной S (короткие) и L (длинные).	Все ограничители для универсальных винтовых сверл Xive длиной S (короткие).
Арт.	26 – 1200	26 – 1205

Ограничители погружения Xive


- Безопасное формирование ложа под имплантат — погружение многоразовых сверл Xive универсальной длины на строго определенную глубину (длину имплантата)

Ограничители глубины Xive S и L легко различимы благодаря цветным кольцам.

S 1 кольцо  L 2 кольца 

ИНСТРУМЕНТЫ

Для установки и снятия ограничителей Xive инструменты не требуются.



Ограничители глубины для винтовых сверл Xive®

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Ограничитель глубины Xive S[6]
(короткий)

Масштаб 1:1



Ø Длина	D 2.0 – D 3.0 L 8	D 2.0 – D 3.0 L 9.5	D 2.0 – D 3.0 L 11	D 2.0 – D 3.0 L 13	D 2.0 – D 3.0 L 15
Арт.	26 – 1210	26 – 1211	26 – 1212	26 – 1213	26 – 1215

Масштаб 1:1



Ø Длина	D 3.4 – D 3.8 L 8	D 3.4 – D 3.8 L 9.5	D 3.4 – D 3.8 L 11	D 3.4 – D 3.8 L 13	D 3.4 – D 3.8 L 15
Арт.	26 – 1230	26 – 1231	26 – 1232	26 – 1233	26 – 1235

Масштаб 1:1



Ø Длина	D 4.5 – D 5.5 L 8	D 4.5 – D 5.5 L 9.5	D 4.5 – D 5.5 L 11	D 4.5 – D 5.5 L 13	D 4.5 – D 5.5 L 15
Арт.	26 – 1250	26 – 1251	26 – 1252	26 – 1253	26 – 1255

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ограничители глубины для винтовых сверл Xive®

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

Для установки и снятия ограничителей Xive инструменты не требуются.

Ограничитель глубины Xive L[6] (длинный)



Масштаб 1:1

Ø Длина	D 2.0 – D 3.0 L 8	D 2.0 – D 3.0 L 9.5	D 2.0 – D 3.0 L 11	D 2.0 – D 3.0 L 13	D 2.0 – D 3.0 L 15	D 2.0 – D 3.0 L 18
Арт.	26 – 1310	26 – 1311	26 – 1312	26 – 1313	26 – 1315	26 – 1318



Масштаб 1:1

Ø Длина	D 3.4 – D 3.8 L 8	D 3.4 – D 3.8 L 9.5	D 3.4 – D 3.8 L 11	D 3.4 – D 3.8 L 13	D 3.4 – D 3.8 L 15	D 3.4 – D 3.8 L 18
Арт.	26 – 1330	26 – 1331	26 – 1332	26 – 1333	26 – 1335	26 – 1338



Масштаб 1:1

Ø Длина	D 4.5 – D 5.5 L 8	D 4.5 – D 5.5 L 9.5	D 4.5 – D 5.5 L 11	D 4.5 – D 5.5 L 13	D 4.5 – D 5.5 L 15	D 4.5 – D 5.5 L 18
Арт.	26 – 1350	26 – 1351	26 – 1352	26 – 1353	26 – 1355	26 – 1358

Лоток для ограничителей Xive (пустой)

Арт.	26 – 1390

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Остеотом Xive®

НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Остеотом Xive, прямой[25/6]



Уменьшенный масштаб


Ø	D 2.0	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	26 – 1610	26 – 1620	26 – 1630	26 – 1640	26 – 1650	26 – 1660

Остеотом Xive

- Латеральная и апикальная конденсация мягкой кости
- Улучшение качества кости для достижения оптимальной первичной стабильности имплантата
- Универсальная длина с метками глубины на рабочем конце

Остеотом Xive, угловой

- Для работы в условиях ограниченного доступа и в дистальных отделах челюсти

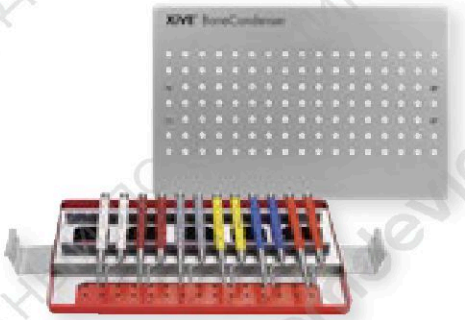

Остеотом Xive, угловой[25/6]



Уменьшенный масштаб

Ø	D 2.0	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	26 – 1615	26 – 1625	26 – 1635	26 – 1645	26 – 1655	26 – 1665

Набор прямых и угловых остеотомов Xive

Лоток со всеми прямыми и угловыми остеотомами Xive

Арт.	26 – 1600

Набор прямых остеотомов Xive

Лоток со всеми прямыми остеотомами Xive

Арт.	26 – 1603

Набор угловых остеотомов Xive

Лоток со всеми угловыми остеотомами Xive

Арт.	26 – 1606

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Другие инструменты для подготовки места имплантации

Прочтите инструкцию по применению!

Трепан Xive[6]



Масштаб 1:1

Ø Длина	D 3.0 L 8 – L 18	D 3.4 L 8 – L 18	D 3.8 L 8 – L 18	D 4.5 L 8 – L 18	D 5.5 L 8 – L 18
Арт.	26 – 1129	26 – 1139	26 – 1149	26 – 1159	26 – 1169

Удлинитель сверла Friadent
Удлинитель сверла обязательно использовать с длинной ирригационной трубкой.

Штифт для проверки параллельности Friadent[2]



Масштаб 1:1

D 2.0/D 3.0

Удлинитель сверла Friadent[6]



Арт.	45 – 5106	91 – 0003

Инструмент для очистки сверла Friadent[6]



Ирригационная трубка для углового наконечника Frios 20:1



Длинная ирригационная трубка Friadent[6] (для удлинителя)



Уменьшенный масштаб

Арт.	45 – 5280	90 – 5042	90 – 5043

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Хирургические инструменты

Инструменты для установки имплантатов

Имплантовод Xive S[6] (короткий)



Масштаб 1:1

	для имплантатов Xive S D 3.0	для имплантатов Xive S D 3.4 и TempBase	для имплантатов Xive S D 3.8 – D 5.5
Арт.	26 – 6030	26 – 6040	26 – 6050

Имплантовод Xive L[6] (длинный)



Масштаб 1:1

	для имплантатов Xive S D 3.0	для имплантатов Xive S D 3.4 и TempBase	для имплантатов Xive S D 3.8 – D 5.5
Арт.	26 – 6035	26 – 6045	26 – 6055

Имплантовод Xive TG[6]



Масштаб 1:1

Шестигранная отвертка Xive[6]



	для имплантатов Xive TG D 3.4 – D 4.5	0,9 мм/S (короткая)	0,9 мм/L (длинная)
Арт.	25 – 6010	26 – 6190	26 – 6195

Имплантоводы и шестигранные отвертки Xive

- Все инструменты можно использовать как с угловым наконечником, так и с трещоткой Xive

Для стандартной установки имплантатов Xive S через TempBase необходим только имплантовод Xive для имплантатов Xive S D 3.4 и TempBase, независимо от диаметра имплантата.

Имплантоводы других диаметров используются только при вкручивании имплантатов без TempBase.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Инструменты для установки имплантатов

Вставка для трещотки для инструментов Xive

- Для фиксации в трещотке инструментов с хвостовиком ISO. Эти инструменты могут использоваться как с угловым наконечником, так и с трещоткой.

Ключ-трещотка Xive[6]

Уменьшенный масштаб



Вставка для трещотки для инструментов Xive[6]



Арт.	45 – 6020	26 – 6120

Удлинитель Xive[6]

Уменьшенный масштаб



Ручной имплантовод Friadent длинный[6]



Арт.	26 – 6130	46 – 5880

Хирургический ключ-трещотка Xive с индикатором торка

- Повышенная безопасность при вкручивании имплантатов вручную
- Хорошо видимый индикатор торка
- Вращение по и против часовой стрелки

Хирургический ключ-трещотка Xive с индикатором торка[6]

Уменьшенный масштаб



Арт.	45 – 6010

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Хирургические инструменты

Инструменты для раскрытия имплантатов

Мукотом Friadent[6]

Масштаб 1:1



Ø	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Арт.	45 – 5665	45 – 5666	45 – 5660	45 – 5661	45 – 5662

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Инструменты для навигационной хирургии

СВЕРЛА

Мукотом Xive GS
- Для минимально инвазивного раскрытия имплантата

Примечание.
Инструменты с маркировкой GS используются только при навигационной хирургии.

Мукотом Xive GS[6]

Масштаб 1:1



Ø	D 3.0 GS	D 3.4 GS	D 3.8 GS	D 4.5 GS
Арт.	26 – 5201	26 – 5301	26 – 5401	26 – 5501

Начальное сверло Xive GS (для навигационной хирургии)
- Для удаления остатков мягких тканей после использования мукотома
- Для маркировки будущего положения имплантата (диаметр-специфичны)

Начальное сверло Xive[6] GS

Масштаб 1:1



Ø	D 3.0 GS	D 3.4 GS	D 3.8 GS	D 4.5 GS
Арт.	26 – 5202	26 – 5302	26 – 5402	26 – 5502

Винтовое сверло Xive GS
- Для поэтапного расширения ложа до диаметра имплантата (длина сверла соответствует длине имплантата)
- Система втулка-на сверле (сверло проходит сквозь направляющий шаблон через надетую на него втулку)

Винтовое сверло Xive[6] GS

Масштаб 1:1



Ø Длина	D 2.0 GS L 8	D 3.0 GS L 8	D 3.4 GS L 8	D 3.8 GS L 8	D 4.5 GS L 8
Арт.	26 – 5108	26 – 5208	26 – 5308	26 – 5408	26 – 5508

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Хирургические инструменты

Винтовое сверло Xive® GS



Масштаб 1:1

Ø Длина	D 2.0 GS L 9.5	D 3.0 GS L 9.5	D 3.4 GS L 9.5	D 3.8 GS L 9.5	D 4.5 GS L 9.5
Арт.	26 – 5195	26 – 5295	26 – 5395	26 – 5495	26 – 5595



Масштаб 1:1

Ø Длина	D 2.0 GS L 11	D 3.0 GS L 11	D 3.4 GS L 11	D 3.8 GS L 11	D 4.5 GS L 11
Арт.	26 – 5111	26 – 5211	26 – 5311	26 – 5411	26 – 5511



Масштаб 1:1

Ø Длина	D 2.0 GS L 13	D 3.0 GS L 13	D 3.4 GS L 13	D 3.8 GS L 13	D 4.5 GS L 13
Арт.	26 – 5113	26 – 5213	26 – 5313	26 – 5413	26 – 5513

Примечание.
Режущие инструменты рассчитаны примерно на 20 циклов использования. Поврежденные и затупившиеся инструменты подлежат немедленной замене.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Инструменты для навигационной хирургии

СВЕРЛА

Винтовое сверло Xive[6] GS



Ø Длина	D 2.0 GS L 15	D 3.0 GS L 15	D 3.4 GS L 15	D 3.8 GS L 15	D 4.5 GS L 15
Арт.	26 – 5115	26 – 5215	26 – 5315	26 – 5415	26 – 5515

Кортикальное сверло Xive GS

- Для расширения кортикальной части ложа на определенную глубину в соответствии с плотностью кости. Используется после прохождения ложа сверлом конечного диаметра
- Кортикальное сверло необходимо использовать всегда

Кортикальное сверло Xive GS[6]



Ø	D 3.0 GS	D 3.4 GS	D 3.8 GS	D 4.5 GS
Арт.	26 – 5020	26 – 5030	26 – 5040	26 – 5050

Метчик Xive GS

- Для создания резьбы в ложе (в плотной кортикальной кости D 1)

Метчик Xive[6] GS



Ø	D 3.0 GS	D 3.4 GS	D 3.8 GS	D 4.5 GS
Арт.	26 – 5022	26 – 5032	26 – 5042	26 – 5052

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Инструменты для навигационной хирургии

ВТУЛКИ XiVE®

Набор узких втулок Xive для винтовых сверл[6] GS




Масштаб 1:1				
Ø	D 2.0 – D 3.8			
Арт.	26 – 5605			

Узкая втулка Xive для винтовых сверл[6] GS



Масштаб 1:1				
Ø	D 2.0	D 3.0	D 3.4	D 3.8
Арт.	26 – 5105	26 – 5205	26 – 5305	26 – 5405

Набор широких втулок Xive для винтовых сверл[6] GS

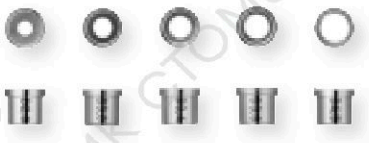

Масштаб 1:1				
Ø	D 2.0 – D 4.5			
Арт.	26 – 5603			

Широкая втулка Xive для винтовых сверл[6] GS



Масштаб 1:1					
Ø	D 2.0	D 3.0	D 3.4	D 3.8	D 4.5
Арт.	26 – 5103	26 – 5203	26 – 5303	26 – 5403	26 – 5503

Втулки для винтовых сверл

- Для направления сверла при прохождении через хирургический шаблон (система втулка-на-сверле)

ИНСТРУМЕНТЫ

Для установки втулки Xive на сверло или имплантовод специальных инструментов не требуется.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Инструменты для навигационной хирургии
ИМПЛАНТОВОДЫ

Имплантовод Xive GS
- Выпускаются двух длин (короткие и длинные) и двух диаметров (узкие и широкие); предназначены для вкручивания имплантатов Xive S D 3.0 – D 4.5 с TempBase
- Втулки можно заказать отдельно как запасные части

Другие инструменты для установки имплантатов Xive и для протезирования представлены на стр. 85–86

Имплантовод Xive® GS
для TempBase

Масштаб 1:1



	короткий, узкий	короткий, широкий	длинный, узкий	длинный, широкий
Арт.	26 – 5700	26 – 5701	26 – 5702	26 – 5703

Широкая втулка Xive для имплантовода® GS

Узкая втулка Xive для имплантовода® GS

Масштаб 1:1



Арт.	26 – 5704	26 – 5705

Инструменты для навигационной хирургии
СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ АБАТМЕНТЫ

Стабилизирующий абатмент Xive GS для TempBase
- Предотвращает боковое смещение и изгиб хирургического шаблона при формировании ложа под несколько имплантатов.

Стабилизирующий абатмент Xive® GS
для TempBase

Масштаб 1:1



	узкий	широкий
Арт.	26 – 5850	26 – 5852

Позиционер Xive GS
- По 3 позиционера GS в упаковке. Компоненты легко различимы благодаря цветовой маркировке, соответствующей диаметру имплантатов или аналогов имплантатов.
- Для установки в узкие (ND) втулки шаблонов — серебристые
- Для установки в широкие (WD) втулки шаблонов — синие

Позиционер Xive GS

Масштаб 1:1



Ø	узкий для аналога имплантата D 3.0	узкий для аналога имплантата D 3.4	узкий для аналога имплантата D 3.8	широкий для аналога имплантата D 4.5
Арт.	26 – 5821	26 – 5831	26 – 5841	26 – 5851

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Физиодиспенсер

Физиодиспенсер Frios S/i
Комплектация: физиодиспенсер Frios S/i с хирургическим мотором (длина кабеля 1,8 м), подставка для мотора, штанга, ножная педаль вкл./выкл., кабель питания, блокиратор для мотора, набор фиксаторов трубок (5 шт.), шланг системы охлаждения



Уменьшенный масштаб

	220–240 В перем. тока	100–130 В перем. тока
Арт.	90 – 6600	90 – 6605

Физиодиспенсер Frios S/i
- Простое управление, разработанное специально для имплантологических операций
- Мощный тихий хирургический мотор
- Понятная, логичная последовательность программ; имеется функция нарезания резьбы

Угловой наконечник Frios



Уменьшенный масштаб

	WS-75 20:1 разборный	WI-75 20:1	WI-75 LED G
Арт.	90 – 6720	90 – 6710	90 – 6810

Наконечник Frios



Уменьшенный масштаб

	прямой 1:1	угловой 1:1	прямой SI-11 LED G
Арт.	90 – 5030	90 – 5050	90 – 6850

Угловые наконечники Frios
- Запатентованная система шестигранного зажима для большей безопасности при работе и для снижения износа инструментов
- Имеется разборная версия с поворачиваемой на 90° головкой для работы в труднодоступных участках; возможность идеальной очистки наконечника
- Имеется версия со светодиодной подсветкой — нейтральный белый свет более высокой интенсивности и с большим охватом рабочего поля (по сравнению с обычными галогеновыми лампами)

Примечание для пользователей физиодиспенсера Frios S
При использовании данных угловых наконечников с физиодиспенсером Frios S возможны проблемы с совместимостью.
Перед заказом или первым использованием посоветуйтесь со своим дистрибьютором.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Физиодиспенсер
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Информацию о доступности указанных далее запасных частей и принадлежностей для физиодиспенсеров Frios S/i, Frios S и Frios E можно получить у дистрибутора компании Dentsply Sirona Implants.

Хирургический мотор физиодиспенсера Frios S/i (длина кабеля 1,8 м)

	Подходит для физиодиспенсера Frios S/i
Арт.	90 – 6620

Ножная педаль Frios S/i

	Подходит для физиодиспенсера Frios S/i
Арт.	90 – 6630

Внутренняя ирригационная трубка для углового наконечника Frios 20:1

	Подходит для физиодиспенсеров Frios S/i и Frios S
Арт.	90 – 5042

Длинная внутренняя ирригационная трубка (для удлинителя)

	Подходит для физиодиспенсеров Frios S/i и Frios S
Арт.	90 – 5043

Стерильная защитная пленка для физиодиспенсеров Frios S, Frios E для хирургического мотора (10 шт.)

	Подходит для всех физиодиспенсеров Frios
Арт.	90 – 6442

Набор фиксаторов трубок для физиодиспенсера Frios S (5 шт.)

	Подходит для всех физиодиспенсеров Frios
Арт.	90 – 6443

Хирургический мотор физиодиспенсера Frios S (длина кабеля 1,8 м)

	Подходит для физиодиспенсера Frios S
Арт.	90 – 6410

Ножная педаль физиодиспенсера Frios S ВКЛ./ВЫКЛ.

	Подходит для физиодиспенсера Frios S
Арт.	90 – 6420

ШЛАНГИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S/i (кабель мотора 2,2 м, 5 шт.)

Шланг системы охлаждения для Frios ISU, универсальный (5 шт.), также подходит для ASU

Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S (кабель мотора 1,8 м, 5 шт.)



Уменьшенный масштаб

Арт.	90 – 6446	90 – 5005	90 – 6440

Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S (кабель мотора 3,5 м, 3 шт.)

Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios E (кабель мотора 1,8 м, 5 шт.) с винтовым соединением люэровского типа для трехходового крана



Уменьшенный масштаб

Арт.	90 – 6441	90 – 6542

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ортопедические инструменты

Ортопедические наборы

Малый ортопедический набор Friadent



Уменьшенный масштаб

Лоток под базовый ортопедический набор Xive



Малый ортопедический набор Friadent
Включает все инструменты для фиксации реставраций на имплантатах (без МР).

Базовый ортопедический набор Xive
Включает лоток со всеми инструментами для снятия слепков и для протезирования. Инструменты поставляются в лотке под базовый ортопедический набор Xive.

Арт.	46 – 7000	26 – 8020

Малый ортопедический набор Friadent (пустой)

Лоток под базовый ортопедический набор Friadent (пустой)

Арт.	46 – 7001	26 – 8025

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Комплектация набора:	Малый ортопедический набор	Базовый ортопедический набор
Ключ-трещотка	■	■
Машинная шестигранная отвертка 0,9 мм (короткая)		■
Машинная шестигранная отвертка 0,9 мм (длинная)		■
Машинная шестигранная отвертка 1,22 мм (короткая)		■
Машинная шестигранная отвертка 1,22 мм (длинная)		■
Ручка для машинной отвертки		■
Ручная шестигранная отвертка 0,9 мм (короткая)	■	■
Ручная шестигранная отвертка 0,9 мм (длинная)		■
Ручная шестигранная отвертка 1,22 мм (короткая)	■	■
Ручная шестигранная отвертка 1,22 мм (длинная)		■
Инструмент для установки для платформ шаровидного и MP абатментов		■
Машинная отвертка для винта MP		■
Насадка для ключа-трещотки для винта MP		■
Примерочный абатмент прямой D 3.0 / A 0		■
Примерочный абатмент прямой D 3.4 / A 0		■
Примерочный абатмент прямой D 3.8 / A 0		■
Примерочный абатмент прямой D 4.5 / A 0		■
Примерочный абатмент прямой D 5.5 / A 0		■
Примерочный абатмент угловой D 3.0 / A 15		■
Примерочный абатмент угловой D 3.4 / A 15		■
Примерочный абатмент угловой D 3.8 / A 15		■

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Отдельные инструменты

Ключ-трещотка Friadent[6] без вставок



Уменьшенный масштаб

Арт.	45 – 5709

Ручные шестигранные отвертки Friadent[6] с ограничителем торка



Масштаб 1:1

	Ширина 0,9 мм 14 Нсм / короткая	Ширина 0,9 мм 14 Нсм / длинная	Ширина 1,22 мм 24 Нсм / короткая	Ширина 1,22 мм 24 Нсм / длинная
Арт.	45 – 5732	45 – 5733	45 – 5734	45 – 5736

Ручные шлицевые отвертки Friadent[6] с ограничителем торка



Масштаб 1:1

	Ширина шлица 2,0 мм 14 Нсм / короткая	Ширина шлица 2,0 мм 14 Нсм / длинная
Арт.	45 – 5714	45 – 5722

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Отдельные инструменты

Машинная шестигранная отвертка Friadent[6]



Масштаб 1:1

	Ширина 0,9 мм короткая	Ширина 0,9 мм длинный	Ширина 1,22 мм короткая	Ширина 1,22 мм длинный
Арт.	46 – 5710	46 – 5720	46 – 5711	46 – 5721

Машинная шлицевая отвертка Friadent[6]



Масштаб 1:1

	Ширина шлица 2,0 мм короткая	Ширина шлица 2,0 мм длинный
Арт.	46 – 5712	46 – 5722

Эта ручка подходит ко всем машинным отверткам.

В труднодоступных участках рекомендуется использовать шестигранную отвертку Friadent 0,9 мм без ограничителя торка.

Ручка Friadent для машинной шестигранной отвертки[6]



Уменьшенный масштаб

Арт.	46 – 5750

Шестигранная отвертка Friadent[6] без ограничителя торка



Ширина 0,9 мм

Арт.	45 – 5650

Монтажное устройство Friadent для шестигранной отвертки



Уменьшенный масштаб

Арт.	45 – 5618

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ортопедические инструменты

Алмазная фреза Friadent CeraBase

Уменьшенный масштаб





	Средняя зернистость	Мелкая зернистость
Арт.	45 – 5753	45 – 5755

Инструмент для установки Friadent² для трансфера

Уменьшенный масштаб



Арт.	45 – 5605

Инструмент для установки Friadent² для платформ шаровидного абатмента и абатмента MP



Арт.	45 – 5617

Насадка для ключа-трещотки Friadent⁶ для винта MP с ограничителем торка

Масштаб 1:1



Арт.	46 – 5610

Машинная отвертка Friadent⁶ для винта MP (для углового наконечника)



Арт.	46 – 5615

Активатор Friadent⁶ для шаровидного абатмента

Уменьшенный масштаб



Арт.	45 – 5621

Деактиватор Friadent⁶ для шаровидного абатмента



Арт.	45 – 5622

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Отдельные инструменты

3-компонентная отвертка Locator[49]
со втулкой держателя абатмента Locator

Уменьшенный масштаб



Арт.	45 – 3340

Вставка Friadent Locator для ортопедического ключа-трещотки[6]

Уменьшенный масштаб



Арт.	45 – 3344

Угломер Locator[51]



Арт.	45 – 3345

Активатор балочной клипсы Friadent[6]



Арт.	45 – 5623

Шабер Friadent[6/10] **для горизонтального винта**

Уменьшенный масштаб



Ø

Арт.	45 – 5702

Шабер Friadent[6/10] **для абатментов супраструктур на винтовой фиксации**



D 3.4 – D 4.5

Арт.	45 – 5705



D 5.5

Арт.	45 – 5707

Шабер Friadent[6/10] **для винтов супраструктур на винтовой фиксации**



Арт.	45 – 5700

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Дополнительные материалы

Демонстрационные модели

Акриловая модель в/ч Friadent без протеза (Ankylos, Xive, Frialit)

Уменьшенный масштаб



Арт.	45 – 9981

Акриловая модель в/ч Friadent с протезом (Ankylos, Xive, Frialit)



Арт.	45 – 9982

Акриловая модель н/ч Xive без протеза (балочная конструкция)

Уменьшенный масштаб



Арт.	45 – 9985

Акриловая модель н/ч Xive с протезом (балочная конструкция)



Арт.	45 – 9986

Демонстрационный набор Xive 5:1




Уменьшенный масштаб

Арт.	26 – 9110

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Брошюры для пациентов

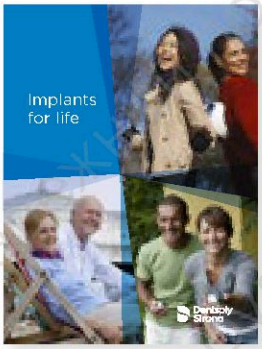Брошюра для пациентов Dentsply Sirona Implants	Паспорт на имплантаты Dentsply Sirona Implants
	
Арт. 32670674 – USX	Арт. 32670687 – USX

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Материалы

Металлы

Тип	Индекс	Состав
Титан	1	титан 1 класса
Титан	2	титан 2 класса
Титан	3	титан 4 класса
Титан	4	титановый сплав Ti6Al4V 5 класса
Алюминий	5	$AlMg_3$
Нержавеющая сталь	6	Хирургическая сталь
Нержавеющая сталь	49	316L SS SS/303 SE
Нержавеющая сталь	51	316L SS
Латунь	7	CuZn
Приливаемый сплав*	8	Au: 60 %, Pt: 19 %, Pd: 20 %, Ir: 1%
Золотой сплав**	9	Au:68,6 %, Pt:2,4 %, Pd:4 %, Ag:11,8 %, Cu:10,6 %, Ir:0,1 %, Zn:2,5 %
Твердый сплав	10	K 40
Полиэтилен/алюминий	42	LDPE/6061 T6 Al
Полиамид/полиэтилен/нерж. сталь/пластмасса	43	Нейлон/LDPE/Ti6Al4V/силиконовый каучук
Полиамид/полиэтилен/нерж. сталь/пластмасса	44	Нейлон/LDPE/303 SE SS/силиконовый каучук
Алюминий	45	Алюминий 6061 T6

* TEC 11,9 × 10^{-6} K^{-1}, предварительный нагрев < 850 °C, температура литья < 1450 °C; ** интервал плавления 880–940 °C

Пластмассы

Тип	Индекс	Состав
Полиоксиметилен	20	
Полиметилметакрилат (PMMA)	21	
Полистирол	22	
Политетрафторэтилен	23	
Полиэфирэфиркетон	24	
Полиэфиримид	25	
Силикон	26	
Силикон	47	Силиконовый каучук
Поликарбонат	27	
Полипропилен	28	
Полиамид	41	Нейлон Zytel 101L
Полиэтилен/алюминий	42	LDPE/6061 T6 Al
Полиамид/полиэтилен/нерж. сталь/пластмасса	43	Нейлон/LDPE/Ti6Al4V/силиконовый каучук
Полиамид/полиэтилен/нерж. сталь/пластмасса	44	Нейлон/LDPE/303 SE SS/силиконовый каучук
Полиэтилен	46	LDPE
Полиоксиметилен	48	MS-002, DELRIN, 1/4"
Полисульфон	50	MS-013-1 POLYSULFONE (3/8")

Керамика

Тип	Индекс	Состав
Оксид алюминия	30	Al_2O_3
Гидроксиапатит	31	$Ca_5(PO_4)_3OH$
Диоксид циркония	32	ZrO_2

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Индекс

Арт.	Название	Стр.
25 – 1400	Винт-заглушка Xive TG	20
25 – 1600	Трансфер для закр. ложки Xive TG D 3.4 – D 4.5	60
25 – 1605	Трансфер для закр. ложки (короткий) Xive TG D 3.4 – D 4.5	60
25 – 1701	Длинный винт для откр. ложки Xive TG D 3.4 – D 4.5	60
25 – 1805	Трансфер для откр. ложки с длинным винтом Xive TG D 3.4 – D 4.5	60
25 – 2431	Имплантат Xive TG plus D 3.4 / L 9.5	20
25 – 2432	Имплантат Xive TG plus D 3.4 / L 11	20
25 – 2433	Имплантат Xive TG plus D 3.4 / L 13	20
25 – 2435	Имплантат Xive TG plus D 3.4 / L 15	20
25 – 2440	Имплантат Xive TG plus D 3.8 / L 8	20
25 – 2441	Имплантат Xive TG plus D 3.8 / L 9.5	20
25 – 2442	Имплантат Xive TG plus D 3.8 / L 11	20
25 – 2443	Имплантат Xive TG plus D 3.8 / L 13	20
25 – 2445	Имплантат Xive TG plus D 3.8 / L 15	20
25 – 2450	Имплантат Xive TG plus D 4.5 / L 8	20
25 – 2451	Имплантат Xive TG plus D 4.5 / L 9.5	20
25 – 2452	Имплантат Xive TG plus D 4.5 / L 11	20
25 – 2453	Имплантат Xive TG plus D 4.5 / L 13	20
25 – 2455	Имплантат Xive TG plus D 4.5 / L 15	20
25 – 4010	Аналог имплантата Xive TG для пайки D 3.4 – D 4.5	60
25 – 4105	Лаб. набор с аналогом Xive TG для пайки для моста D 3.4 – D 4.5	60
25 – 4106	Лаб. набор с аналогом Xive TG для пайки для балки D 3.4 – D 4.5	60
25 – 4200	Винт для колпачка Xive TG	62
25 – 4240	Золотой колпачок для балки Xive TG D 3.4 – D 4.5	62
25 – 4241	Титановый колпачок для балки Xive TG D 3.4 – D 4.5	62
25 – 4242	Отливаемый колпачок для балки Xive TG D 3.4 – D 4.5	62
25 – 4245	Отливаемая втулка Xive TG D 3.4 – D 4.5	61
25 – 4246	Приливаемая втулка Xive TG D 3.4 – D 4.5	61
25 – 4300	Винт абатмента Xive TG D 3.4 – D 4.5	61
25 – 4401	Шаровидный абатмент Xive TG D 3.4 – D 4.5	63
25 – 4406	Патрица шаровидного абатмента Xive TG	63
25 – 4411	Матрица шаровидного абатмента Xive TG	63
25 – 4500	Абатмент Xive TG прямой / A 0 D 3.4 – D 4.5	61
25 – 4510	Абатмент Xive TG угловой / A 15 D 3.4 – D 4.5	61
25 – 4520	Абатмент AuroBase Xive TG D 3.4 – D 4.5	61
25 – 5206	Рентгенологический шаблон Xive TG (трансгингивальный)	65
25 – 6010	Имплантовод Xive TG D 3.4 – D 4.5	81
26 – 1015	Одноразовое сверло Xive D 2.0 / L 8 – L 15	74
26 – 1025	Одноразовое сверло Xive D 3.0 / L 8 – L 15	74
26 – 1035	Одноразовое сверло Xive D 3.4 / L 8 – L 15	74
26 – 1045	Одноразовое сверло Xive D 3.8 / L 8 – L 15	74
26 – 1055	Одноразовое сверло Xive D 4.5 / L 8 – L 15	74
26 – 1065	Одноразовое сверло Xive D 5.5 / L 8 – L 15	74
26 – 1122	Метчик Xive D 3.0	76
26 – 1129	Трепан Xive D 3.0 / L 8 – L 18	80
26 – 1132	Метчик Xive D 3.4	76
26 – 1139	Трепан Xive D 3.4 / L 8 – L 18	80
26 – 1142	Метчик Xive D 3.8	76
26 – 1149	Трепан Xive D 3.8 / L 8 – L 18	80
26 – 1152	Метчик Xive D 4.5	76
26 – 1159	Трепан Xive D 4.5 / L 8 – L 18	80
26 – 1162	Метчик Xive D 5.5	76
26 – 1169	Трепан Xive D 5.5 / L 8 – L 18	80
26 – 1200	Полный набор ограничителей Xive / S+L	77
26 – 1205	Стандартный набор ограничителей Xive / S	77
26 – 1210	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 2.0 – D 3.0 / L 8	77
26 – 1211	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 2.0 – D 3.0 / L 9.5	77
26 – 1212	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 2.0 – D 3.0 / L 11	77
26 – 1213	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 2.0 – D 3.0 / L 13	77
26 – 1215	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 2.0 – D 3.0 / L 15	77
26 – 1230	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 3.4 – D 3.8 / L 8	77
26 – 1231	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 3.4 – D 3.8 / L 9.5	77
26 – 1232	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 3.4 – D 3.8 / L 11	77
26 – 1233	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 3.4 – D 3.8 / L 13	77
26 – 1235	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 3.4 – D 3.8 / L 15	77
26 – 1250	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 4.5 – D 5.5 / L 8	77
26 – 1251	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 4.5 – D 5.5 / L 9.5	77
26 – 1252	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 4.5 – D 5.5 / L 11	77
26 – 1253	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 4.5 – D 5.5 / L 13	77

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
26 – 1255	Ограничитель глубины Xive S (короткий) D 4.5 – D 5.5 / L 15	77
26 – 1310	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 – D 3.0 / L 8	78
26 – 1311	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 – D 3.0 / L 9.5	78
26 – 1312	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 – D 3.0 / L 11	78
26 – 1313	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 – D 3.0 / L 13	78
26 – 1315	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 – D 3.0 / L 15	78
26 – 1318	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 2.0 – D 3.0 / L 18	78
26 – 1330	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 – D 3.8 / L 8	78
26 – 1331	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 – D 3.8 / L 9.5	78
26 – 1332	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 – D 3.8 / L 11	78
26 – 1333	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 – D 3.8 / L 13	78
26 – 1335	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 – D 3.8 / L 15	78
26 – 1338	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 3.4 – D 3.8 / L 18	78
26 – 1350	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 – D 5.5 / L 8	78
26 – 1351	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 – D 5.5 / L 9.5	78
26 – 1352	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 – D 5.5 / L 11	78
26 – 1353	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 – D 5.5 / L 13	78
26 – 1355	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 – D 5.5 / L 15	78
26 – 1358	Ограничитель глубины Xive L (длинный) D 4.5 – D 5.5 / L 18	78
26 – 1390	Лоток для ограничителей Xive (пустой)	78
26 – 1510	Глубиномер Xive D 2.0	65
26 – 1520	Примерочный имплантат Xive D 3.0	65
26 – 1530	Примерочный имплантат Xive D 3.4	65
26 – 1540	Примерочный имплантат Xive D 3.8	65
26 – 1550	Примерочный имплантат Xive D 4.5	65
26 – 1560	Примерочный имплантат Xive D 5.5	65
26 – 1600	Набор прямых и угловых остеотомов Xive	79
26 – 1603	Набор прямых остеотомов Xive	79
26 – 1606	Набор угловых остеотомов Xive	79
26 – 1610	Остеотом Xive прямой D 2.0	79
26 – 1615	Остеотом Xive угловой D 2.0	79

Арт.	Название	Стр.
26 – 1620	Остеотом Xive прямой D 3.0	79
26 – 1625	Остеотом Xive угловой D 3.0	79
26 – 1630	Остеотом Xive прямой D 3.4	79
26 – 1635	Остеотом Xive угловой D 3.4	79
26 – 1640	Остеотом Xive прямой D 3.8	79
26 – 1645	Остеотом Xive угловой D 3.8	79
26 – 1650	Остеотом Xive прямой D 4.5	79
26 – 1655	Остеотом Xive угловой D 4.5	79
26 – 1660	Остеотом Xive прямой D 5.5	79
26 – 1665	Остеотом Xive угловой D 5.5	79
26 – 1710	шаровидный бор Xive	75
26 – 1715	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 2.0 / L 8 – 15	75
26 – 1718	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 2.0 / L 8 – 18	75
26 – 1720	Кортикальное сверло Xive D 3.0	76
26 – 1725	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 3.0 / L 8 – 15	75
26 – 1728	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 3.0 / L 8 – 18	75
26 – 1730	Кортикальное сверло Xive D 3.4	76
26 – 1735	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 3.4 / L 8 – 15	75
26 – 1738	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 3.4 / L 8 – 18	75
26 – 1740	Кортикальное сверло Xive D 3.8	76
26 – 1745	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 3.8 / L 8 – 15	75
26 – 1748	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 3.8 / L 8 – 18	75
26 – 1750	Кортикальное сверло Xive D 4.5	76
26 – 1755	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 4.5 / L 8 – 15	75
26 – 1758	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 4.5 / L 8 – 18	75
26 – 1760	Кортикальное сверло Xive D 5.5	76
26 – 1765	Винтовое сверло Xive S (короткое) D 5.5 / L 8 – 15	75
26 – 1768	Винтовое сверло Xive L (длинное) D 5.5 / L 8 – 18	75
26 – 2422	Имплантат Xive S plus D 3.0 / L 11	19
26 – 2423	Имплантат Xive S plus D 3.0 / L 13	19
26 – 2425	Имплантат Xive S plus D 3.0 / L 15	19
26 – 2431	Имплантат Xive S plus D 3.4 / L 9.5	19
26 – 2432	Имплантат Xive S plus D 3.4 / L 11	19
26 – 2433	Имплантат Xive S plus D 3.4 / L 13	19
26 – 2435	Имплантат Xive S plus D 3.4 / L 15	19

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Арт.	Название	Стр.
26 – 2438	Имплантат Xive S plus D 3.4 / L 18	19
26 – 2440	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 8	19
26 – 2441	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 9.5	19
26 – 2442	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 11	19
26 – 2443	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 13	19
26 – 2445	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 15	19
26 – 2448	Имплантат Xive S plus D 3.8 / L 18	19
26 – 2450	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 8	19
26 – 2451	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 9.5	19
26 – 2452	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 11	19
26 – 2453	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 13	19
26 – 2455	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 15	19
26 – 2458	Имплантат Xive S plus D 4.5 / L 18	19
26 – 2460	Имплантат Xive S plus D 5.5 / L 8	19
26 – 2461	Имплантат Xive S plus D 5.5 / L 9.5	19
26 – 2462	Имплантат Xive S plus D 5.5 / L 11	19
26 – 2463	Имплантат Xive S plus D 5.5 / L 13	19
26 – 2465	Имплантат Xive S plus D 5.5 / L 15	19
26 – 3301	Абатмент Xive Locator D 3.4 / GH 1	54
26 – 3302	Абатмент Xive Locator D 3.4 / GH 2	54
26 – 3303	Абатмент Xive Locator D 3.4 / GH 3	54
26 – 3304	Абатмент Xive Locator D 3.4 / GH 4	54
26 – 3305	Абатмент Xive Locator D 3.4 / GH 5	54
26 – 3311	Абатмент Xive Locator D 3.8 / GH 1	54
26 – 3312	Абатмент Xive Locator D 3.8 / GH 2	54
26 – 3313	Абатмент Xive Locator D 3.8 / GH 3	54
26 – 3314	Абатмент Xive Locator D 3.8 / GH 4	54
26 – 3315	Абатмент Xive Locator D 3.8 / GH 5	54
26 – 3321	Абатмент Xive Locator D 4.5 / GH 1	54
26 – 3322	Абатмент Xive Locator D 4.5 / GH 2	54
26 – 3323	Абатмент Xive Locator D 4.5 / GH 3	54
26 – 3324	Абатмент Xive Locator D 4.5 / GH 4	54
26 – 3325	Абатмент Xive Locator D 4.5 / GH 5	54
26 – 3331	Абатмент Xive Locator D 5.5 / GH 1.3	54
26 – 3332	Абатмент Xive Locator D 5.5 / GH 2	54
26 – 3333	Абатмент Xive Locator D 5.5 / GH 3	54
26 – 3334	Абатмент Xive Locator D 5.5 / GH 4	54
26 – 3335	Абатмент Xive Locator D 5.5 / GH 5	54
26 – 5000	Хирургический набор Xive GS (навигационная хирургия)	66
26 – 5010	Лоток под хирургический набор Xive GS (пустой)	67
26 – 5020	Кортикальное сверло Xive GS D 3.0	86

Арт.	Название	Стр.
26 – 5022	Метчик Xive GS D 3.0	86
26 – 5030	Кортикальное сверло Xive GS D 3.4	86
26 – 5032	Метчик Xive GS D 3.4	86
26 – 5040	Кортикальное сверло Xive GS D 3.8	86
26 – 5042	Метчик Xive GS D 3.8	86
26 – 5050	Кортикальное сверло Xive GS D 4.5	86
26 – 5052	Метчик Xive GS D 4.5	86
26 – 5103	Широкая втулка для винтового сверла Xive GS D 2.0	87
26 – 5105	Узкая втулка для винтового сверла Xive GS D 2.0	87
26 – 5108	Винтовое сверло Xive GS D 2.0 / L 8	84
26 – 5111	Винтовое сверло Xive GS D 2.0 / L 11	85
26 – 5113	Винтовое сверло Xive GS D 2.0 / L 13	85
26 – 5115	Винтовое сверло Xive GS D 2.0 / L 15	86
26 – 5195	Винтовое сверло Xive GS D 2.0 / L 9.5	85
26 – 5201	Мукотом Xive GS D 3.0	84
26 – 5202	Начальное сверло Xive GS D 3.0	84
26 – 5203	Широкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.0	87
26 – 5205	Узкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.0	87
26 – 5208	Винтовое сверло Xive GS D 3.0 / L 8	84
26 – 5211	Винтовое сверло Xive GS D 3.0 / L 11	85
26 – 5213	Винтовое сверло Xive GS D 3.0 / L 13	85
26 – 5215	Винтовое сверло Xive GS D 3.0 / L 15	86
26 – 5295	Винтовое сверло Xive GS D 3.0 / L 9.5	85
26 – 5301	Мукотом Xive GS D 3.4	84
26 – 5302	Начальное сверло Xive GS D 3.4	84
26 – 5303	Широкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.4	87
26 – 5305	Узкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.4	87
26 – 5308	Винтовое сверло Xive GS D 3.4 / L 8	84
26 – 5311	Винтовое сверло Xive GS D 3.4 / L 11	85
26 – 5313	Винтовое сверло Xive GS D 3.4 / L 13	85
26 – 5315	Винтовое сверло Xive GS D 3.4 / L 15	86
26 – 5395	Винтовое сверло Xive GS D 3.4 / L 9.5	85
26 – 5401	Мукотом Xive GS D 3.8	84
26 – 5402	Начальное сверло Xive GS D 3.8	84
26 – 5403	Широкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.8	87
26 – 5405	Узкая втулка для винтового сверла Xive GS D 3.8	87
26 – 5408	Винтовое сверло Xive GS D 3.8 / L 8	84
26 – 5411	Винтовое сверло Xive GS D 3.8 / L 11	85

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
26 – 5413	Винтовое сверло Xive GS D 3.8 / L 13	85
26 – 5415	Винтовое сверло Xive GS D 3.8 / L 15	86
26 – 5495	Винтовое сверло Xive GS D 3.8 / L 9.5	85
26 – 5501	Мукотом Xive GS D 4.5	84
26 – 5502	Начальное сверло Xive GS D 4.5	84
26 – 5503	Широкая втулка для винтового сверла Xive GS D 4.5	87
26 – 5508	Винтовое сверло Xive GS D 4.5 / L 8	84
26 – 5511	Винтовое сверло Xive GS D 4.5 / L 11	85
26 – 5513	Винтовое сверло Xive GS D 4.5 / L 13	85
26 – 5515	Винтовое сверло Xive GS D 4.5 / L 15	86
26 – 5595	Винтовое сверло Xive GS D 4.5 / L 9.5	85
26 – 5603	Набор широких втулок для винтовых сверл Xive GS D 2.0 – D 4.5	87
26 – 5605	Набор узких втулок для винтовых сверл Xive GS D 2.0 – D 3.8	87
26 – 5700	Имплантовод Xive GS для TempBase, короткий, узкий	88
26 – 5701	Имплантовод Xive GS для TempBase, короткий, широкий	88
26 – 5702	Имплантовод Xive GS для TempBase, длинный, узкий	88
26 – 5703	Имплантовод Xive GS для TempBase, длинный, широкий	88
26 – 5704	Широкая втулка Xive для имплантовода GS	88
26 – 5705	Узкая втулка Xive для имплантовода GS	88
26 – 5821	Позиционер Xive GS узкий для аналога импланта D 3.0	88
26 – 5831	Позиционер Xive GS узкий для аналога импланта D 3.4	88
26 – 5841	Позиционер Xive GS узкий для аналога импланта D 3.8	88
26 – 5850	Стабилизирующий абатмент Xive GS для TempBase узкий	88
26 – 5851	Позиционер Xive GS широкий для аналога импланта D 4.5	88
26 – 5852	Стабилизирующий абатмент Xive GS для TempBase широкий	88
26 – 6000	Хирургический набор Xive D 3.0 – D 5.5 / S+L	66
26 – 6003	Хирургический набор Xive D 3.0 / S+L	66
26 – 6005	Хирургический набор Xive D 3.0 – D 3.8 / S	66
26 – 6030	Имплантовод S (короткий) для имплантатов Xive S D 3.0	81
26 – 6035	Имплантовод L (длинный) для имплантатов Xive S D 3.0	81
26 – 6040	Имплантовод S (короткий) для имплантатов Xive S D 3.4 и TempBase	81
26 – 6045	Имплантовод L (длинный) для имплантатов Xive S D 3.4 и TempBase	81
26 – 6050	для имплантатов Xive S D 3.8 – D 5.5	81
26 – 6055	Имплантовод L (длинный) для имплантатов Xive S D 3.8 – D 5.5	81
26 – 6120	Вставка для трещотки для инструментов Xive	82
26 – 6130	Удлинитель Xive	82
26 – 6190	Машинная шестигранная отвертка Xive 0,9 мм / S (короткая)	81
26 – 6195	Машинная шестигранная отвертка Xive 0,9 мм / L (длинная)	81
26 – 7010	Лоток под хирургический набор Xive (пустой)	67
26 – 7025	Модуль сверл Xive D 3.0 (пустой)	67
26 – 7035	Модуль сверл Xive D 3.4 (пустой)	67
26 – 7045	Модуль сверл Xive D 3.8 (пустой)	67
26 – 7055	Модуль сверл Xive D 4.5 (пустой)	67
26 – 7065	Модуль сверл Xive D 5.5 (пустой)	67
26 – 7170	Модульная вставка Xive	67
26 – 7200	Модуль инструментов Xive (пустой)	67
26 – 8020	Базовый ортопедический набор Xive	91
26 – 8025	Лоток под базовый ортопедический набор Xive (пустой)	91
26 – 9020	Рентгенологический шаблон Xive S (субгингивальный)	65
26 – 9110	Демонстрационный набор Xive 5:1	97
27 – 9040	Абатмент Xive TitaniumBase D 3.8	57
27 – 9050	Абатмент Xive TitaniumBase D 4.5	57
27 – 9060	Абатмент Xive TitaniumBase D 5.5	57
27 – 9140	Абатмент Xive ScanBase D 3.8	57
27 – 9150	Абатмент Xive ScanBase D 4.5	57
27 – 9160	Абатмент Xive ScanBase D 5.5	57
3107 1003	Многоразовый фильтр для контейнера для стерилизации лотка Washtray (2 шт.)	70
3107 1004	Держатель для стержня стандарта ISO (5 шт.)	70
3107 1006	Держатель для вставки в трещотку (5 шт.)	70
3226 7800	Лоток Washtray Xive (с металлическим лотком и накладкой)	70
3226 7801	Накладка Washtray Xive	70
3226 7802	Контейнер для стерилизации лотка Washtray Xive (с 2 многоразовыми фильтрами для контейнера для стерилизации лотка Washtray)	70
45 – 1110	Винт-заглушка Xive PS D 3.4	18
45 – 1120	Винт-заглушка Friadent D 3.0	18
45 – 1130	Винт-заглушка Friadent D 3.4	18
45 – 1140	Винт-заглушка Friadent D 3.8	18
45 – 1150	Винт-заглушка Friadent D 4.5	18
45 – 1160	Винт-заглушка Friadent D 5.5	18

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Арт.	Название	Стр.
45 – 1222	Формирователь десны тонкий Xive PS D 3.4 / GH 2	23
45 – 1223	Формирователь десны тонкий Xive PS D 3.4 / GH 3	23
45 – 1225	Формирователь десны тонкий Xive PS D 3.4 / GH 5	23
45 – 1232	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.4 / GH 2	23
45 – 1233	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.4 / GH 3	23
45 – 1235	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.4 / GH 5	23
45 – 1238	Трансфер Xive S тонкий D 3.4	33
45 – 1239	Трансфер Friadent тонкий D 3.4	31
45 – 1242	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.8 / GH 2	23
45 – 1243	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.8 / GH 3	23
45 – 1245	Формирователь десны Friadent тонкий D 3.8 / GH 5	23
45 – 1249	Трансфер Friadent тонкий D 3.8	31
45 – 1252	Формирователь десны Friadent тонкий D 4.5 / GH 2	23
45 – 1253	Формирователь десны Friadent тонкий D 4.5 / GH 3	23
45 – 1255	Формирователь десны Friadent тонкий D 4.5 / GH 5	23
45 – 1259	Трансфер Friadent тонкий D 4.5	31
45 – 1333	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 3.4 / GH 3	24
45 – 1335	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 3.4 / GH 5	24
45 – 1343	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 3.8 / GH 3	24
45 – 1345	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 3.8 / GH 5	24
45 – 1353	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 4.5 / GH 3	24
45 – 1355	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 4.5 / GH 5	24
45 – 1363	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 5.5 / GH 3	24
45 – 1365	Формирователь десны Friadent с отверстиями D 5.5 / GH 5	24
45 – 1421	Формирователь десны Friadent D 3.0 / GH 1	22
45 – 1422	Формирователь десны Friadent D 3.0 / GH 2	22
45 – 1423	Формирователь десны Friadent D 3.0 / GH 3	22
45 – 1425	Формирователь десны Friadent D 3.0 / GH 5	22
45 – 1431	Формирователь десны Friadent D 3.4 / GH 1	22
45 – 1432	Формирователь десны Friadent D 3.4 / GH 2	22

Арт.	Название	Стр.
45 – 1433	Формирователь десны Friadent D 3.4 / GH 3	22
45 – 1435	Формирователь десны Friadent D 3.4 / GH 5	22
45 – 1441	Формирователь десны Friadent D 3.8 / GH 1	22
45 – 1442	Формирователь десны Friadent D 3.8 / GH 2	22
45 – 1443	Формирователь десны Friadent D 3.8 / GH 3	22
45 – 1445	Формирователь десны Friadent D 3.8 / GH 5	22
45 – 1451	Формирователь десны Friadent D 4.5 / GH 1	22
45 – 1452	Формирователь десны Friadent D 4.5 / GH 2	22
45 – 1453	Формирователь десны Friadent D 4.5 / GH 3	22
45 – 1455	Формирователь десны Friadent D 4.5 / GH 5	22
45 – 1461	Формирователь десны Friadent D 5.5 / GH 1	22
45 – 1462	Формирователь десны Friadent D 5.5 / GH 2	22
45 – 1463	Формирователь десны Friadent D 5.5 / GH 3	22
45 – 1465	Формирователь десны Friadent D 5.5 / GH 5	22
45 – 1531	Формирователь десны Xive PS D 3.4 / GH 1	23
45 – 1532	Формирователь десны Xive PS D 3.4 / GH 2	23
45 – 1533	Формирователь десны Xive PS D 3.4 / GH 3	23
45 – 1535	Формирователь десны Xive PS D 3.4 / GH 5	23
45 – 1615	Длинный винт трансфера Friadent D 3.4 – D 5.5	32
45 – 1620	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.0 / GH 3	30
45 – 1621	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.0 / GH 5	30
45 – 1622	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.0 / GH 5	29
45 – 1625	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.0 / GH 3	29
45 – 1629	Набор оттискных колпачков Friadent D 3.0	32
45 – 1630	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.4 / GH 3	30
45 – 1631	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.4 / GH 5	30
45 – 1632	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.4 / GH 5	29
45 – 1635	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.4 / GH 3	29
45 – 1639	Набор оттискных колпачков Friadent D 3.4	32
45 – 1640	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.8 / GH 3	30
45 – 1641	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.8 / GH 5	30
45 – 1642	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.8 / GH 5	29
45 – 1645	Трансфер Friadent для закр. ложки D 3.8 / GH 3	29
45 – 1649	Набор оттискных колпачков Friadent D 3.8	32

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
45 – 1650	Трансфер Friadent для закр. ложки D 4.5 / GH 3	30
45 – 1651	Трансфер Friadent для закр. ложки D 4.5 / GH 5	30
45 – 1652	Трансфер Friadent для закр. ложки D 4.5 / GH 5	29
45 – 1655	Трансфер Friadent для закр. ложки D 4.5 / GH 3	29
45 – 1659	Набор оттискных колпачков Friadent D 4.5	32
45 – 1660	Трансфер Friadent для закр. ложки D 5.5 / GH 3	30
45 – 1661	Трансфер Friadent для закр. ложки D 5.5 / GH 5	30
45 – 1662	Трансфер Friadent для закр. ложки D 5.5 / GH 5	29
45 – 1665	Трансфер Friadent для закр. ложки D 5.5 / GH 3	29
45 – 1669	Набор оттискных колпачков Friadent D 5.5	32
45 – 1830	Трансфер Xive PS для закр. ложки D 3.4 / GH 3	33
45 – 1831	Трансфер Xive PS для закр. ложки D 3.4 / GH 5	33
45 – 1832	Трансфер Xive PS для откр. ложки D 3.4 / GH 5	33
45 – 1835	Трансфер Xive PS для откр. ложки D 3.4 / GH 3	33
45 – 2119	Примерочный абатмент Friadent D 3.0 / A 0 (прямой)	64
45 – 2120	Примерочный абатмент Friadent D 3.4 / A 0 (прямой)	64
45 – 2121	Примерочный абатмент Friadent D 3.8 / A 0 (прямой)	64
45 – 2122	Примерочный абатмент Friadent D 4.5 / A 0 (прямой)	64
45 – 2123	Примерочный абатмент Friadent D 5.5 / A 0 (прямой)	64
45 – 2193	Набор примерочных абатментов Friadent D 3.4 / A 0 (прямые, 3 шт.)	64
45 – 2194	Набор примерочных абатментов Friadent D 3.8 / A 0 (прямые, 3 шт.)	64
45 – 2195	Набор примерочных абатментов Friadent D 4.5 / A 0 (прямые, 3 шт.)	64
45 – 2196	Набор примерочных абатментов Friadent D 5.5 / A 0 (прямые, 3 шт.)	64
45 – 2219	Примерочный абатмент Friadent D 3.0 / A 15 (угловой 15°)	64
45 – 2220	Примерочный абатмент Friadent D 3.4 / A 15 (угловой 15°)	64
45 – 2221	Примерочный абатмент Friadent D 3.8 / A 15 (угловой 15°)	64
45 – 2293	Набор примерочных абатментов Friadent D 3.4 / A 15 (угловые, 3 шт.)	64
45 – 2294	Набор примерочных абатментов Friadent D 3.8 / A 15 (угловые, 3 шт.)	64
45 – 2420	Абатмент Friadent AuroBase D 3.0	43
45 – 2430	Абатмент Friadent AuroBase D 3.4	43
45 – 2440	Абатмент Friadent AuroBase D 3.8	43
45 – 2450	Абатмент Friadent AuroBase D 4.5	43
45 – 2460	Абатмент Friadent AuroBase D 5.5	43
45 – 2530	Абатмент Friadent CeraBase D 3.4 конический	42
45 – 2531	Абатмент Friadent CeraBase D 3.4 анатомический	42
45 – 2540	Абатмент Friadent CeraBase D 3.8 конический	42
45 – 2541	Абатмент Friadent CeraBase D 3.8 анатомический	42
45 – 2550	Абатмент Friadent CeraBase D 4.5 конический	42
45 – 2551	Абатмент Friadent CeraBase D 4.5 анатомический	42
45 – 2560	Абатмент Friadent CeraBase D 5.5 конический	42
45 – 2561	Абатмент Friadent CeraBase D 5.5 анатомический	42
45 – 2620	Телескопический абатмент Friadent D 3.0	44
45 – 2621	Аналог Friadent для фрезерования D 3.0	34
45 – 2630	Телескопический абатмент Friadent D 3.4	44
45 – 2631	Аналог Friadent для фрезерования D 3.4	34
45 – 2640	Телескопический абатмент Friadent D 3.8	44
45 – 2641	Аналог Friadent для фрезерования D 3.8	34
45 – 2650	Телескопический абатмент Friadent D 4.5	44
45 – 2651	Аналог Friadent для фрезерования D 4.5	34
45 – 2660	Телескопический абатмент Friadent D 5.5	44
45 – 2661	Аналог Friadent для фрезерования D 5.5	34
45 – 3131	Шаровидный абатмент Friadent D 3.4 / GH 1	56
45 – 3132	Шаровидный абатмент Friadent D 3.4 / GH 2	56
45 – 3133	Шаровидный абатмент Friadent D 3.4 / GH 3	56
45 – 3141	Шаровидный абатмент Friadent D 3.8 / GH 1	56
45 – 3142	Шаровидный абатмент Friadent D 3.8 / GH 2	56
45 – 3143	Шаровидный абатмент Friadent D 3.8 / GH 3	56
45 – 3145	Шаровидный абатмент Friadent D 3.8 / GH 5	56
45 – 3151	Шаровидный абатмент Friadent D 4.5 / GH 1	56
45 – 3152	Шаровидный абатмент Friadent D 4.5 / GH 2	56
45 – 3153	Шаровидный абатмент Friadent D 4.5 / GH 3	56
45 – 3155	Шаровидный абатмент Friadent D 4.5 / GH 5	56
45 – 3161	Шаровидный абатмент Friadent D 5.5 / GH 1	56
45 – 3162	Шаровидный абатмент Friadent D 5.5 / GH 2	56

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Арт.	Название	Стр.
45 – 3163	Шаровидный абатмент Friadent D 5.5 / GH 3	56
45 – 3165	Шаровидный абатмент Friadent D 5.5 / GH 5	56
45 – 3200	Матрица шар. абатмента Friadent D 3.4 – D 5.5	56
45 – 3210	Уплотнительное кольцо Friadent	56
45 – 3340	3-компонентная отвертка Locator	55
45 – 3341	Втулка держателя абатмента Locator	55
45 – 3344	Вставка Friadent Locator для ортопедического ключа-трещотки	55
45 – 3345	Угломер Locator	55
45 – 3346	Штифт Locator для проверки параллельности	55
45 – 3347	Набор аттачментов Locator (титан)	55
45 – 3348	Набор аттачментов Locator (нерж. сталь)	55
45 – 3349	Сменная патрица Locator — прозрачная, сильная ретенция	55
45 – 3350	Сменная патрица Locator — розовая, слабая ретенция	55
45 – 3351	Сменная патрица Locator — синяя, очень слабая ретенция	55
45 – 3352	Сменная патрица Locator — расширенный спектр: зеленая, сильная ретенция	55
45 – 3353	Сменная патрица Locator — расширенный спектр: оранжевая, слабая ретенция	55
45 – 3354	Сменная патрица Locator — расширенный спектр: красная, очень слабая ретенция	55
45 – 3355	Оттискной колпачок Locator	55
45 – 3356	Матричный аналог Locator D 4	55
45 – 3357	Матричный аналог Locator D 5	55
45 – 3358	Черная рабочая патрица Locator	55
45 – 3359	Спейсерное кольцо Locator	55
45 – 3360	Сменная патрица Locator — расширенный спектр: серая, нулевая ретенция	55
45 – 3361	Спейсерный колпачок Locator	55
45 – 4020	Аналог имплантата Friadent D 3.0	34
45 – 4030	Аналог имплантата Friadent D 3.4	34
45 – 4040	Аналог имплантата Friadent D 3.8	34
45 – 4050	Аналог имплантата Friadent D 4.5	34
45 – 4060	Аналог имплантата Friadent D 5.5	34
45 – 4101	Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для балки D 3.4 – D 5.5	37
45 – 4102	Лаб. набор Friadent с аналогом для пайки для моста D 3.4 – D 5.5	37
45 – 4103	Аналог для пайки Friadent, универсальный, D 3.4 – D 5.5	37
45 – 4105	Аналог патрицы шар. абатмента Friadent, универсальный, D 3.4 – D 5.5	56

Арт.	Название	Стр.
45 – 4206	Винт Friadent для пайки для балки D 3.4 – D 5.5	37
45 – 4207	Винт Friadent для пайки для моста D 3.4 – D 5.5	40
45 – 4210	Круглая золотая балка Friadent, длина 50 мм	53
45 – 4212	Круглая титановая балка Friadent, длина 50 мм	53
45 – 4215	Клипса для золотой балки Friadent, длина 50 мм	53
45 – 4230	Золотой колпачок для балки Friadent D 3.4	51
45 – 4231	Титановый колпачок для балки Friadent D 3.4	52
45 – 4240	Золотой колпачок для балки Friadent D 3.8	51
45 – 4241	Титановый колпачок для балки Friadent D 3.8	52
45 – 4250	Золотой колпачок для балки Friadent D 4.5	51
45 – 4251	Титановый колпачок для балки Friadent D 4.5	52
45 – 4260	Золотой колпачок для балки Friadent D 5.5	51
45 – 4261	Титановый колпачок для балки Friadent D 5.5	52
45 – 4305	Стандартный винт абатмента Friadent D 3.4 – 5.5	32
45 – 4330	Отливаемая втулка Friadent D 3.4	48
45 – 4340	Отливаемая втулка Friadent D 3.8	48
45 – 4350	Отливаемая втулка Friadent D 4.5	48
45 – 4360	Отливаемая втулка Friadent D 5.5	48
45 – 4410	Посадочное кольцо для горизонтального винта Friadent	40
45 – 4530	Отливаемый колпачок для балки Friadent D 3.4	53
45 – 4540	Отливаемый колпачок для балки Friadent D 3.8	53
45 – 4550	Отливаемый колпачок для балки Friadent D 4.5	53
45 – 4560	Отливаемый колпачок для балки Friadent D 5.5	53
45 – 4630	Приливаемая втулка Friadent D 3.4	49
45 – 4640	Приливаемая втулка Friadent D 3.8	49
45 – 4650	Приливаемая втулка Friadent D 4.5	49
45 – 4660	Приливаемая втулка Friadent D 5.5	49
45 – 4741	Сварочная втулка Xive MP D 3.4 – D 3.8	58
45 – 4751	Сварочная втулка Xive MP D 4.5	58
45 – 4830	Набор Friadent PassivFit D 3.4	50
45 – 4840	Набор Friadent PassivFit D 3.8	50
45 – 4850	Набор Friadent PassivFit D 4.5	50
45 – 4860	Набор Friadent PassivFit D 5.5	50
45 – 5025	Примерочная втулка Friadent D 3.0	64

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
45 – 5035	Примерочная втулка Friadent D 3.4	64
45 – 5045	Примерочная втулка Friadent D 3.8	64
45 – 5055	Примерочная втулка Friadent D 4.5	64
45 – 5065	Примерочная втулка Friadent D 5.5	64
45 – 5106	Штифт для проверки параллельности Friadent D 2.0 / 3.0	80
45 – 5280	Инструмент для очистки сверла Friadent	80
45 – 5605	Инструмент для установки Friadent для трансфера	95
45 – 5617	Инструмент для установки Friadent для платформ шаровидного абатмента и абатмента MP	95
45 – 5618	Монтажное устройство Friadent для шестигранной отвертки	94
45 – 5621	Активатор Friadent для шаровидного абатмента	95
45 – 5622	Деактиватор Friadent для шаровидного абатмента	95
45 – 5623	Активатор балочной клипсы Friadent	96
45 – 5650	Шестигранная отвертка Friadent, ширина 0,9 мм	94
45 – 5660	Мукотом Friadent D 3.8	83
45 – 5661	Мукотом Friadent D 4.5	83
45 – 5662	Мукотом Friadent D 5.5	83
45 – 5665	Мукотом Friadent D 3.0	83
45 – 5666	Мукотом Friadent D 3.4	83
45 – 5700	Шабер Friadent для винтов супраструктур на винтовой фиксации	96
45 – 5702	Шабер Friadent для горизонтального винта	96
45 – 5705	Шабер Friadent для абатментов супраструктур на винтовой фиксации D 3.4 – D 4.5	96
45 – 5707	Шабер Friadent для абатментов супраструктур на винтовой фиксации D 5.5	96
45 – 5709	Ключ-трещотка Friadent	93
45 – 5714	Шлицевая отвертка Friadent с шириной шлица 2,0 мм / 14 Нсм / короткая	93
45 – 5722	Шлицевая отвертка Friadent с шириной шлица 2,0 мм / 14 Нсм / длинная	93
45 – 5732	Шестигранная отвертка Friadent / ширина 0,9 мм / 14 Нсм / короткая	93
45 – 5733	Шестигранная отвертка Friadent / ширина 0,9 мм / 14 Нсм / длинная	93
45 – 5734	Шестигранная отвертка Friadent / ширина 1,22 мм / 24 Нсм / короткая	93
45 – 5736	Шестигранная отвертка Friadent / ширина 1,22 мм / 24 Нсм / длинная	93
45 – 5753	Алмазная фреза Friadent CeraBase, средняя зернистость	95
45 – 5755	Алмазная фреза Friadent CeraBase, мелкая зернистость	95
45 – 6010	Хирургический ключ-трещотка Xive	82
45 – 6020	Ключ-трещотка Xive	82
45 – 9981	Акриловая модель в/ч Friadent без протеза	97
45 – 9982	Акриловая модель в/ч Friadent с протезом	97
45 – 9985	Акриловая модель н/ч Xive без протеза (балочная конструкция)	97
45 – 9986	Акриловая модель н/ч Xive с протезом (балочная конструкция)	97
46 – 1220	Временный абатмент Friadent TempBase D 3.0	21
46 – 1230	Временный абатмент Friadent TempBase D 3.4	21
46 – 1231	Временный сварочный абатмент Xive D 3.4	58
46 – 1235	Колпачок Friadent TempBase Cap D 3.0 – D 3.8	21
46 – 1240	Временный абатмент Friadent TempBase D 3.8	21
46 – 1241	Временный сварочный абатмент Xive D 3.8	58
46 – 1250	Временный абатмент Friadent TempBase D 4.5	21
46 – 1251	Временный сварочный абатмент Xive D 4.5	58
46 – 1255	Колпачок Friadent TempBase Cap D 4.5	21
46 – 1260	Временный абатмент Friadent TempBase D 5.5	21
46 – 1265	Колпачок Friadent TempBase Cap D 5.5	21
46 – 1279	Винт для Friadent TempBase D 3.0	21
46 – 1280	Винт для Friadent TempBase D 3.4 – D 5.5	21
46 – 1430	Винт-заглушка Friadent MP D 3.4	46
46 – 1440	Винт-заглушка Friadent MP D 3.8	46
46 – 1450	Винт-заглушка Friadent MP D 4.5	46
46 – 1460	Винт-заглушка Friadent MP D 5.5	46
46 – 1605	Длинный винт трансфера Friadent D 3.0	32
46 – 1615	Длинный винт трансфера Friadent MP	36
46 – 1616	Винт для сварочной втулки	58
46 – 1630	Трансфер Friadent MP для откр. ложки D 3.4	36
46 – 1632	Трансфер Friadent базовый D 3.4	31
46 – 1635	Трансфер Friadent MP для закр. ложки D 3.4	36
46 – 1640	Трансфер Friadent MP для откр. ложки D 3.8	36
46 – 1642	Трансфер Friadent базовый D 3.8	31
46 – 1645	Трансфер Friadent MP для закр. ложки D 3.8	36
46 – 1650	Трансфер Friadent MP для откр. ложки D 4.5	36
46 – 1652	Трансфер Friadent базовый D 4.5	31
46 – 1655	Трансфер Friadent MP для закр. ложки D 4.5	36
46 – 1660	Трансфер Friadent MP для откр. ложки D 5.5	36

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Арт.	Название	Стр.
46 – 1662	Трансфер Friadent базовый D 5.5	31
46 – 1665	Трансфер Friadent MP для закр. ложки D 5.5	36
46 – 1730	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 3.4 / овальный	25
46 – 1740	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 3.8 / овальный	25
46 – 1745	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 3.8 / треугольный	25
46 – 1750	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 4.5 / овальный	25
46 – 1755	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 4.5 / треугольный	25
46 – 1760	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 5.5 / овальный	25
46 – 1765	Временный абатмент Friadent EsthetiCap D 5.5 / треугольный	25
46 – 2121	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 1 прямой / A 0	38
46 – 2122	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 2 прямой / A 0	38
46 – 2123	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 3 прямой / A 0	38
46 – 2125	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 5 прямой / A 0	38
46 – 2131	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 1 прямой / A 0	38
46 – 2132	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 2 прямой / A 0	38
46 – 2133	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 3 прямой / A 0	38
46 – 2135	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 5 прямой / A 0	38
46 – 2141	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 1 прямой / A 0	38
46 – 2142	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 2 прямой / A 0	38
46 – 2143	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 3 прямой / A 0	38
46 – 2145	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 5 прямой / A 0	38
46 – 2151	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 1 прямой / A 0	38
46 – 2152	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 2 прямой / A 0	38
46 – 2153	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 3 прямой / A 0	38
46 – 2155	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 5 прямой / A 0	38
46 – 2161	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 1 прямой / A 0	38
46 – 2162	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 2 прямой / A 0	38
46 – 2163	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 3 прямой / A 0	38
46 – 2165	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 5 прямой / A 0	38
46 – 2221	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 1 угловой / A 15	39
46 – 2222	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 2 угловой / A 15	39
46 – 2223	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 3 угловой / A 15	39
46 – 2225	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.0 / GH 5 угловой / A 15	39
46 – 2231	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 1 угловой / A 15	39
46 – 2232	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 2 угловой / A 15	39
46 – 2233	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 3 угловой / A 15	39
46 – 2235	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.4 / GH 5 угловой / A 15	39
46 – 2241	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 1 угловой / A 15	39
46 – 2242	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 2 угловой / A 15	39
46 – 2243	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 3 угловой / A 15	39
46 – 2245	Абатмент Friadent EstheticBase D 3.8 / GH 5 угловой / A 15	39
46 – 2251	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 1 угловой / A 15	39
46 – 2252	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 2 угловой / A 15	39
46 – 2253	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 3 угловой / A 15	39
46 – 2255	Абатмент Friadent EstheticBase D 4.5 / GH 5 угловой / A 15	39
46 – 2261	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 1 угловой / A 15	39
46 – 2262	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 2 угловой / A 15	39
46 – 2263	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 3 угловой / A 15	39
46 – 2265	Абатмент Friadent EstheticBase D 5.5 / GH 5 угловой / A 15	39
46 – 2331	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 1 прямой / A 0	40
46 – 2332	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 2 прямой / A 0	40
46 – 2333	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 3 прямой / A 0	40
46 – 2335	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 5 прямой / A 0	40

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
46 – 2431	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 1 угловой / A 15	40
46 – 2432	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 2 угловой / A 15	40
46 – 2433	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 3 угловой / A 15	40
46 – 2435	Абатмент Xive EstheticBase PS D 3.4 / GH 5 угловой / A 15	40
46 – 2831	Абатмент Friadent MP D 3.4 / GH 1	45
46 – 2832	Абатмент Friadent MP D 3.4 / GH 2	45
46 – 2833	Абатмент Friadent MP D 3.4 / GH 3	45
46 – 2835	Абатмент Friadent MP D 3.4 / GH 5	45
46 – 2841	Абатмент Friadent MP D 3.8 / GH 1	45
46 – 2842	Абатмент Friadent MP D 3.8 / GH 2	45
46 – 2843	Абатмент Friadent MP D 3.8 / GH 3	45
46 – 2845	Абатмент Friadent MP D 3.8 / GH 5	45
46 – 2849	Абатмент Friadent MP D 3.8 / GH 9	45
46 – 2851	Абатмент Friadent MP D 4.5 / GH 1	45
46 – 2852	Абатмент Friadent MP D 4.5 / GH 2	45
46 – 2853	Абатмент Friadent MP D 4.5 / GH 3	45
46 – 2855	Абатмент Friadent MP D 4.5 / GH 5	45
46 – 2859	Абатмент Friadent MP D 4.5 / GH 9	45
46 – 2861	Абатмент Friadent MP D 5.5 / GH 1	45
46 – 2862	Абатмент Friadent MP D 5.5 / GH 2	45
46 – 2863	Абатмент Friadent MP D 5.5 / GH 3	45
46 – 2865	Абатмент Friadent MP D 5.5 / GH 5	45
46 – 2921	Абатмент Xive MP PS D 3.4 / GH 1	46
46 – 2922	Абатмент Xive MP PS D 3.4 / GH 2	46
46 – 2923	Абатмент Xive MP PS D 3.4 / GH 3	46
46 – 2925	Абатмент Xive MP PS D 3.4 / GH 5	46
46 – 2932	Абатмент Xive MP D 3.4 / GH 2, угловой / A 15	47
46 – 2933	Абатмент Xive MP D 3.4 / GH 3, угловой / A 15	47
46 – 2935	Абатмент Xive MP D 3.4 / GH 5, угловой / A 15	47
46 – 2942	Абатмент Xive MP D 3.8 – D 5.5 / GH 2, угловой / A 15	47
46 – 2943	Абатмент Xive MP D 3.8 – D 5.5 / GH 3, угловой / A 15	47
46 – 2945	Абатмент Xive MP D 3.8 – D 5.5 / GH 5, угловой / A 15	47
46 – 3032	Абатмент Xive MP D 3.4 / GH 2, угловой / A 30	47
46 – 3033	Абатмент Xive MP D 3.4 / GH 3, угловой / A 30	47
46 – 3042	Абатмент Xive MP D 3.8 – D 5.5 / GH 2, угловой / A 30	47
46 – 3043	Абатмент Xive MP D 3.8 – D 5.5 / GH 3, угловой / A 30	47
46 – 3100	Платформа абатмента Xive MP	47
46 – 3130	Ретенционная гильза Xive MP короткая D 3.4	50
46 – 3140	Ретенционная гильза Xive MP короткая D 3.8	50
46 – 3150	Ретенционная гильза Xive MP короткая D 4.5	50
46 – 3160	Ретенционная гильза Xive MP короткая D 5.5	50
46 – 3230	Ретенционная гильза Xive MP длинная D 3.4	50
46 – 3240	Ретенционная гильза Xive MP длинная D 3.8	50
46 – 3250	Ретенционная гильза Xive MP длинная D 4.5	50
46 – 3260	Ретенционная гильза Xive MP длинная D 5.5	50
46 – 4030	Аналог Friadent MP D 3.4	37
46 – 4040	Аналог Friadent MP D 3.8	37
46 – 4050	Аналог Friadent MP D 4.5	37
46 – 4060	Аналог Friadent MP D 5.5	37
46 – 4200	Винт Friadent MP для колпачка D 3.4 – D 5.5	51
46 – 4300	Винт Friadent MP для отливаемой втулки D 3.4 – D 5.5	48
46 – 4301	Винт Xive MP длинный D 3.4 – D 5.5	50
46 – 4304	Стандартный винт абатмента Friadent D 3.0	40
46 – 4305	Винт Friadent для EstheticBase D 3.4 – D 5.5	40
46 – 4401	Стандартный горизонтальный винт Friadent	40
46 – 4402	Длинный горизонтальный винт Friadent	40
46 – 4403	Набор со стандартным горизонтальным винтом Friadent	40
46 – 4404	Набор с длинным горизонтальным винтом Friadent	40
46 – 4405	Стандартный трансверзальный винт Friadent	40
46 – 4406	Длинный трансверзальный винт Friadent	40
46 – 4407	Набор со стандартным трансверзальным винтом Friadent	40
46 – 4408	Набор с длинным трансверзальным винтом Friadent	40
46 – 5610	Насадка для ключа-трещотки Friadent для винта MP	95
46 – 5615	Машинная отвертка Friadent для винта MP (для углового наконечника)	95
46 – 5710	Машинная шестигранная отвертка Friadent ширина 0,9 мм / короткая	94
46 – 5711	Машинная шестигранная отвертка Friadent ширина 1,22 мм / короткая	94
46 – 5712	Машинная шлицевая отвертка Friadent ширина шлица 2,0 мм / короткая	94
46 – 5720	Машинная шестигранная отвертка Friadent ширина 0,9 мм / длинная	94

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Арт.	Название	Стр.
46 – 5721	Машинная шестигранная отвертка Friadent ширина 1,22 мм / длинная	94
46 – 5722	Машинная шлицевая отвертка Friadent ширина шлица 2,0 мм / длинная	94
46 – 5750	Ручка Friadent для машинной шестигранной отвертки	94
46 – 5880	Ручной имплантовод Friadent, длинный	82
46 – 7000	Малый ортопедический набор Friadent	91
46 – 7001	Малый ортопедический набор Friadent (пустой)	91
46 – 8123	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.0 / GH 3	28
46 – 8125	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.0 / GH 5	28
46 – 8130	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP D 3.4	35
46 – 8133	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.4 / GH 3	28
46 – 8135	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.4 / GH 5	28
46 – 8140	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP D 3.8	35
46 – 8143	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.8 / GH 3	28
46 – 8145	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 3.8 / GH 5	28
46 – 8150	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP D 4.5	35
46 – 8153	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 4.5 / GH 3	28
46 – 8155	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 4.5 / GH 5	28
46 – 8160	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent MP D 5.5	35
46 – 8163	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 5.5 / GH 3	28
46 – 8165	Лаб. набор для снятия оттиска закр. ложкой Friadent D 5.5 / GH 5	28
46 – 8223	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.0 / GH 3	27
46 – 8225	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.0 / GH 5	27
46 – 8230	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP D 3.4	35
46 – 8233	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.4 / GH 3	27
46 – 8235	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.4 / GH 5	27
46 – 8240	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP D 3.8	35
46 – 8243	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.8 / GH 3	27
46 – 8245	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 3.8 / GH 5	27
46 – 8250	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP D 4.5	35
46 – 8253	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 4.5 / GH 3	27
46 – 8255	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 4.5 / GH 5	27
46 – 8260	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent MP D 5.5	35
46 – 8263	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 5.5 / GH 3	27
46 – 8265	Лаб. набор для снятия оттиска откр. ложкой Friadent D 5.5 / GH 5	27
46 – 9530	Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста D 3.4	48
46 – 9540	Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста D 3.8	48
46 – 9550	Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста D 4.5	48
46 – 9560	Лаб. набор Friadent MP с отливаемой втулкой для моста D 5.5	48
46 – 9630	Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки D 3.4	51
46 – 9637	Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки D 3.4	52
46 – 9638	Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки D 3.4	53
46 – 9640	Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки D 3.8	51
46 – 9647	Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки D 3.8	52
46 – 9648	Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки D 3.8	53
46 – 9650	Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки D 4.5	51
46 – 9657	Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки D 4.5	52
46 – 9658	Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки D 4.5	53
46 – 9660	Лаб. набор Friadent MP с золотым колпачком для балки D 5.5	51
46 – 9667	Лаб. набор Friadent MP с титановым колпачком для балки D 5.5	52
46 – 9668	Лаб. набор Friadent MP с отливаемым колпачком для балки D 5.5	53
46 – 9930	Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста D 3.4	49
46 – 9940	Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста D 3.8	49
46 – 9950	Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста D 4.5	49

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Указатель продукции

Арт.	Название	Стр.
46 – 9960	Лаб. набор Friadent MP с приливаемой втулкой для моста D 5.5	49
47 – 1141	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 1, нейтральный, прямой / A 0	41
47 – 1142	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 2, нейтральный, прямой / A 0	41
47 – 1151	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 1, нейтральный, прямой / A 0	41
47 – 1152	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 2, нейтральный, прямой / A 0	41
47 – 1241	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 1, нейтральный, угловой / A 15	41
47 – 1242	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 2, нейтральный, угловой / A 15	41
47 – 1251	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 1, нейтральный, угловой / A 15	41
47 – 1252	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 2, нейтральный, угловой / A 15	41
47 – 2141	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 1, дентин, прямой / A 0	41
47 – 2142	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 2, дентин, прямой / A 0	41
47 – 2151	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 1, дентин, прямой / A 0	41
47 – 2152	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 2, дентин, прямой / A 0	41
47 – 2241	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 1, дентин, угловой / A 15	41
47 – 2242	Абатмент Friadent Cercon D 3.8 / GH 2, дентин, угловой / A 15	41
47 – 2251	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 1, дентин, угловой / A 15	41
47 – 2252	Абатмент Friadent Cercon D 4.5 / GH 2, дентин, угловой / A 15	41
47 – 3012	Титановая проволока Friadent 1.2 / L 100, класс 2	59
47 – 3013	Титановая проволока Friadent 1.5 / L 150, класс 2	59
47 – 3014	Титановая проволока Friadent 2.0 / L 150, класс 2	59
47 – 4710	Сварочный аппарат WeldOne	59
49 – 1211	Рентгеноконтрастные шарики Friadent	65
90 – 5005	Универсальный шланг системы охлаждения Frios ISU	90
90 – 5030	Прямой наконечник Frios	89
90 – 5042	Ирригационная трубка для углового наконечника Frios 20:1	80
90 – 5043	Длинная внутренняя ирригационная трубка (для удлинителя)	80
90 – 5050	Угловой наконечник Frios	89
90 – 6410	Хирургический мотор физиодиспенсера Frios S	90
90 – 6420	Ножная педаль физиодиспенсера Frios S	90
90 – 6440	Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S (кабель мотора 1,8 м)	90
90 – 6441	Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S (кабель мотора 3,5 м)	90
90 – 6442	Стерильная защитная пленка для физиодиспенсеров Frios S, Frios E	90
90 – 6443	Набор фиксаторов трубок для физиодиспенсера Frios S	90
90 – 6446	Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios S/i	90
90 – 6542	Шланг системы охлаждения физиодиспенсера Frios E	90
90 – 6600	Физиодиспенсер Frios S/i 220–240 В перем. тока	89
90 – 6605	Физиодиспенсер Frios S/i 100–130 В перем. тока	89
90 – 6620	Хирургический мотор физиодиспенсера Frios S/i	90
90 – 6630	Ножная педаль Frios S/i	90
90 – 6710	Угловой наконечник Frios WI-75	89
90 – 6720	Угловой наконечник Frios WS-75	89
90 – 6810	Угловой наконечник Frios WI-75 LED G	89
90 – 6850	Прямой наконечник Frios SI-11 LED G	89
91 – 0003	Удлинитель сверла Friadent	80
91 – 4502	Пин для примерочной втулки FRIADENT	64

На некоторых рынках данные изделия могут быть не согласованы с регулирующими органами / отсутствовать в продаже / не иметь лицензии. За информацией о текущем ассортименте и наличии изделий обращайтесь в местный отдел сбыта компании Dentsply Sirona Implants. Для улучшения читаемости документа компания Dentsply Sirona Implants не использует символы ® и ™ в основном тексте. Тем не менее компания Dentsply Sirona Implants не отказывается от своих прав на товарные знаки, и данный документ не может быть истолкован иначе.
Обратите внимание на то, что показанные в каталоге продукции размеры могут отличаться от оригинальных из-за особенностей печати.

Маркировка материалов
Информация о материалах, используемых в имплантатах, компонентах систем и инструментах приводится с помощью символа сноски, указываемого после каждого элемента. Формирователь десны Friadent². На стр. 99 каталога приведено описание используемых материалов и их составов. Изображения в данном каталоге служат только в качестве иллюстраций. Размеры изображенных изделий могут отличаться от размеров оригинальных изделий. Компания Dentsply Sirona Implants оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

О компании Dentsply Sirona Implants

Компания Dentsply Sirona Implants предлагает широчайший ассортимент решений для всех этапов лечения с помощью имплантатов, в том числе системы имплантатов Ankylos®, Astra Tech Implant System® и Xive®, цифровые технологии, такие как Atlantis® — высокоиндивидуализированные CAD/CAM-решения — и навигационная хирургия Simplant®, решения по восстановительному лечению Symbios® и программы повышения квалификации и развития бизнеса, такие как STEPPS™. Dentsply Sirona Implants — надежный партнер специалистов в области стоматологии, дающий возможность добиваться предсказуемых и долговечных результатов дентальной имплантации и улучшать качество жизни пациентов.

О компании Dentsply Sirona

Dentsply Sirona — крупнейший мировой производитель профессиональных стоматологических материалов и технологий, который уже более 130 лет внедряет инновации и оказывает услуги стоматологам и пациентам по всему миру. Dentsply Sirona разрабатывает, производит и продает полную линейку решений, включая стоматологическую продукцию и продукцию для гигиены полости рта, а также другие расходные медицинские устройства из обширного ассортимента брендов мирового уровня.
Изделия Dentsply Sirona под маркой The Dental Solutions Company™ — это инновационные эффективные решения для более качественного, безопасного и быстрого лечения зубов.
Общемировая штаб-квартира Dentsply Sirona находится в Йорке (Пенсильвания, США), а международная штаб-квартира — в Зальцбурге (Австрия). Акции компании представлены на американской бирже NASDAQ под кодом XRAY.

Дополнительную информацию о компании Dentsply Sirona и ее продукции см. на сайте www.dentsplysirona.com.

THE DENTAL SOLUTIONS COMPANY™

Dentsply Sirona

Компания Dentsply Sirona не отказывается от каких-либо прав на свои товарные знаки, опуская символы ® или ™. 326700052-RU-1611 © Dentsply Sirona, 2016 г. Все права защищены.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ