

stomdevice

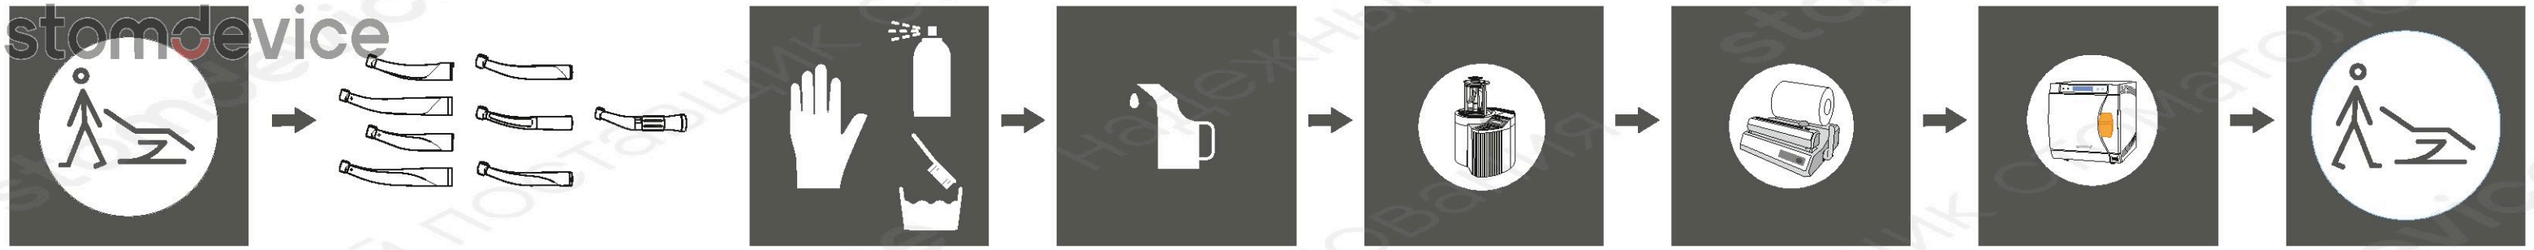

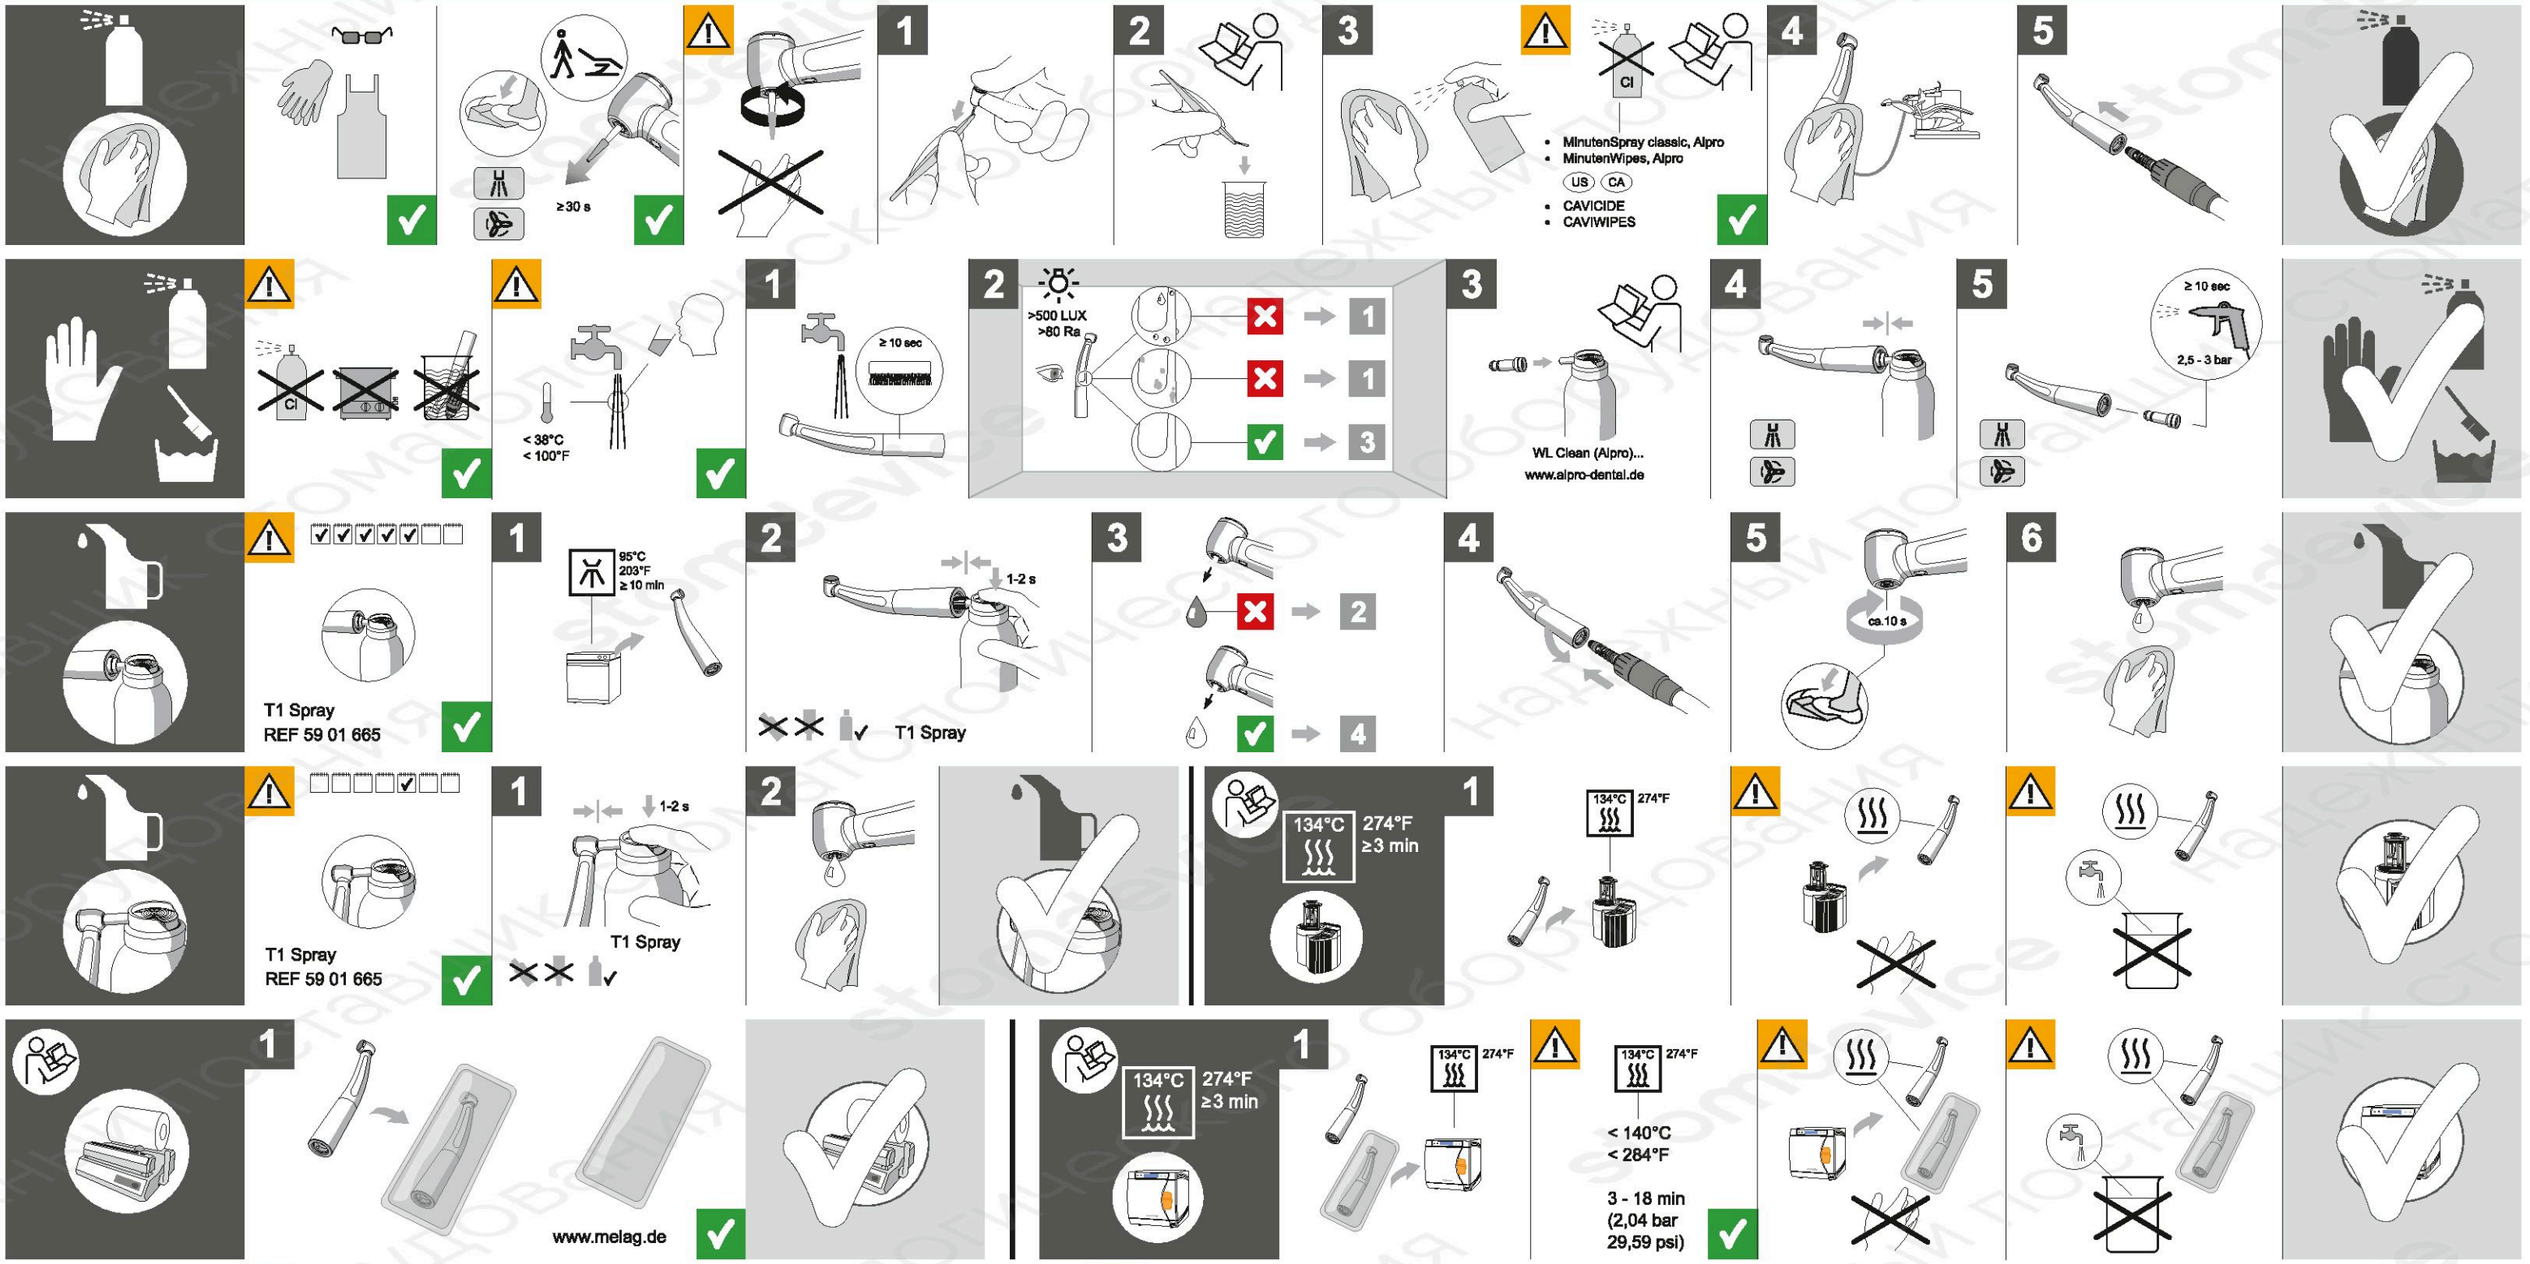

Diese Übersicht der Aufbereitung ist vereinfacht dargestellt. Eine Abfolge der Maßnahmen ist von den praxisinternen technischen Voraussetzungen abhängig. Die Gebrauchsanweisung der zur Anwendung kommenden Hand- und Winkelstücke und Turbinen sowie der Geräte sind zu beachten! Eine maschinelle Aufbereitung ist der manuellen Aufbereitung vorzuziehen.

This preparation overview is presented in simplified form. The sequence of measures depends on the technical requirements of each practice.The operating instructions of the applied handpieces, contra-angel handpieces, turbine and the devices are to be observed!

Este resumen del acondicionamiento se ha simplificado. La secuencia de medidas depende de los requisitos técnicos internos de la clínica. ¡Debe observarse el Manual del operador de las piezas de mano, contra-ángulos y turbinas, así como de los aparatos!

Dit overzicht voor de voorbereiding is vereenvoudigd weergegeven. Een volgorde van de maatregelen is afhankelijk van de praktische, interne, technische voorwaarden. De gebruiksaanwijzingen die voor de gebruikte hand- en hoekstukken en turbines worden gebruikt, alsook voor de apparaten, moeten in acht worden genomen!

Ce récapitulatif fournit une représentation simplifiée du traitement des instruments. L'ordre des mesures dépend des conditions techniques propres au cabinet. Observez les notices d'utilisation des pièces-à-main, des contre-angles et des turbines ainsi que des appareils utilisés !

La presente panoramica sulla preparazione è rappresentata in maniera semplificata. La secuencia de medidas depende de los requisitos técnicos internos de la clínica. Rispettra le istruzioni d'uso die manipoli/contragoli, delle turbine e degli apparecchi utilizzati.

Helix:
REF 58 92 042

Indicators (100x):
REF 59 03 641


Bowie & Dick:
REF 58 92 034

Dentsply Sirona
Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
D-64625 Bensheim
Germany
www.dentsplysirona.com

© Sirona Dental Systems GmbH
REF: 59 58 579, 59 58 587, 59 58 595, 59 58 603, 59 58 611, 59 58 629, 64 12 493, 62 01 730
Ä-Nr.: 124 375 (11/2017)
D3300.104.01.09.09 Printed in Germany, Imprimé en Allemagne

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

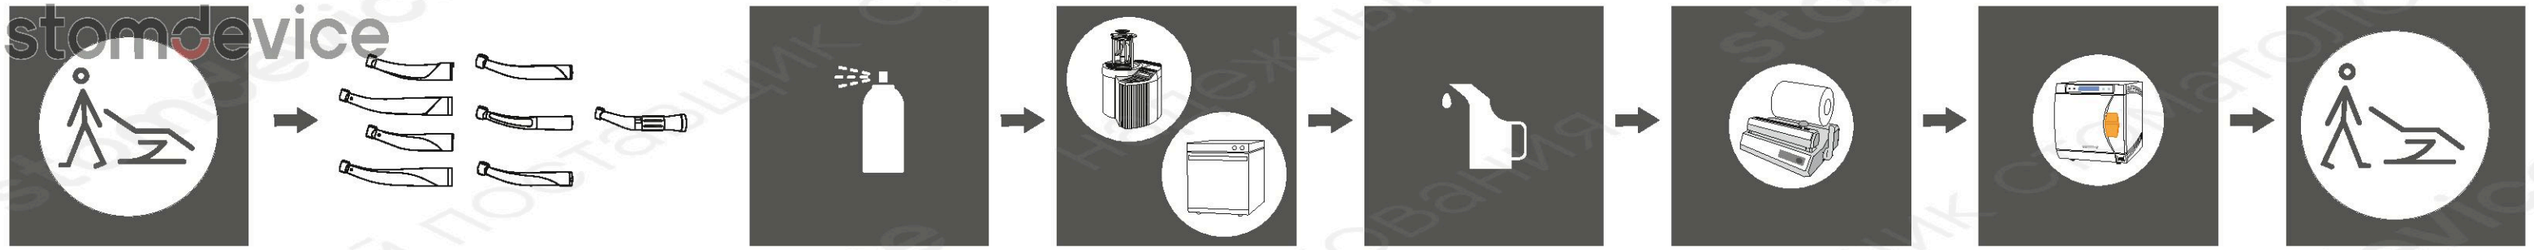

Helix:
REF 58 92 042

Indicators (100x):
REF 59 03 641

Bowie & Dick:
REF 58 92 034

この説明書では、一般的な手順を簡単に説明しています。各診療の技術的な要件により、手順や対策が異なることに注意してください。 手順の詳細は、装着するストレート&コントラアングルハンドピースおよびタービン、器具の取扱説明書の指示に従ってください。

이 처리 개요는 단순하게 설명한 것입니다. 처리 순서가 치과 내부의 기술적인 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 사용하는 핸드피스와 콘트라 앵글 핸드피스와 터빈 및 장치의 사용 설명서를 유의하십시오!

www.melag.de

D3300.104.01.09.09 11.2017 124 375 59 58 579, 59 58 587, 59 58 595, 59 58 603, 59 58 611, 59 58 629, 62 01 730, 64 12 493 D 3300

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ