stomdevice


Действует с: 12.2017

sirona
The Dental Company

GALILEOS

Инструкция по эксплуатации GALILEOS Comfort PLUS

Русский

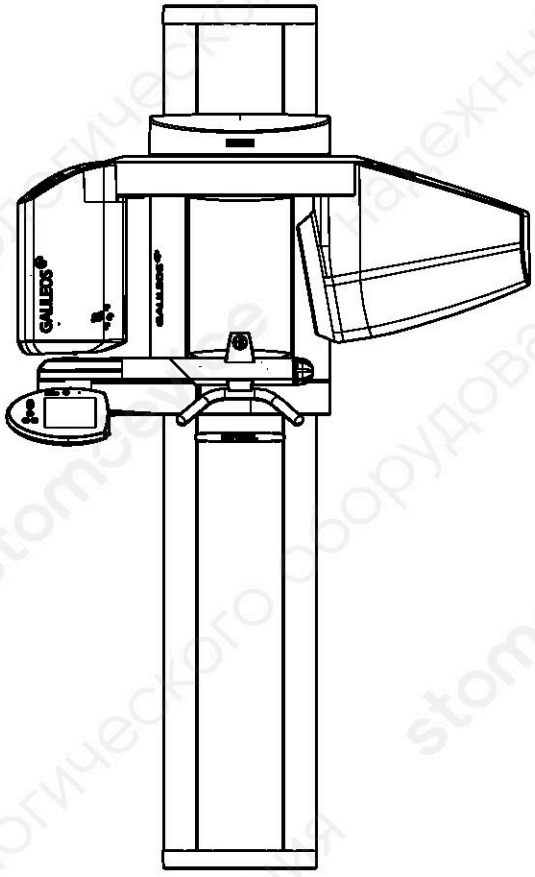

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Оглавление

1 Общие сведения 6
1.1 Уважаемый покупатель! 6
1.2 Контактные данные 6
1.3 Общие указания к инструкции по эксплуатации 7
1.4 Дополнительно требуемые документы 7
1.5 Гарантия и ответственность 8
1.6 Обязанности эксплуатирующей организации и персонала 8
1.7 Использование по назначению 9
1.8 Показания и противопоказания 9
1.9 Структура документа 10
1.9.1 Обозначения степени опасности 10
1.9.2 Используемое форматирование и символы 10
2 Указания по технике безопасности 11
2.1 Указания на аппарате 11
2.2 Вентиляционные щели 11
2.3 Образование конденсата 12
2.4 Квалификация обслуживающего персонала 12
2.5 Включение аппарата 12
2.6 Защита от излучения 12
2.7 Аварийный останов 13
2.8 Лазерный световой прицел 13
2.9 Гигиена 13
2.10 Сенсорный экран 13
2.11 Бесперебойная работа 14
2.12 Неисправность электронных приборов 14
2.13 Риски, создаваемые электромагнитными полями 14
2.14 Комбинирование с другими приборами 14
2.15 Изменения аппарата 15
2.16 Строительные изменения 15
2.17 Электромагнитная совместимость 15
2.18 Электростатический разряд (ЭСР) 16
2.18.1 Меры по предотвращению ЭСР 16
2.18.2 О физике электростатического заряда 16

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3 Техническое описание ... 18
3.1 Технические характеристики ... 18
3.2 Диаграммы ... 21
3.3 Значения вторичного рассеянного излучения ... 23
3.4 Сертификация и регистрация ... 24
4 Органы управления и функционирования ... 25
4.1 Органы управления и индикации на GALILEOS ... 25
4.2 Органы управления и индикации на фиксаторе головы ... 26
4.3 Органы управления и индикаторы на Easypad с сенсорным экраном ... 27
4.4 Общие функции сенсорного экрана на панели Easypad ... 27
4.4.1 Настройки программы (Уровень 2) ... 29
4.4.2 Меню "Настройки запуска" (Уровень 4) ... 29
4.4.3 Меню Сервис ... 30
4.4.4 Настройки сенсорного экрана ... 30
4.4.5 Закрытие строк меню ... 30
4.4.6 Информационный экран ... 31
5 Принадлежности ... 32
5.1 Накусочные пластины, опоры и фиксаторы ... 32
5.2 Принадлежности к фиксатору головы ... 33
5.3 Гигиенические защитные чехлы ... 34
5.3.1 Гигиенические защитные чехлы для накусочных пластин, опор и фиксаторов 34
5.3.2 Гигиенические защитные чехлы для фиксатора головы ... 35
5.4 Опытный образец для контроля съёмки/стабильности параметров ... 36
6 Программы ... 37
6.1 VO5: стандартная программа объема ... 37
6.1.1 Режим HC: режим высокой контрастности ... 38
6.1.2 Режим HD: режим высокого разрешения ... 38
6.2 VOG: объемная программа для сканирования шаблона ... 39
7 Управление ... 40
7.1 Подготовка к рентгенографии ... 40
7.1.1 Установка принадлежностей ... 40
7.1.2 Установка фиксатора головы ... 42
7.1.3 Включение аппарата ... 44
7.1.4 Индикация на сенсорном экране на панели Easypad ... 44
7.1.5 Включение Sidexis 4 в состояние готовности к рентгенографии 45
7.1.6 SIDEXIS включить в состояние готовности к рентгенографии ... 45

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7.2 Выбор параметров рентгенографии (значения кВ/мАс/дозы) 46
7.3 Настройка высокой контрастности 47
7.4 Настройка режима HD 48
7.5 Регулировка механической диафрагмы 49
7.6 Позиционирование пациента 50
7.6.1 Позиционирование пациента с накусочной пластиной 51
7.6.1.1 Выравнивание пациента с помощью стандартной накусочной пластины 51
7.6.1.2 Выравнивание пациента с опорой для подбородка, накусочной пластиной и контактной скобой 52
7.6.2 Позиционирование пациента фиксатором головы (например, для KFO) 53
7.6.3 Позиционирование пациента с шариковой накусочной пластиной 55
7.6.4 Индикация средней сагиттальной 55
7.7 Включение рентгенографии 56
7.8 Дистанционное пусковое устройство (ДПУ) 60
8 Список сообщений 61
8.1 Список справочных сообщений 61
8.2 Структра сообщений об ошибках 62
8.2.1 Ex 62
8.2.2 yy 63
8.2.3 zz 64
8.3 Сообщение об ошибке E1 10 07 64
9 Техническое обслуживание 65
9.1 Очистка и уход 65
9.1.1 Очистка 65
9.1.2 Дезинфекция 65
9.1.3 Стерилизация 66
9.2 Осмотр и техническое обслуживание 68
10 Демонтаж и утилизация 69
10.1 Демонтаж и повторная установка 69
10.2 Утилизация 69
10.2.1 Рентгеновская трубка GALILEOS 70
11 Данные по дозе 71

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 Общие сведения

1.1 Уважаемый покупатель!

Мы рады, что Вы решили оснастить свою практику рентгеновской системой GALILEOS Comfort PLUS компании Sirona.

Система GALILEOS состоит из рентгеновского аппарата, использующего циркулирующий конический рентгеновский луч и оптическую систему. При этом для планирования и диагностики получаются двухмерные снимки и трехмерные реконструкции поверхности области головы (включая зубо-челюстно-лицевой и ЛОР-области).

Система включает в себя также пакет программных модулей, позволяющий SIDEXIS обрабатывать 3D-данные. Сюда входят 3D-реконструкция, сохранение, повторный вызов, индикация и обработка данных 3D-рентгенограмм.

Настоящая Инструкция по эксплуатации должна помочь вам перед началом использования и в случае последующей потребности в дополнительной информации.

Желаем Вам успеха и удовольствия при работе с GALILEOS Comfort PLUS.

Группа разработчиков GALILEOS

1.2 Контактные данные

Центр технической поддержки

По техническим вопросам используйте форму обратной связи на нашем сайте:
http://srvcontact.sirona.com

Адрес производителя



Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim
Германия

Тел.: +49 (0) 6251/16-0
Факс: +49 (0) 6251/16-2591
Эл.почта: ccontact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1.3 Общие указания к инструкции по эксплуатации

Соблюдать Инструкцию по эксплуатации

С помощью это Инструкции по эксплуатации ознакомьтесь с аппаратом, прежде чем приступать к его в эксплуатации. При этом строго соблюдайте приведенные предупреждения и правила техники безопасности.

Храните Инструкцию по эксплуатации в доступном месте на случай, если вам или другому пользователю потребуется информация из нее. Сохраните Инструкцию по эксплуатации на ПК или распечатайте.

В случае продажи проследите за тем, чтобы вместе с аппаратом была передана Инструкция по эксплуатации в бумажном или электронном виде, чтобы новый пользователь мог ознакомиться с принципом работы и содержащимися в ней предупреждениями и правилами техники безопасности.

Онлайн-портал технической документации

Для технической документации мы создали онлайн-портал www.dentsplysirona.com/manuals. Оттуда можно загрузить данную инструкцию и другие документы. Если вам требуется документ в бумажном виде, просим заполнить формуляр на сайте. После этого мы отправим Вам бесплатно печатный экземпляр.

Помощь

Если, несмотря на тщательное изучение Инструкции по эксплуатации, у Вас возникают вопросы, обратитесь в фирму по техническому снабжению стоматологических практик.

1.4 Дополнительно требуемые документы

К рентгеновской системе относятся и другие компоненты, например, ПО для ПК, которые описаны в других документах. Также следует принять во внимание инструкции и предупреждения в следующих документах:

- Руководство пользователя SIDEXIS
- Руководство пользователя GALAXIS
- Инструкция по эксплуатации компонентов ПО
- Инструкция по эксплуатации Facescan

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1.5 Гарантия и ответственность

Уход

В интересах сохранения здоровья и безопасности пациентов, пользователя и третьих лиц необходимо с установленной периодичностью проводить осмотры и техническое обслуживание, чтобы гарантировать эксплуатационную надежность, безопасность и работоспособность Вашей системы (IEC 60601-1 / DIN EN 60601-1 и т.д.).

Эксплуатирующая организация должна обеспечить проведение осмотров и технического обслуживания.

Как изготовитель электромедицинского оборудования мы (в интересах обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности работы аппарата) считаем себя ответственными за характеристики оборудования, обеспечивающие безопасность и надежность, только в том случае, если техническое обслуживание и ремонт выполняются только нами или персоналом, получившим от нас на это исключительное право, а при выходе из строя деталей, оказывающих влияние на безопасность работы аппарата, они заменяются только на оригинальные запасные части.

Исключение ответственности

Если эксплуатирующая организация не выполняет свои обязанности по проведению осмотров технического обслуживания или не уделяет внимания сообщениям о неисправностях, то фирма Sirona Dental Systems GmbH и ее дистрибьюторы не несут ответственности за причиненный в связи с этим ущерб.

Протокол выполнения работ

Мы рекомендуем вам при проведении подобных работ получить от их исполнителя свидетельство с указанием вида и объема работ, при необходимости, со сведениями об изменении номинальных параметров или рабочего диапазона, и, кроме того, с датой, сведениями о фирме-исполнителе и подписью.

1.6 Обязанности эксплуатирующей организации и персонала

Данное руководство по эксплуатации предполагает наличие опыта работы с программой Sidexis.

Перед проведением съемки спрашивайте женщин в репродуктивного возраста, не беременны ли они. В случае беременности необходимо провести оценку рисков / использования.

Для обеспечения безопасности пациентов и персонала согласно предписанию по использованию рентгеновского оборудования в Германии необходима проверка этого оборудования через предписанные промежутки времени. Sirona рекомендует ежемесячно проводить проверку.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1.7 Использование по назначению

Система GALILEOS состоит из рентгеновского аппарата, использующего циркулирующий конический рентгеновский луч. При этом для планирования и диагностики получаются двухмерные снимки и трехмерные реконструкции поверхности области головы (включая зубо-челюстно-лицевой и ЛОР-области).

Система включает в себя также пакет программных модулей, позволяющий SIDEXIS обрабатывать 3D-данные. Сюда входят 3D-реконструкция, сохранение, повторный вызов, индикация и обработка данных 3D-рентгенограмм.

Запрещается его использование во взрывоопасных помещениях.

1.8 Показания и противопоказания

Показание по разделам:

- Консервирующая стоматология
- Эндодонтия
- Пародонтология
- Стоматологическое протезирование
- Функциональная диагностика и терапия ВНЧ дисфункций
- Хирургическая стоматология
- Имплантология
- Ротовая, челюстная и лицевая хирургия
- Челюстная ортопедия
- Отоларингология (среднее и внутреннее ухо, придаточные пазухи носа, главная полость носа, гайморова полость, клетки решетчатой кости, основная пазуха, переднее основание черепа, лобная пазуха)

Противопоказания:

- Диагностика кариеса, в частности, аппроксимальных поражений
- Отображение хрящевых структур
- Отображение мягких тканей рентгеном

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1.9 Структура документа

1.9.1 Обозначения степени опасности

Во избежание травм людей и материального ущерба строго соблюдайте приведенные в данной инструкции по эксплуатации предупреждающие указания и указания по технике безопасности. Для них предусмотрены специальные условные обозначения:

⚠ ОПАСНОСТЬ

Прямая и явная опасность, которая может привести к тяжелым травмам или смерти человека.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциально опасная ситуация, которая может привести к тяжелым травмам или смерти.

⚠ ОСТОРОЖНО

Потенциально опасная ситуация, которая может привести к незначительным травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ

Потенциально аварийная ситуация, в которой возможны повреждения изделия или имущества в его окружении.

ВАЖНО

Практические рекомендации и прочая полезная информация.

Совет: информация для облегчения работы.

1.9.2 Используемое форматирование и символы

Символы и шрифты, использованные в данном документе, имеют следующее значение:

✓ Обязательное условие **1.** Первая рабочая операция **2.** Вторая рабочая операция или ➢ Альтернативное действие ↳ Результат ➢ Отдельная рабочая операция	Требует выполнения определенной операции.
см. «Используемое форматирование и символы [→ 10]»	Обозначает ссылку на другое место в тексте с указанием номера страницы.
• Перечисление	Обозначает перечисление.
„Команда / Пункт меню“	Обозначает команды / пункты меню или цитату.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

2 Указания по технике безопасности

2.1 Указания на аппарате

На аппарате присутствуют следующие символы:

Сопроводительные документы



Эта пиктограмма находится рядом с заводской табличкой аппарата.

Значение: При эксплуатации устройства соблюдайте Инструкцию по эксплуатации.



Эта пиктограмма находится на заводской табличке устройства.

Значение: Сопроводительная документация находится на сайте производителя.

Электростатический заряд (ESD)



Запрещается касаться штифтов или гнезд штекеров, оснащенных предупреждающей табличкой об электростатическом разряде, без применения мер по предотвращению электростатического разряда, а также выполнять соединения между подобными штекерами. См. также раздел „Электростатический разряд“ и „Электромагнитная совместимость“.

Обозначение одноразовых изделий




Перед каждой съемкой установить гигиенические защитные чехлы (одноразовое изделие).

Одноразовые изделия помечены символом, показанным слева. Сразу после использования их следует утилизировать. Не используйте одноразовые изделия повторно!

2.2 Вентиляционные щели

Категорически запрещается перекрывать вентиляционные щели аппарата, так как в противном случае затрудняется циркуляция воздуха. Это может привести к перегреву аппарата.

Не распылять аэрозоли в вентиляционные щели



Не допускать попадания жидкостей, например, дезинфицирующих средств, в вентиляционные щели. Это может привести к неисправностям. В зоне вентиляционных щелей применяйте только дезинфекцию протиранием.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

2.3 Образование конденсата

После значительных колебаний температуры на аппарате возможно образование конденсата. Включать аппарат следует лишь после того, как он достигнет комнатной температуры. См. также главу Технические характеристики.

2.4 Квалификация обслуживающего персонала

Аппарат разрешается эксплуатировать только обученному и проинструктированному персоналу.

Персонал, которому требуется обучение, подготовка, инструктаж, или проходящие практику студенты должны работать на аппарате исключительно под постоянным наблюдением опытного специалиста.

Для работы на аппарате обслуживающий персонал обязан:

- прочитать и усвоить Инструкцию по эксплуатации;
- разбираться в конструкции и функциях аппарата;
- быть в состоянии распознавать неисправности в работе аппарата и при необходимости принимать соответствующие меры

2.5 Включение аппарата

При включении аппарата присутствие в нём пациента запрещено. В случае сбоя в его работе пациент может получить травмы.

Если возникает неисправность, требующая отключения и повторного включения аппарата, пациент должен быть выведен из аппарата до повторного включения.

2.6 Защита от излучения

Соблюдайте действующие нормы и меры защиты от излучения. Использовать предписанные средства радиационной защиты. Чтобы снизить лучевую нагрузку, Sirona рекомендует использовать висмутовые, свинцовые экраны или фартуки, в частности, при педиатрических обследованиях.

Оператор во время съёмки должен находиться на максимальном расстоянии от рентгеновского излучателя, которое позволяет спиральный кабель.

За исключением пациента, другим лицам запрещается находиться в помещении без средств радиационной защиты. При создании снимков может оказывать помощь третий человек, но не из числа сотрудников практики. Во время съёмки визуальный контакт с пациентом и аппаратом обязателен.

В случае сбоев при съемке немедленно прервать ее, отпустив спусковую кнопку.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

2.7 Аварийный останов

Если части аппарата при вращательном движении касаются пациента, немедленно отпустите кнопку включения рентгеновского излучения или остановите аппарат главным выключателем или одним из аварийных выключателей аппарата (не входит в объем поставки)!

2.8 Лазерный световой прицел



Аппарат оснащен лазером класса 1.

Световые прицелы служат для правильной настройки положения пациента. Запрещается использовать их для иных целей.

Необходимо соблюдать расстояние не менее 10 см (4“) между глазами и лазером. Не смотреть на луч.

Разрешается включать лазерные прицелы только в том случае, если они работают без помех. Ремонтные работы разрешается выполнять только авторизованному персоналу.

Не пользуйтесь другим лазером и не вносите изменений в настройки и процессы, не описанные в настоящей Инструкции. Это может привести к опасной лучевой нагрузке.

2.9 Гигиена

Для каждого пациента должны быть установлены новые чехлы, все вспомогательные средства съемки должны быть дезинфицированы, чтобы исключить вероятность передачи возбудителей инфекции, которые, при известных обстоятельствах, могут вызывать серьезные заболевания.

Путем принятия соответствующих гигиенических мер предотвращать перекрестное заражение между пациентами, обслуживающим персоналом и иными лицами.

Дополнительная информация по стерилизации и гигиеническим чехлам содержится в главах «Гигиенические защитные чехлы [→34]», «Подготовка к рентгенографии [→40]», «Стерилизация [→66]».

2.10 Сенсорный экран

Экран панели Easypad оснащён технологией управления, чувствительной к прикосновениям.

При работе с сенсорным экраном запрещается пользоваться острыми предметами, например, ручками, карандашами и т.д. Это может повредить его или поцарапать поверхность. Управляйте сенсорным экраном только лёгкими нажатиями кончиков пальцев.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

2.11 Бесперебойная работа

Использование данного аппарата допустимо, только если аппарат исправен. Если гарантировать бесперебойную работу аппарата невозможно, его эксплуатацию следует прекратить. Его должны проверить и при необходимости отремонтировать авторизованные специалисты.

Снимки разрешается делать только в случае полной исправности аппарата.

Части тела, а также одежда, повязки, инвалидные коляски и кровати не должны мешать движениям аппарата.

Диапазон движений аппарата должен быть свободен от посторонних предметов.

Не оставлять пациента у аппарата без присмотра.

Аппарат должен эксплуатироваться только с полной обшивкой и защитным кожухом.

2.12 Неисправность электронных приборов

Во избежание выхода из строя электронных приборов и носителей информации их необходимо снять перед выполнением рентгенографии.

2.13 Риски, создаваемые электромагнитными полями

На работоспособность имплантированных систем (например, кардиостимуляторов или кохлеарных имплантатов) могут повлиять электромагнитные поля. Перед началом процедуры спрашивайте у пациентов о наличии имплантированного кардиостимулятора или других подобных систем.
При наличии подобных рисков они указаны в документации производителя имплантата.

2.14 Комбинирование с другими приборами

Лицо, которое путем комбинирования с другим оборудованием составляет или изменяет медицинскую электрическую систему согласно стандарту IEC 60601-1 (Положения по безопасности эксплуатации медицинских электрических систем), несет ответственность за то, чтобы в полном объеме выполнялись требования данного стандарта, касающиеся безопасности пациентов, обслуживающего персонала и окружающей среды.

Если подключаются устройства, не получившие разрешения компании Sirona, они должны соответствовать действующим нормам:

- IEC 60950-1 или IEC 62368-1 для устройств обработки данных, а также
- IEC 60601-1 для медицинских устройств

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

См. также "Условия для монтажа" и список совместимости / Заявление о соответствии стандартам, предоставляемые системным интегратором.

При возникновении сомнений обращайтесь к производителю компонентов системы.

2.15 Изменения аппарата

Изменения в этом устройстве, которые могут повлиять на безопасность пользователя, пациента или третьих лиц, согласно законодательству категорически запрещены!

Для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности данное изделие разрешается эксплуатировать только с оригинальными принадлежностями производства компании Sirona или иных изготовителей, допущенных компанией Sirona. Всю ответственность за использование не допущенных принадлежностей несет пользователь.

2.16 Строительные изменения

При проведении строительных или ремонтных работ вблизи рентгеновской установки, которые могут привести к серьезным сотрясениям и даже ударам по аппарату, сервисному технику следует проверить аппарат и при необходимости провести его повторную юстировку и калибровку.

2.17 Электромагнитная совместимость

Рентгеновская установка GALILEOS Comfort PLUS соответствует требованиям стандарта IEC 60601-1-2.

Медицинское электрооборудование требует принятия особых мер предосторожности в отношении ЭМС. Они должны устанавливаться и эксплуатироваться согласно указаниям, приведенным в документе "Условия проведения монтажа".

Если в радиусе 5 м от аппарата находятся силовые электроустановки, установки направленной радиосвязи или установки MRT, соблюдайте требования, указанные в Условиях проведения монтажа.

Переносные и мобильные средства ВЧ связи могут влиять на медицинское электрооборудование. Необходимо запретить пользование радиотелефонами на территории клиник и врачебных практик.

Соблюдайте также меры по предотвращению электростатического заряда, приведенные в главе „Электростатический разряд“.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

2.18 Электростатический разряд (ЭСР)


2.18.1 Меры по предотвращению ЭСР

ЭСР

ESD - это сокращение от **E**lectro**S**tatic **D**ischarge (электростатический разряд).

Меры по предотвращению ЭСР

Меры по предотвращению электростатического разряда (ЭСР) включают в себя:

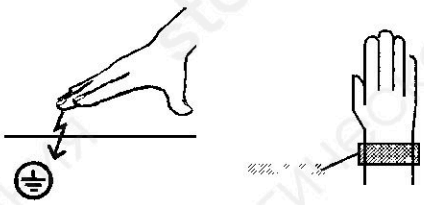

- Методы, снижающие вероятность электростатического заряда (например, путем кондиционирования и увлажнения воздуха, использования электропроводящих напольных покрытий, ношения одежды из несинтетических материалов)
- разряд собственного тела на раму аппарата, на защитный провод или крупные металлические предметы
- собственный контакт с землей с помощью заземляющего браслета.

Обучение

Мы рекомендуем обратить особое внимание на данную предупреждающую табличку всех лиц, работающих с аппаратом, и провести семинар по физике электростатических зарядов, которые могут возникать в практике, и по разрушениям электронных элементов, которые могут возникать из-за прикосновения электростатически заряженным ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.


Содержание семинара можно установить на основании раздела "О физике электростатического заряда" [→ 16].

2.18.2 О физике электростатического заряда

Что такое электростатический заряд?

Электростатический заряд - это поле напряжения на или в каком-либо объекте (например, человеческом теле), защищенное от отвода к потенциалу "земли" непроводящим слоем (например, подошвой обуви).

Возникновение электростатического заряда



Электрические заряды возникают всегда в тех случаях, когда два тела перемещаются относительно друг друга, например, при ходьбе (подошвы обуви относительно пола) или при езде (шины относительно дороги).

Сила заряда

Величина заряда зависит от различных факторов:

Так, например, заряд при низкой влажности воздуха выше, чем при высокой; для синтетических материалов больше, чем для натуральных (одежда, напольные покрытия).

Разряд предполагает предшествующий заряд.

Для того, чтобы получить понятие о величине уравновешивающихся при электростатическом разряде напряжений, можно использовать следующее эмпирическое правило.

Электростатический разряд от:

- 3000 В можно почувствовать;

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


- 5000 В можно услышать (щелчки, треск);
- 10000 В можно увидеть (искровое перекрытие)

Сила протекающего при подобном разряде неустановившегося тока составляет около 10 ампер. Такой ток безвреден для людей, т. к. его длительность составляет лишь наносекунды.

Фон

Для реализации различных функций стоматологического / рентгеновского / CAD/CAM-аппарата применяются интегральные схемы (логические схемы, микропроцессоры).

Для того, чтобы на этих чипах можно было разместить как ожно больше функций, эти схемы должны быть сильно миниатюризированы. Это ведет к созданию слоев толщиной несколько десятитысячных миллиметра.



Легко понятно, что интегральные схемы, которые соединены с ведущими наружу штекерами, чувствительны к электростатическим разрядам.

Даже напряжения, которые не чувствует пользователь, могут приводить к пробою слоев, а вызываемый этим ток расплавляет соответствующие части чипа. Повреждение отдельных интегральных схем может приводить к неисправностям или отказу аппарата.



Для предотвращения этой опасности предупреждающая табличка об ESD обращает Ваше внимание на этот факт. ESD - это сокращение от **E**lectro**S**tatic **D**ischarge (электростатический разряд).

Запрещается касаться штифтов или гнезд штекеров, оснащенных предупреждающей табличкой об электростатическом разряде, без применения мер по предотвращению электростатического разряда, а также выполнять соединения между подобными штекерами.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


3 Техническое описание

3.1 Технические характеристики

Шасси:	Наименование модели	GALILEOS Comfort PLUS
	Номинальное напряжение:	200 В – 240 В
	Допустимые колебания:	±10%
	Допустимое падение под нагрузкой:	10%
	Номинальный ток:	6 А
	Номинальная мощность:	0,6 кВт при 98 кВ/6 мА
	Произведение Ток-Время:	30 мАс
	Номинальная частота:	50 Гц / 60 Гц
	Номинальное внутреннее сопротивление:	макс. 0,8 Ом
	Предохранитель домовой проводки:	25А инерционный (16 А при одиночном присоединении)
	Потребляемая мощность:	0,9 кВа
Излучатель:	Размер фокального пятна согласно IEC 60336, измеренный в центральном луче:	0,5 мм
	кВ:	98 кВ
	мА:	3 мА - 6 мА
	импульсный режим:	10 мс – 14 мс
	мин. постоянная фильтрация:	2,8 мм ал. / 98 IEC 60522
	мин. Слой половинного ослабления:	3,9 мм ал.
	Встроенный фильтр:	0,2 мм Cu
	Угол конусного луча:	ограничен до 24°
	Частота высокого напряжения:	80 кГц – 100 кГц
Детектор:	Тип: усилитель изображения (BV), Siemens	
	активный размер входного окна:	Диаметр 215 мм (8 1/2“)
	Камера:	Пиксель: 1000^2
		К/с: 15 – 30
		Динамические параметры: 12 бит, (яркость 4096), 63 дБ
Геометрия:	Расстояние Фокус – УИ - Преобразующий слой (центральный луч)	590 мм (23 1/4“)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

	Расстояние Фокус – Изоцентр (центральный луч)	413 мм (16 1/4“)
	Расстояние Фокус – Кожа (минимальное расстояние)	ок. 300 мм (11 13/16“)
Процедура сканирования:	Угол прохода	204°
	Время сканирования	ок. 14 с
	Число одиночных рентгенограмм	200 Режим HD 357
Реконструкция:		
	Метка фокального пятна:	
	Автоматическая блокировка рентгенографии:	Длительность блокировки рентгенографии (фазы охлаждения) зависит от установленной ступени кВ/мА и действительной длительности излучения. В зависимости от нагрузки на трубку, автоматически устанавливается время паузы от 8 с до 300 с.
	Аппарат класса защиты:	IPX0
	Аппарат класса защиты I Степень защиты от поражения электрическим током:	Тип аппарата B 
	Степень защиты от попадания воды:	Обычный аппарат (без защиты от попадания воды)
	Год изготовления:	 **20XX** (на заводской табличке)
	Режим работы:	Длительная эксплуатация
	Длительная мощность:	100 Вт
	Материал анода:	Вольфрам
	Параметры рентгенографии для определения паразитного излучения:	6 мА / 98 кВ
	Длительный ток для измерения паразитного излучения:	0,14 мА
	Температура транспортировки и хранения:	
	Основной аппарат	-40° C – +70° C (-40°F – 158°F)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


	Детектор	-30° C – +55° C (-22°F – 131°F)
	Влажность воздуха:	10% – 95% без конденсации
	Допустимая рабочая температура:	от +10°C до +35°C (50°F – 95°F) При температуре в помещении > 35°C (> 95°F) Sirona рекомендует использовать кондиционер.
	Высота эксплуатации:	≤ 3000 м
Рентгеновская трубка:	Siemens SR 120/15/60	
Минимальные требования к ПК реконструкции (содержится в комплекте поставки):	Процессор:	QuadCore Intel i5
	ОЗУ:	8 Гбайт ОЗУ
	Жёсткие диски:	1 Тбайт
	Операционная система:	Windows 7, 64-битная (обязательно)
	Внешний дисковод:	1 пишущий DVD-дисковод, двухслойный
	Графическая карта:	внешняя (не встроенная), мин. 1 Гбайт ОЗУ
Минимальные требования к ПК для визуализации SIDEXIS (не входит в комплект поставки):	см. Руководство пользователя SIDEXIS Системные требования приведены на сайте www.sidexis.com	
Сеть:	Сеть:	Ethernet 100 Мбит, рекомендуется Ethernet 1 Гбит
	Интерфейс связи:	RJ45 для LAN-кабеля

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

3.2 Диаграммы


Кривая охлаждения для корпуса излучателя

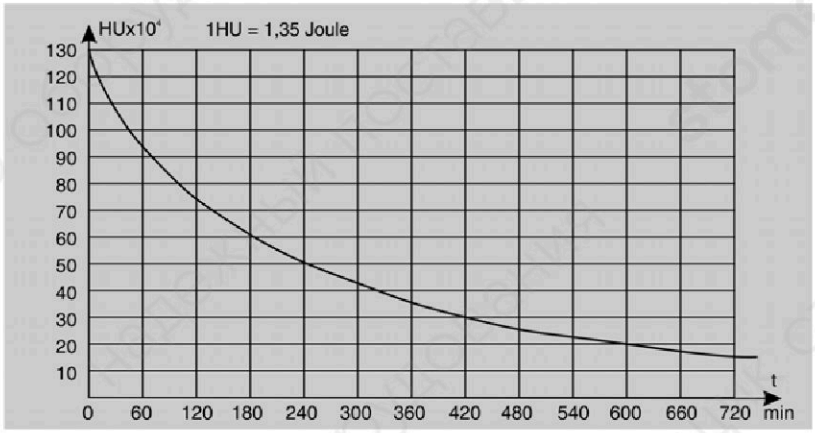

Кривая охлаждения рентгеновской трубки

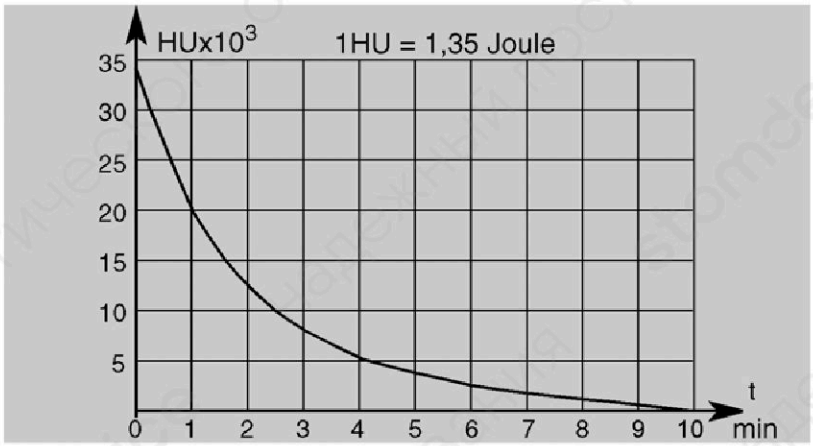


Кривая нагрева для корпуса излучателя

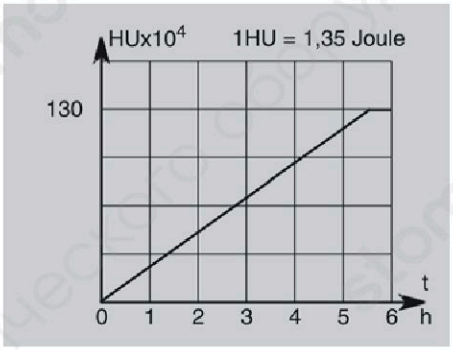


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Центральный луч

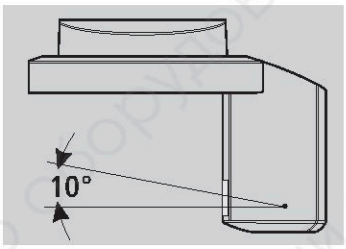

Угол наклона анода

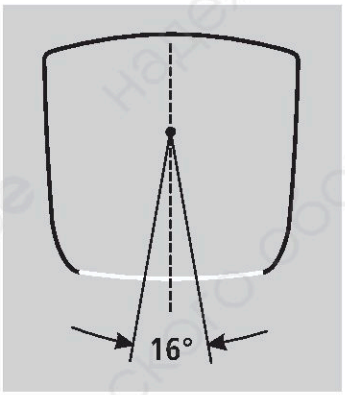


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3.3 Значения вторичного рассеянного излучения

Значения вторичного рассеянного излучения

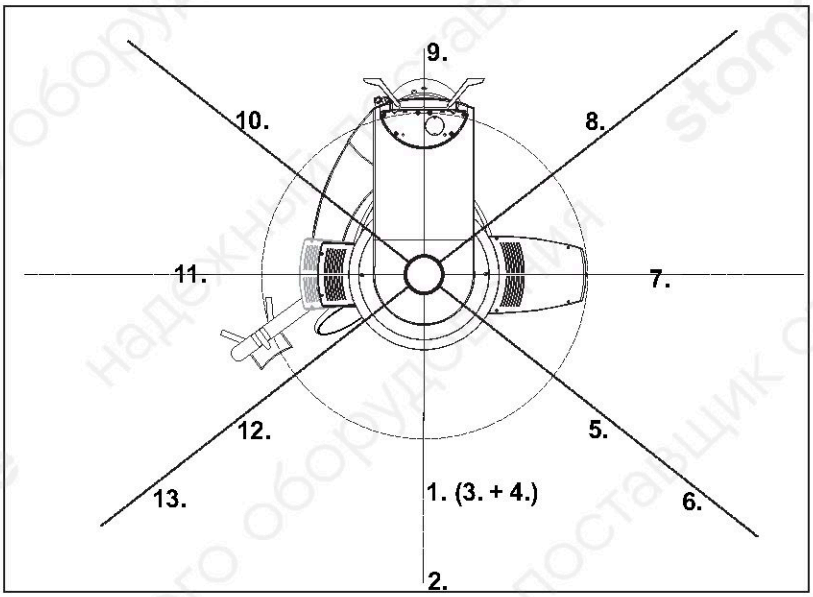

Для измерений рассеянного излучения устанавливаются следующие параметры:
Напряжение на трубке 98 кВ,
ток на трубке 6 мА,
время излучения 5,1 с (соответствует произведению тока на время 30,6 мАс).

Угол [°]	Точка измерения	Расстояние [м]	Измеренная доза [мкЗв]	Доза/мАс [мкЗв]
0	1	1	3,46	0,113
	2	2	0,96	0,0314
	3	1 (45° снизу)	2,91	0,0951
	4	1 (45° сверху)	1,14	0,0372
45	5	1	4,09	0,114
	6	2	1,16	0,0379
90	7	1	4,89	0,160
135	8	1	6,07	0,198
180	9	1	0,45	0,0148
225	10	1	5,64	0,184
270	11	1	4,81	0,157
315	12	1	3,92	0,128
315	13	2	1,09	0,0356

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3.4 Сертификация и регистрация

Рентгеновская установка **GALILEOS** соответствует стандарту IEC 60601-1:2005 + A1:2012

Рентгеновская установка **GALILEOS** соответствует стандарту IEC 60601-1-3:2008 + A1:2013

Рентгеновская установка **GALILEOS** соответствует стандарту IEC 60601-2-63:2012

Язык оригинала: Немецкий

CE
0123


Это изделие имеет знак CE в соответствии с положениями директивы 93/42EWG от 14 июня 1993 г. об изделиях медицинской техники.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4 Органы управления и функционирования

4.1 Органы управления и индикации на GALILEOS

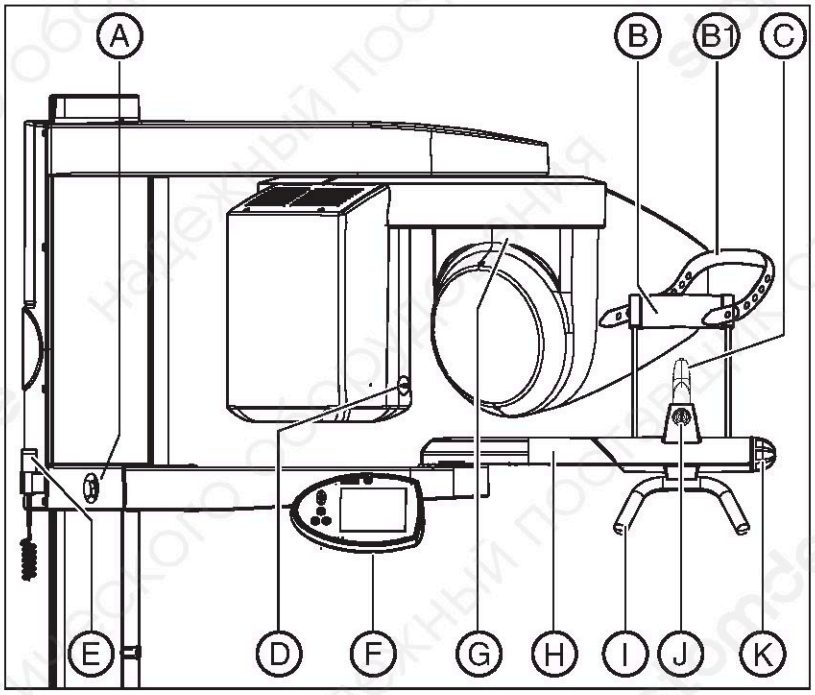


A	Главный выключатель
B	Опора для лба (мягкая обивка снимается)
B1	Фиксирующая лента для головы
C	Накусочная пластина (стерилизуется)
D	Ручка для механической регулировки диафрагмы
E	Включатель [1]
F	Easypad (поворотная панель управления)
G	Световой прицел центрального лазерного луча для середины лица
H	Поворотная консоль для фиксации пациента
I	Ручки для пациента
J	Поворотная ручка для фиксации накусочной пластины
K	Поворотная ручка для блокировки поворотной консоли и регулировки опоры для лба

[1] При установке системы с дистанционным пусковым устройством (ДПУ) спусковая кнопка установлена на ДПУ.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4.2 Органы управления и индикации на фиксаторе головы

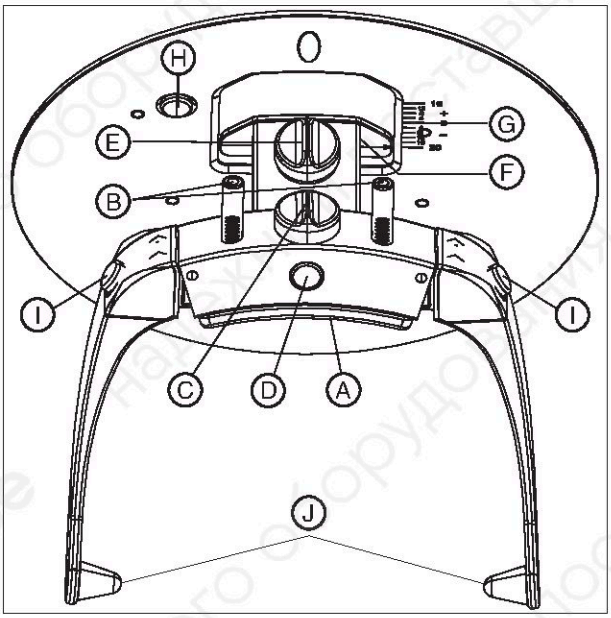


A	Обивка для лобного упора в исполнении для взрослого или ребенка
B	Регулировка лобного упора
C	Регулировка головной дуги
D	Кнопка Возврат лобного упора
E	Стопорение для вертикального перемещения
F	Шкала вертикального перемещения (диапазон перемещения +/- 10 мм)
G	Шкала горизонтального перемещения (диапазон перемещения +16 мм / -20 мм)
H	Фиксаторная кнопка для горизонтального перемещения и разблокировка для снятия фиксатора головы
I	Фиксаторные кнопки для головной дуги
J	Ушные вкладыши

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4.3 Органы управления и индикаторы на Easypad с сенсорным экраном

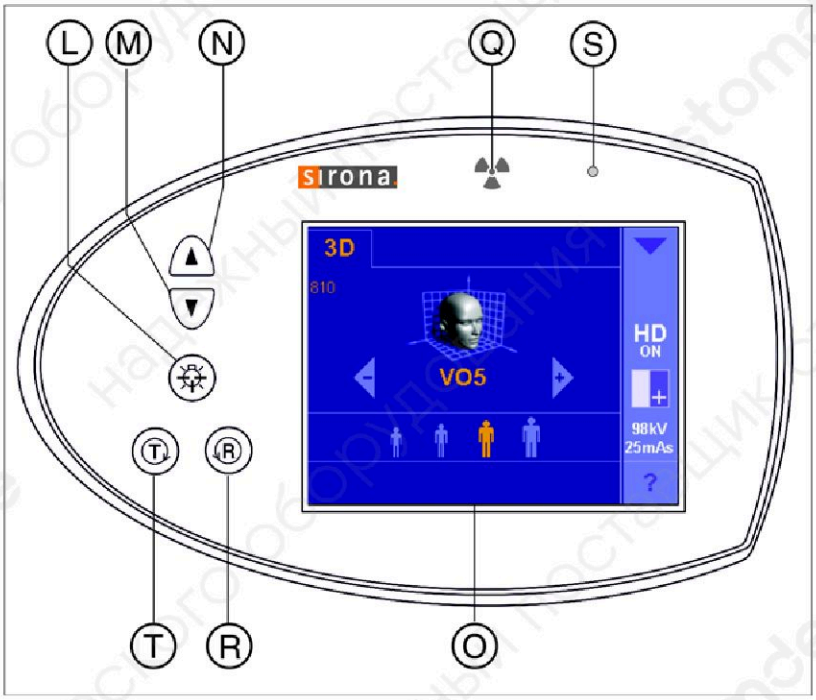

L	Световой прицел ВКЛ./ВЫКЛ
M	Кнопка "Аппарат движется вниз"
N	Кнопка "Аппарат движется вверх"
O	Сенсорный экран - экран, чувствительный к прикосновениям
Q	Оптический индикатор излучения
R	Кнопка "R" для возврата аппарата
S	Индикатор "Аппарат ВКЛ"
T	Кнопка "T" для тестового прохода без излучения


4.4 Общие функции сенсорного экрана на панели Easypad

Touchscreen = сенсорный экран, т.е. при касании поверхности экрана активируются различные функции.

Цветное представление:	
оранжевый	выбран
белый	предустановки
голубой	доступен для выбора
светло-серый	Символы справки

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

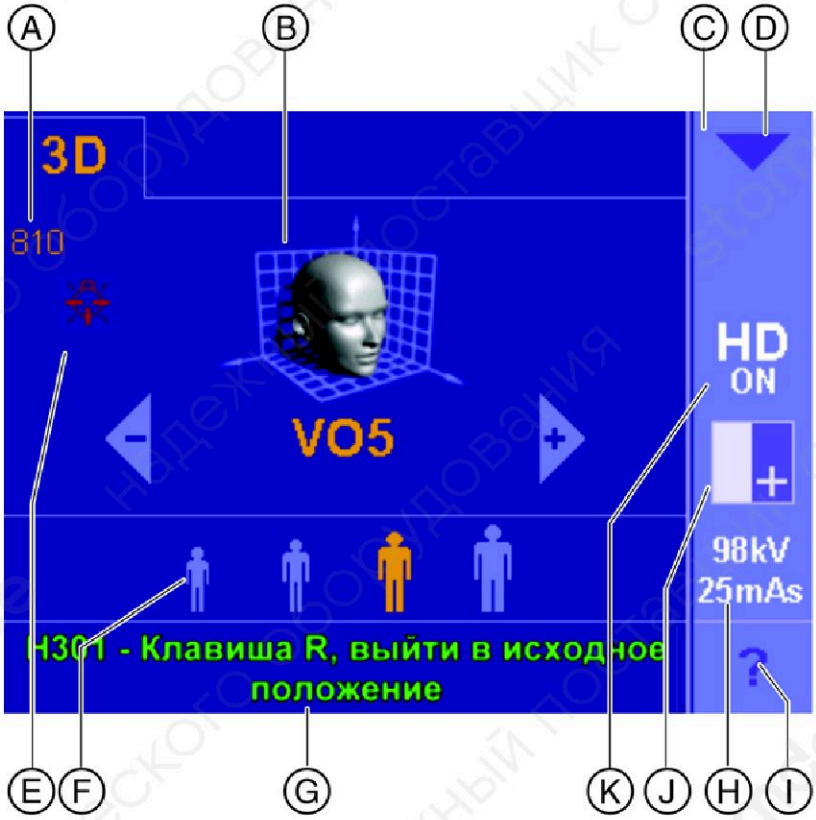

Представления на сенсорном экране	
A	Индикация регулировки по высоте
B	Индикация программы VO5 или VOG Контрастность символа изменяется в зависимости от выбранной контрастности.
C	Столбец Подменю (опции)
D	Синие стрелки: выбрать подменю, закрыть меню
E	Красный индикатор Световой прицел ВКЛ (появляется, пока включено лазерное излучение светового прицела)
F	Кнопки пиктограмм пациента для выбора предустановленных параметров рентгенографии
G	Строка комментариев для справочных сообщений и ошибок
H	Индикация/Настройка параметров рентгенографии (кВ/мАс)
I	После касания **?** появляется экран справки или информации
J	Индикация/Настройка опции Высокая контрастность
K	Индикация / настройка режима HD (High-Definition - высокой четкости)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4.4.1 Настройки программы (Уровень 2)



Вы можете на 2 уровне также полностью показать программные настройки и выбрать нужные настройки.

Для попадания на уровень 2 коснитесь синей стрелки (D) в правом верхнем углу сенсорного экрана: после этого она будет указывать вверх.

После выбора можно снова вернуться на уровень 1 только касанием синей стрелки (D).

4.4.2 Меню "Настройки запуска" (Уровень 4)



На уровне 4 можно перепрограммировать различные стартовые параметры, заданные на заводе-изготовителе. Затем они появляются после каждого включения аппарата или каждой новой рентгенограммы.


Для перехода на уровень 4 нужно сначала выбрать уровен ◆◆ 3.

Для попадания на 3 уровень коснитесь синей стрелки в правом верхнем углу сенсорного экрана: после этого она указывает вверх.

На уровень 4 можно перейти, коснувшись пиктограммы дискеты (N) на уровне 3.

На уровне 4 можно перепрограммировать начальное или входное положение (в заводской настройке - левая пиктограмма) и предустановка пиктограммы пациента (в заводской настройке - 3-я пиктограмма слева).

С помощью этой функции можно настроить входное положение пациента в аппарате в соответствии с условиями на месте. Отверстие в кольце на пиктограммах показывает входное направление для пациента. Можно выбрать положение спереди, сбоку справа и сзади справа.

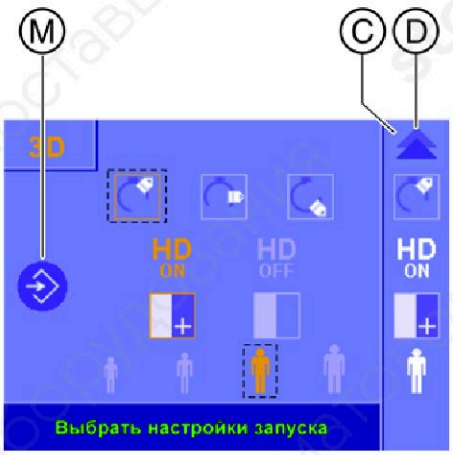

Для соответствующего перепрограммирования коснитесь нужной пиктограммы, она изменит свой цвет на оранжевый и появится в столбце Подменю (D).

При этом пиктограмма памяти (M) отображается жёлтым цветом, пока новая предустановка не будет сохранена касанием пиктограммы памяти (M).

Это меню можно снова закрыть касанием синей двойной стрелки (D) в правом верхнем углу. Индикация всегда возвращается в стандартное меню (уровень 1).


Пиктограммы, обрамленные штриховыми рамками, обозначают заводские настройки.

Если программа была изменена, она сохраняется до тех пор, пока в этом режиме не будут внесены новые изменения.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4.4.3 Меню Сервис

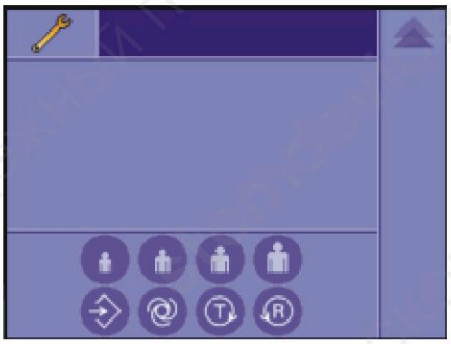


Меню Сервис предусмотрено только для сервисных техников.

Сервисный техник может перейти в меню Сервис из меню Базовые настройки (уровень 3) касанием пиктограммы "Гаечный ключ" (O) и с помощью специального алгоритма ввода.

Дополнительную информацию по вызову меню Сервис, а также информации по сервисным подпрограммам сервисный техник может найти в Сервисном руководстве.

4.4.4 Настройки сенсорного экрана

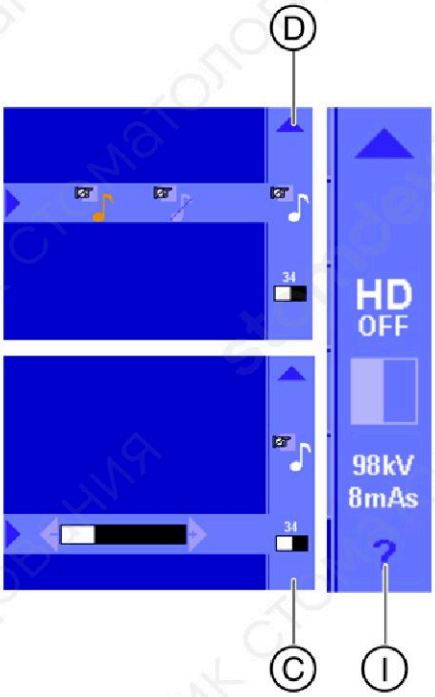

После касания пиктограммы "Вопросительнй знак" (i) в правом нижнем углу сенсорной панели появится меню "Настройка сенсорного экрана".

Щелчком по соответствующей пиктограмме в столбце (C) здесь можно вызвать две строки меню.

В верхней строке меню путем активирования пиктограммы перечеркнутой ноты можно отключать звуковой сигнал касания сенсорного экрана.

В нижней строке меню кнопками –/+ можно отрегулировать интенсивность индикации на сенсорном экране. При этом над пиктограммой в столбце (C) появляется базовое значение.

ВАЖНО

Чтобы изменить настройку яркости сенсорного экрана, аппарат должен быть включен уже не менее 10 минут, чтобы сенсорный экран достиг своей полной яркости. До этого момента настройка контрастности заблокирована (обозначается в виде песочных часов на пиктограмме контрастности).

Чтобы закрыть соответствующую строку меню, коснитесь синей стрелки в левом конце строки или соответствующей пиктограммы в столбце (C).

Касанием синей стрелки (D) в верхней части столбца (C) вы возвращаетесь на предыдущий уровень.


4.4.5 Закрытие строк меню

- путем касания синих стрелок
- касанием соответствующей пиктограммы в голубом поле у правого края.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4.4.6 Информационный экран

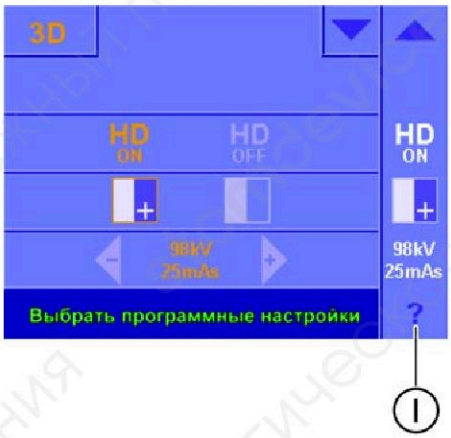


Начиная с уровня 2, после касания символа "вопросительный знак" (I) в правом нижнем углу сенсорной панели появляется информационный кадр "**Конфигурация GALILEOS**".

Здесь приведены характеристики аппарата, важные при диалоге с сервисным техником.

Если сисок большой, справа появляется линейка прокрутки, с помощью которой Вы можете прокручивать список.


И здесь можно вызвать обе строки меню "Звук касания экрана" или "Регулировка яркости экрана" в справочном экране в столбце (C).

Проверка активации функций

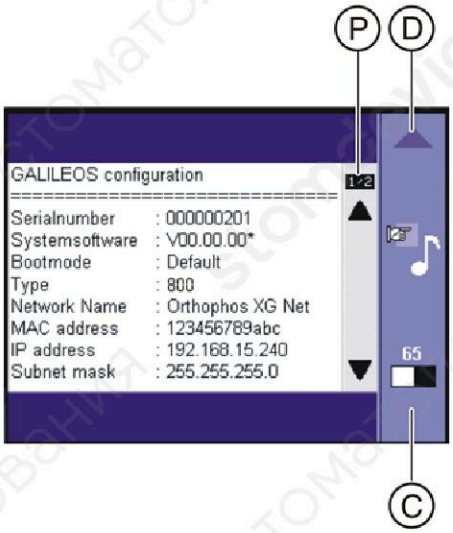

В верхнем правом углу информационного экрана в небольшом черном поле (P) отображается номер страницы и количество страниц.

При нажатии на это поле Вы можете пролистать страницы, пока не попадете на страницу "Active Keys".

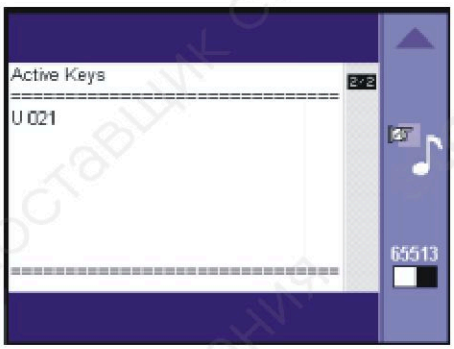

Здесь отображается информация о активации функций.

Касанием синей стрелки (D) в верхней части столбца (C) вы возвращаетесь на предыдущий уровень.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

5 Принадлежности

Прочитайте также главу: „Очистка и уход“

5.1 Накусочные пластины, опоры и фиксаторы

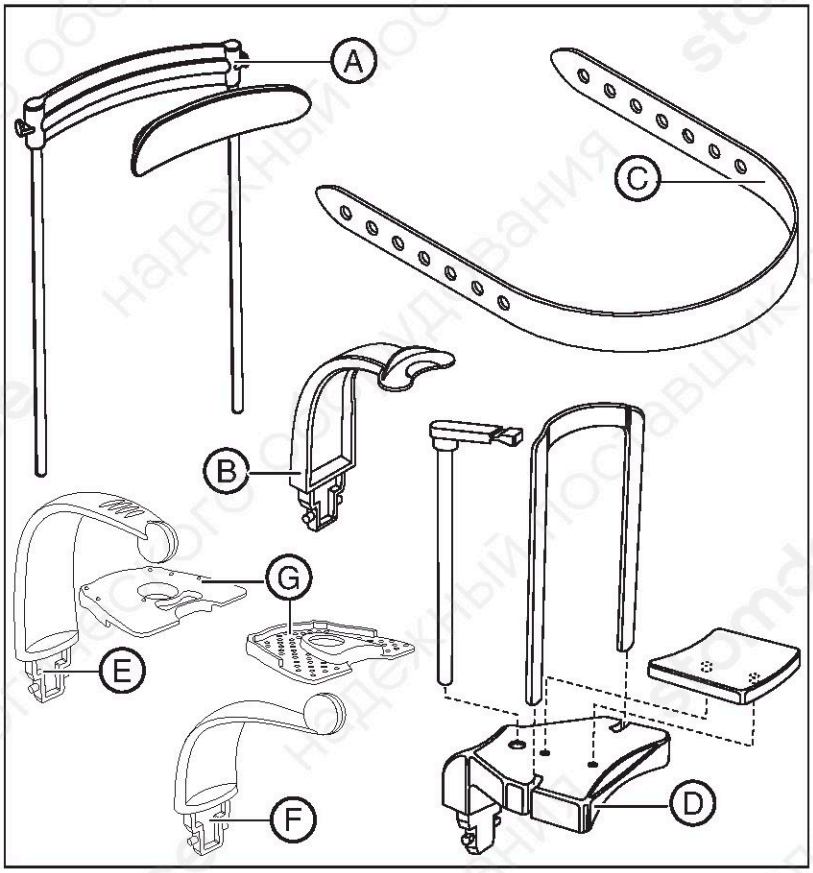


A	Опора для лба (мягкая обивка может сниматься для очистки и дезинфекции) (1 шт.) Заказной № 61 34 931
B	Жёсткая накусочная пластина (может сниматься для очистки и дезинфекции вращением фиксирующей ручки), (5 шт.) Заказной № 61 34 949
C	Фиксирующая лента для головы (2 шт.) Заказной № 61 34 956
D	Опора подбородка в сборе (1 шт.) Заказной № 59 81 472
E	Держатель накусочной пластины Нижняя челюсть (с пиктограммой для НЧ) (1 шт.) Заказной № 61 50 226

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

F	Держатель накусочной пластины Верхняя челюсть (с пиктограммой для ВЧ) (1 шт.) Заказной № 61 50 218
G	Шариковая накусочная пластина - Только для однократного использования (не стерилизуется) - Можно купить в специализированных магазинах.

5.2 Принадлежности к фиксатору головы

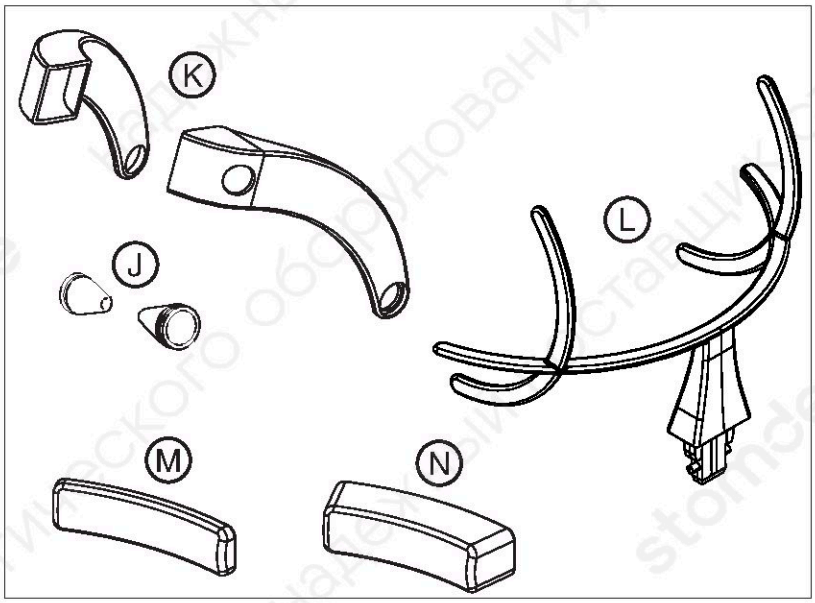

J	Ушные вкладыши (10 шт.) Заказной № 18 88 838
K	Головные дуги (справа и слева) Головные дуги могут быть сняты для чистки нажатием на соответствующую фиксаторную кнопку. (2 шт.) Номер для заказа 62 27 040
L	Регулятор объёма (1 шт.) Заказ. № 62 26 976
M	Обивка лобного упора (мягкая обивка может сниматься для очистки и дезинфекции) (5 шт.) Заказной № 62 27 057
N	Обивка лобного упора Plus (вид) (мягкая обивка может сниматься для очистки и дезинфекции) (5 шт.) Заказной № 62 27 065

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

5.3 Гигиенические защитные чехлы


Обозначение одноразовых изделий



Перед каждой съемкой установить гигиенические защитные чехлы (одноразовое изделие).

Одноразовые изделия помечены символом, показанным слева. Сразу после использования их следует утилизировать. Не используйте одноразовые изделия повторно!

5.3.1 Гигиенические защитные чехлы для накусочных пластин, опор и фиксаторов

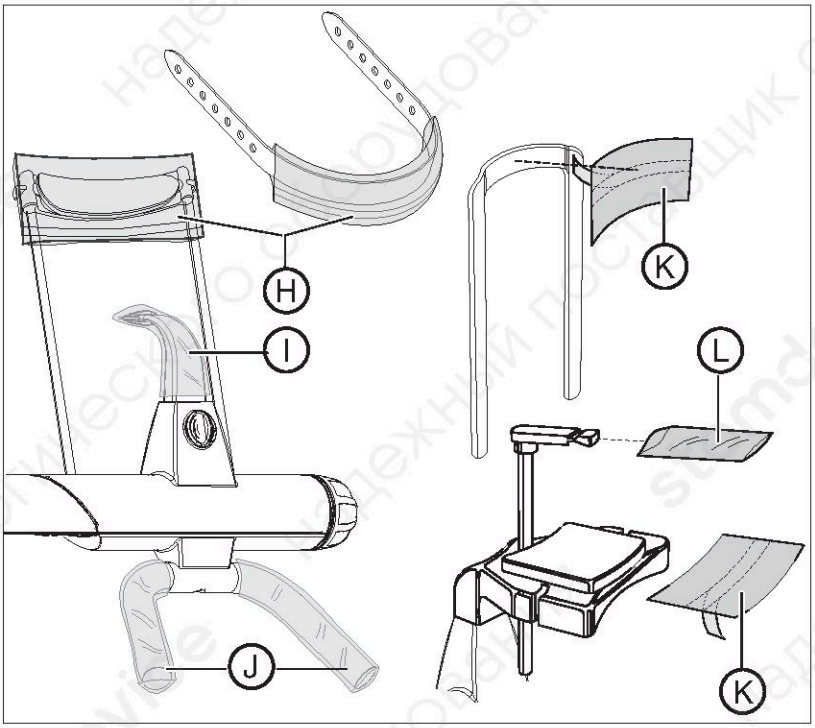


H	Гигиенические защитные чехлы для опоры для лба и фиксирующей ленты для головы (100 шт.) Заказной № 61 84 894
I	Гигиенические защитные чехлы для накусочной пластины (500 шт.) Заказной № 61 27 745
J	Гигиенические защитные чехлы для ручек (500 шт.) Заказной № 61 84 902
K	Гигиенические защитные чехлы для опоры подбородка и скобы (100 шт.) Заказной № 59 32 603
L	Гигиенические защитные чехлы для опоры подбородка (500 шт.) Заказной № 33 14 072

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

5.3.2 Гигиенические защитные чехлы для фиксатора головы

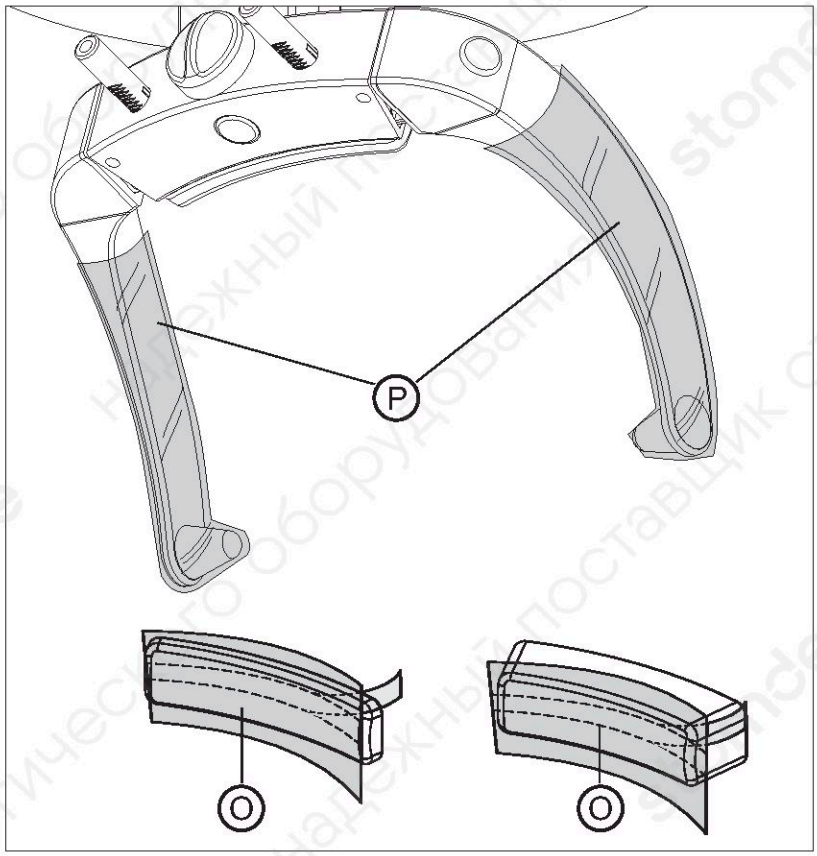


O	Гигиенические защитные чехлы для лобной подушки (100 шт.) Заказной № 62 34 392 Размеры 75 x 60 мм
P	Гигиенические защитные чехлы для головной дуги (500 шт.) Заказной № 62 34 400 Размеры 150 x 47 мм

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

5.4 Опытный образец для контроля съёмки/ стабильности параметров

Испытательная модель в разных странах

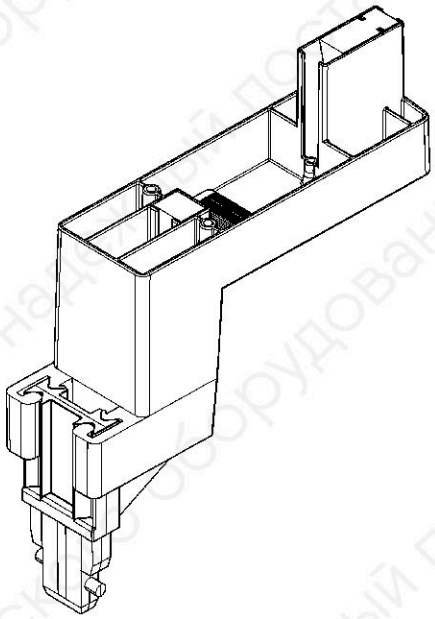

Испытательная модель, замена


(1 шт.) Номер для заказа 61 40 813

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

6 Программы

6.1 VO5: стандартная программа объема

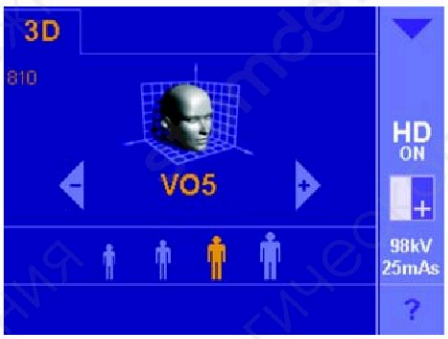


Сканирование высокого разрешения с возможностью создания вторичных реконструкций (детальная реконструкция) с высочайшим разрешением.

С помощью этой программы создаётся набор объёмных данных пациента с 616 x 616 x 616 объёмными элементами (вокселями).

Разрешение в объёме (размер вокселя) составляет 0,25 x 0,25 x 0,25 мм^3.

Длительность сканирования:	14 секунд
эффективное время излучения:	2...5 секунд
Время реконструкции:	ок. 2,5 минут
Объём данных:	ок. 900 МБ, режим HD ок. 1230 МБ
состоит из:	
Объём пациента:	ок. 430 МБ
Панорамный слой:	ок. 5 МБ
Снимок FRS:	ок. 6 МБ
Радиологические виды:	ок. 6 МБ
Детальная реконструкция:	ок. 30 МБ
Исправленные необработанные данные:	ок. 420 МБ, режим HD ок. 750 МБ (очищаемые)

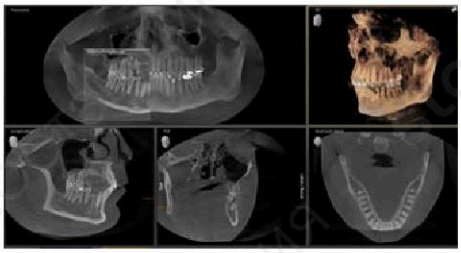

Панорамный вид




Радиологические виды

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

6.1.1 Режим HC: режим высокой контрастности

Программа VO5 HC (высокой контрастности) выбирается на сенсорном экране нажатием кнопки Высокая контрастность. См. раздел "Выбор высокой контрастности".

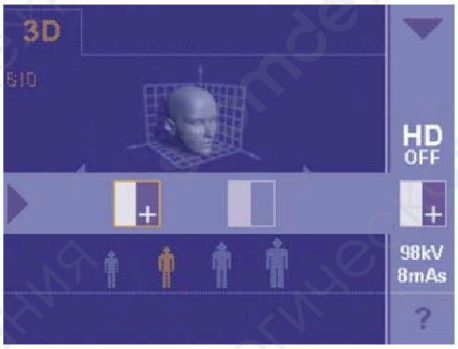


Настройка высокой контрастности VO5 HC по сравнению со стандартным вариантом улучшает отображение твёрдых структур, таких как кости и зубы. Это может ухудшить качество отображения мягких структур, в частности, силуэта мягких структур.

Поэтому функция Высокая контрастность лучше всего подходит в случае необходимости оценки костных или зубных структур, например, разрастаний кости, с возможностью одновременного отказа от корректного отображения силуэта мягких структур.

6.1.2 Режим HD: режим высокого разрешения

Программа VO5 HD (высокого разрешения) выбирается на сенсорном экране нажатием кнопки HD. См. раздел "Выбор режима HD".

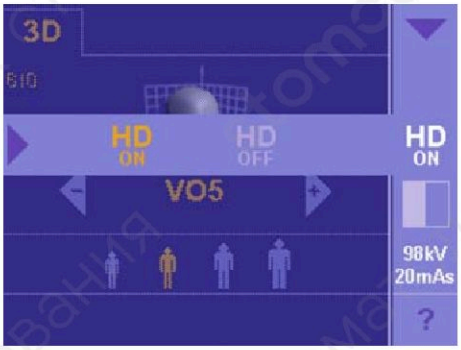


Режим HD (высокого разрешения):
Для улучшения визуализации структур.
В режиме HD создается в 1 3/4 раза (режим HD: 357 фрагментов изображений, стандартный: 200 фрагментов изображений) больше отдельных проекций, которые обеспечивают более точную реконструкцию качества изображения. Это позволяет уменьшить артефакты, типичные для технологии DVT/конусно-лучевой технологии (CBCT).
Учтите, что доза пациента при этом выше; особенно это важно в педиатрии.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

6.2 VOG: объемная программа для сканирования шаблона

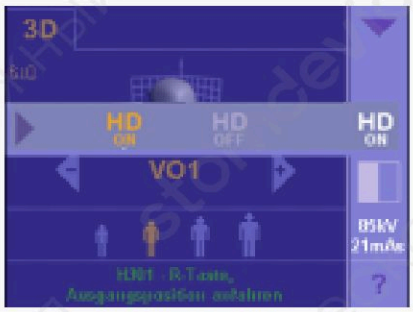

Программа VOG предназначена для сканирования небольших объектов, **она не подходит для рентгеновского обследования пациентов.**

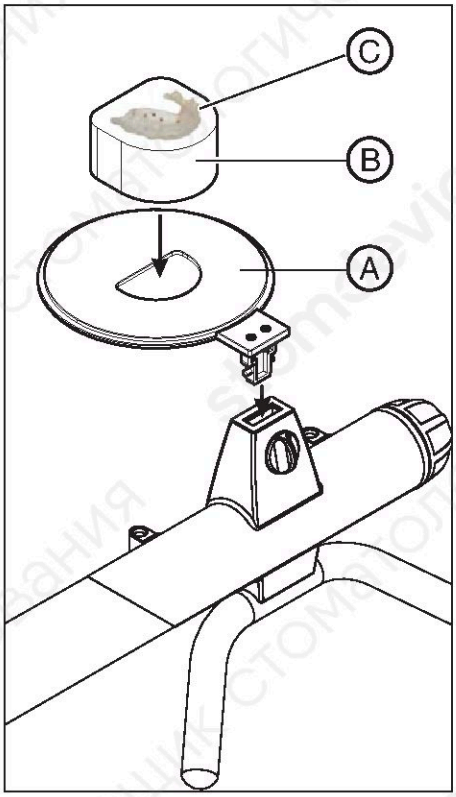

A	Опорная пластина (в комплекте)
B	Опора из пенопласта (в комплекте)
C	Рентгеновский шаблон создается индивидуально для каждого пациента

✓ В некоторых методиках планирования имплантации требуется рентгеновский шаблон, который снимается отдельно во время второй съемки и должен быть экспортирован.

1. Для сканирования рентгеновского шаблона требуется держатель шаблона без алюминиевого цилиндра.

   Установите держатель шаблона следующим образом:

   ↳ Полностью переместите фиксатор пациента наверх и снимите головную дугу либо демонтируйте весь фиксатор пациента, чтобы было достаточно места для позиционирования держателя шаблона.

   ↳ Вставьте опорную пластину **A** крепления шаблона до упора и поверните кнопку для фиксации согласно иллюстрации.

   ↳ Разместите опору из пенопласта **B** в выемке опорной пластины.

   ↳ Установите пенопластовую опору рентгеновского шаблона **C** так, чтобы он совпадал с положением подбородка пациента.

2. Выполните сканирование с программой VOG.
3. Экспортируйте набор данных в SIDEXIS.
   Команда меню: Иллюстрация -> Экспорт -> Объемы для сторонних производителей.

↳ Теперь скан можно редактировать дальше в формате DICOM.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7 Управление

7.1 Подготовка к рентгенографии

ПРИМЕЧАНИЕ

С целью защиты от излучения не следует проводить рентгеновскую съемку в 3D для получения снимков головы или панорамных снимков.

7.1.1 Установка принадлежностей

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стерилизация / дезинфекция принадлежностей, гигиенических защитных чехлов


Для каждого нового пациента накусочная пластина подлежит дезинфекции.

Для каждого нового пациента ручки, фиксирующая лента для головы (если используется), а также мягкая обивка опоры для лба подлежат дезинфекции.

Использовать гигиенические защитные чехлы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

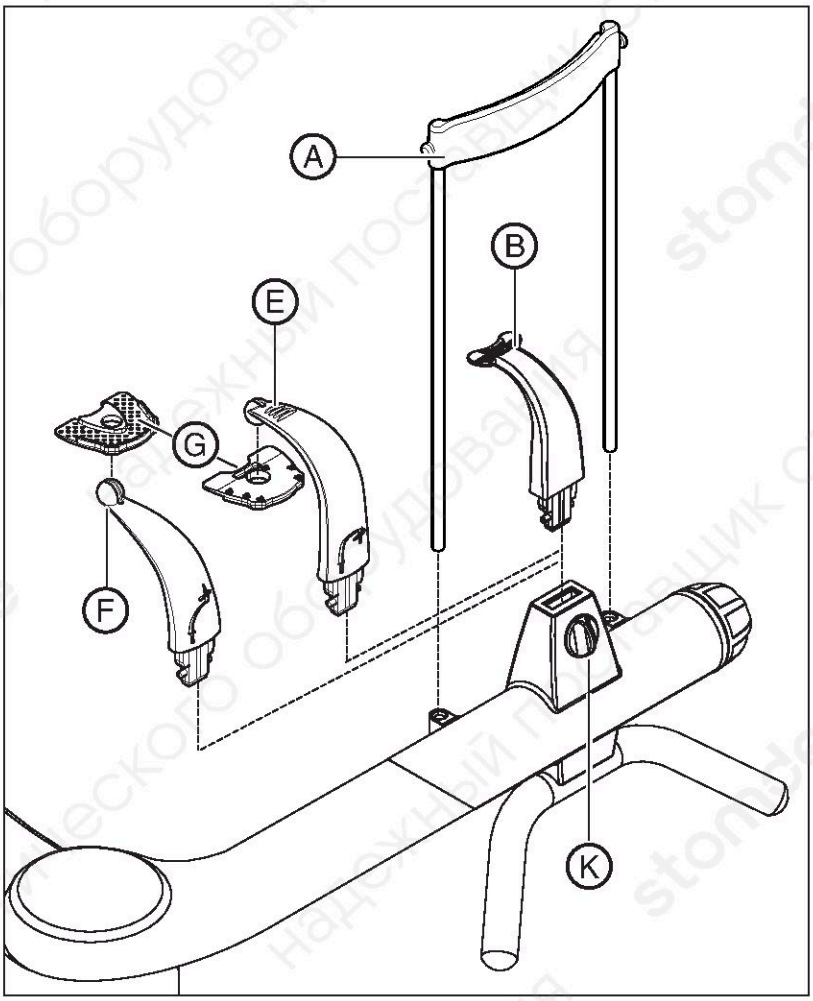

- Вставить накусочную пластину **(B)** до упора и зафиксировать поворотной ручкой **(K)**.
- Вставить опору для лба **(A)**.
- Надеть гигиенические защитные чехлы.

или для создания сверлильного шаблона:

- Держатель накусочной пластины для нижней челюсти **(E)** либо
- Держатель накусочной пластины для верхней челюсти **(F)** вставить до упора и зафиксировать поворотной ручкой **(K)**.
- Поместить шариковую накусочную пластину **(G)**, как показано на рисунке, для верхней либо нижней челюсти на шарики на соответствующем держателе накусочной пластины.

либо для отоларингологических снимков:


- Вставить накусочную пластину до упора и зафиксировать поворотной ручкой **(K)**.
- Вставить опору для лба **(A)**.
- Надеть гигиенические защитные чехлы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


7.1.2 Установка фиксатора головы

Установка фиксатора головы

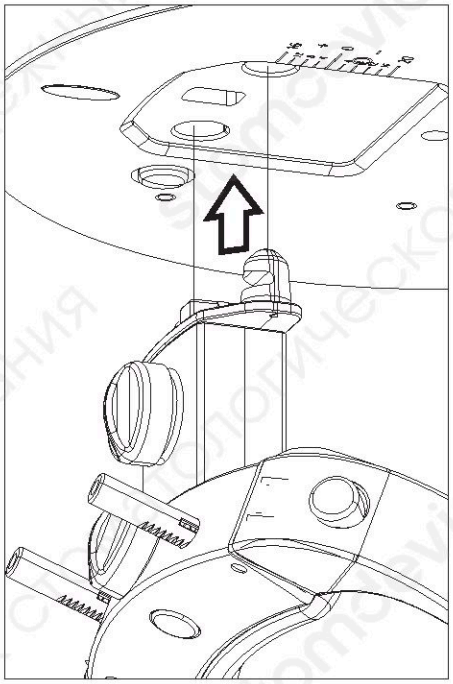

- Вставьте фиксатор головы до лёгкого щелчка.


Снятие фиксатора головы

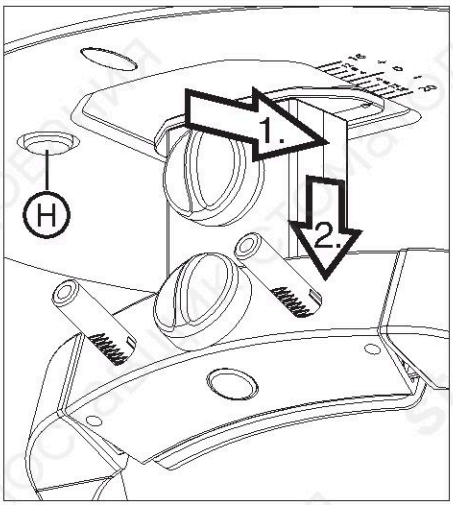

- Для снятия фиксации головы нажмите на фиксаторную кнопку (H) и переведите фиксатор головы до конца назад (1.) за точку давления и потяните вертикально вниз (2.).


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

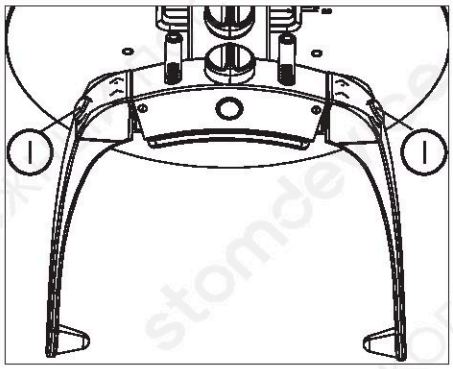

- Для снятия или установки головных дуг нажмите соответствующую фиксаторную кнопку (I).

Установка принадлежностей

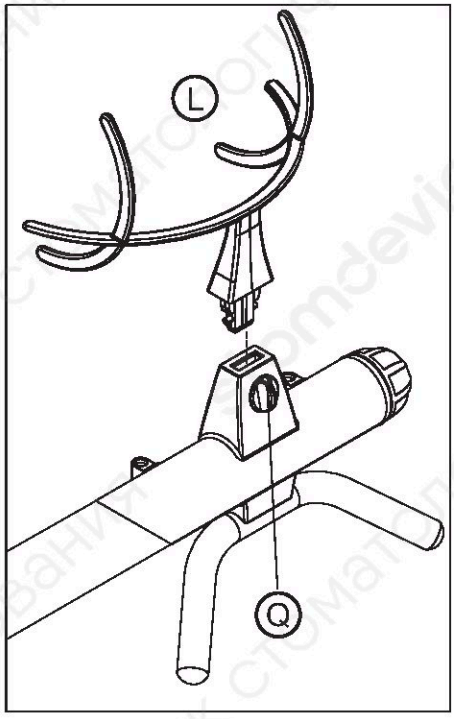

- Вставьте регулятор объёма (L) до упора и застопорите регулятор объёма вращающейся ручкой (Q).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7.1.3 Включение аппарата

ПРИМЕЧАНИЕ

После значительных колебаний температуры возможно образование конденсата. Включать аппарат следует лишь после того, как он достигнет комнатной температуры. См. главу Техническое описание [→ 18].


ВАЖНО

В случае более длительного простоя в работе (> 200 часов) для подготовки рентгеновского детектора (датчика) к работе требуется до десяти минут. Появится сообщение S1 50 (выполняется подготовка датчика). Если в течение этого времени будет достигнута готовность к рентгенографии, появится сообщение об ошибке E1 10 07. См. раздел Сообщение об ошибке E1 10 07 [→ 64]

⚠ ОСТОРОЖНО

При включении аппарата в аппарате не должен находиться пациент.

Если возникает неисправность, которая требует отключения и повторного включения аппарата, пациент должен быть выведен из аппарата не позднее повторного включения!

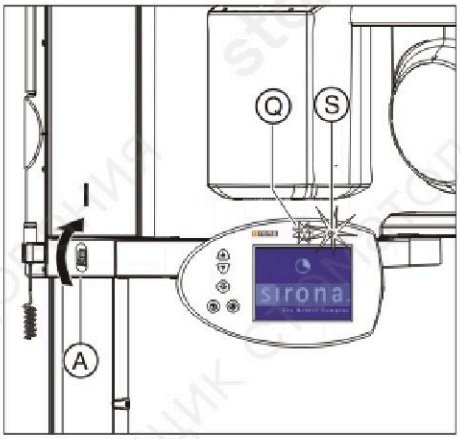

- Главный выключатель (A) установите в положение I и подождите около одной минуты.
- Горит светодиод (S) вверху на Easypad.
- Для контроля работы индикатора излучения (Q) он загорается примерно на одну секунду.

После выключения аппарата с помощью главного выключателя экран (сенсорный экран) продолжает светиться 3 - 5 сек.

ПРИМЕЧАНИЕ

После выключения аппарата главным выключателем необходимо подождать около 2 минут, прежде чем снова включить аппарат.

7.1.4 Индикация на сенсорном экране на панели Easypad




При включении аппарата на короткое время появляется начальный экран, который примерно через 1 минуту автоматически исчезает.

Пиктограмма часов отображает текущее состояние запуска аппарата.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

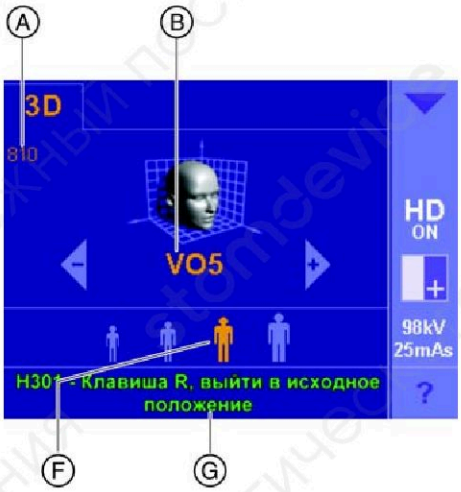

Затем появляется кадр выбора.

В экране выбора указывается:

A	Число мм регулировки накусочной пластины по высоте в диапазоне примерно от 810 до 1815 последнего настроенного пациента
B	Программа съемки
F	Символ последнего выбранного пациента с соответствующей парой значений кВ/мА
G	Справочные сообщения в строке комментария


Предварительно выбранные настройки показываются оранжевым цветом.

- Коротким нажатием кнопки возврата **R** приведите поворотный блок в положение позиционирования.

7.1.5 Включение Sidexis 4 в состояние готовности к рентгенографии

См. Руководство пользователя Sidexis 4
http://www.dentsplysirona.com/manuals

7.1.6 SIDEXIS включить в состояние готовности к рентгенографии

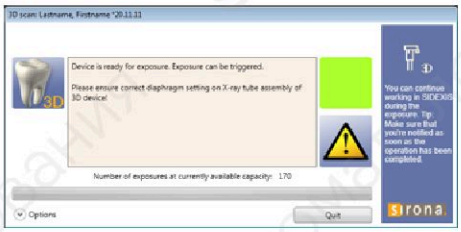

- Переведите **программу SIDEXIS на ПК** в **состояние готовности к рентгенографии**, см. SIDEXIS, Руководство пользователя.
- Если отсутствует связь с SIDEXIS, на сенсорном экране Easypad в строке комментария появится сообщение "**Привести SIDEXIS в готовность к рентгенографии**".

Если Вы используете GALILEOS с Facescan, Вы можете выбрать вид съемки на ПК в SIDEXIS. Диалог рентгенографии при использовании Facescan выглядит иначе, см. инструкцию по эксплуатации Facescan.

Если SIDEXIS готов к работе, на сенсорной панели на Easypad появляется заставка приветствия с выбранными данными пациента из программы SIDEXIS.



Здесь отображаются **имя**, **фамилия**, **дата рождения** и **номер карты** пациента, зарегистрированного в SIDEXIS.
В правом верхнем углу отображаются данные рентгенографии: программа, кВ, мАс и голубая пиктограмма излучения.
При достижении готовности к рентгенографии пиктограмма излучения становится желтой.

После прикосновения к экрану приветствие исчезает и снова появляется экран выбора.

Совет: Если Вам не нужны все эти индикаторы или отдельные данные, то по желанию техник сервисного обслуживания может деактивировать соответствующую индикацию.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7.2 Выбор параметров рентгенографии (значения кВ/мАс/дозы)

Выбор предустановленных параметров рентгенографии осуществляется символьными кнопками пациента. На пиктограммы пациента наложены заданные пары значений кВ/мА, которые можно выбрать в зависимости от роста и веса пациента. Пиктограммы примерно соответствуют ребенку, подростку/женщине, женщине/мужчине и крупным людям.

⚠ ОСТОРОЖНО

Чем больше пиктограмма пациента (пиктограммы ребенка, юноши, девушки, крупного мужчины), тем больше будет доза. В режиме HD качество изображения значительно увеличивается. Тем не менее, доза повышается в 2 и более раз.

⚠ ОСТОРОЖНО

При рентгенографии детей следует помнить о том, что в связи с физическими особенностями они более чувствительны к рентгеновскому излучению.

Стандартный режим: VO5 / VO5 HC

Программа:	Ребенок	Девушка	Юноша	Крупный человек
	98 кВ/3 мА	98 кВ/4 мА	98 кВ/5 мА	98 кВ/6 мА
Значения:	6 мАс	8 мАс	10 мАс	12 мАс
эффективное время излучения:	2 с	2 с	2 с	2 с
DFP:	222 мГрсм^2	290 мГрсм^2	356 мГрсм^2	425 мГрсм^2
DFP, рентгенография нижней челюсти*:	129 мГрсм^2	168 мГрсм^2	207 мГрсм^2	247 мГрсм^2
DFP, рентгенография верхней челюсти*:	171 мГрсм^2	223 мГрсм^2	274 мГрсм^2	328 мГрсм^2

Режим HD: V05 HD / VO5 HD HC

Программа:	Ребенок	Девушка	Юноша	Крупный человек
	98 кВ/3 мА	98 кВ/4 мА	98 кВ/5 мА	98 кВ/6 мА
Значения:	15 мАс	20 мАс	25 мАс	30 мАс
эффективное время излучения:	5 с	5 с	5 с	5 с
DFP:	612 мГрсм^2	780 мГрсм^2	957 мГрсм^2	1139 мГрсм^2

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


Программа:	Ребенок	Девушка	Юноша	Крупный человек
DFP, рентгенография нижней челюсти*:	355 мГрсм^2	452 мГрсм^2	555 мГрсм^2	660 мГрсм^2
DFP, рентгенография верхней челюсти*:	471 мГрсм^2	600 мГрсм^2	737 мГрсм^2	877 мГрсм^2

Используемая технология съемки:
FOV: диаметр 215 мм (8 1/2")

* рентгенография нижней челюсти: показ нижней челюсти
рентгенография верхней челюсти: показ верхней челюсти

7.3 Настройка высокой контрастности

Дополнительные рекомендации по индикации см. в описаниях программ.

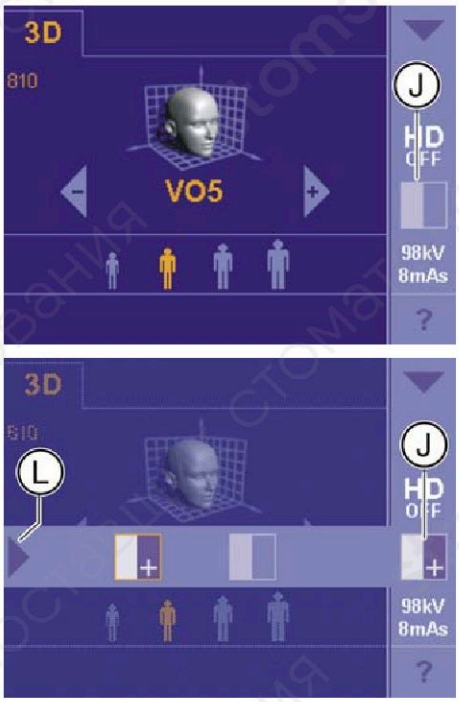

✓ Вы можете выбрать высокую или обычную контрастность:

1. Коснитесь символа контрастности (J).
   ↳ Появится строка подменю для выбора уровня контрастности.
2. Выберите уровень контрастности, коснувшись соответствующей пиктограммы:

   высокая контрастность

   обычная контрастность
3. Закройте строку подменю Уровень контрастности, коснувшись синей стрелки (L).
   ↳ Уровень контрастности, выбранный в данный момент, отображается соответствующей пиктограммой контрастности (J) справа в столбце Подменю.

ВАЖНО


Эта настройка является временной для данной рентгенограммы. Затем настройка возвращается к заводским значениям. Для долговременного изменения настройки необходимо изменить заводскую настройку контрастности.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


7.4 Настройка режима HD

Дополнительные рекомендации по индикации см. в описаниях программ.

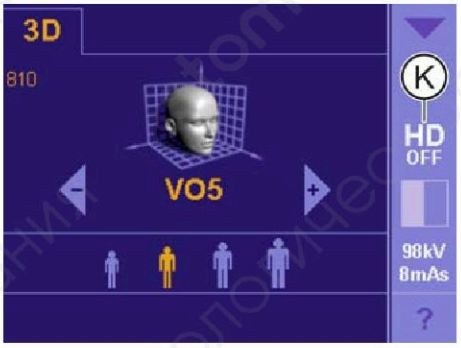

✓ Вы можете включить („ON“) или выключить („OFF“) режим HD:

1. Коснитесь символа HD (K).
   ↳ Появится строка подменю для выбора режима HD.
2. Выберите режим HD, коснувшись соответствующей пиктограммы:
   HD ON
   HD OFF

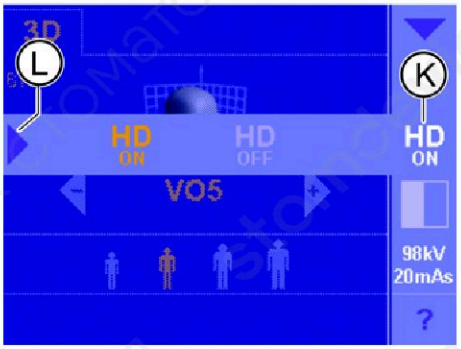

3. Закройте строку подменю, коснувшись синей стрелки (L).
   ↳ Режим HD, выбранный в данный момент, отображается соответствующей пиктограммой (K) справа в столбце Подменю.

ВАЖНО

Эта настройка является временной для данной рентгенограммы. Затем настройка возвращается к заводским значениям. Для долговременного изменения настройки необходимо изменить заводскую настройку контрастности.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


7.5 Регулировка механической диафрагмы

Механическая диафрагма предусматривает три фиксированные настройки.

Области, показанные синим цветом, отражают запланированные видимые объёмы рентгенографии.


Выведение на экран приводит к минимизации лучевой нагрузки в диагностической практике в области верхней или нижней челюсти.

Простым вращением ручки на излучателе можно выбрать нужный диапазон.




1. Показ верхней челюсти (ВЧ)

   При фиксации "Верхняя челюсть" в процессе рентгенографии отображается только область верхней челюсти. Высота показанного объема составляет ок. 8,5 см. Область нижней челюсти скрывается.



2. Открытая диафрагма

   При фиксации "Открытая диафрагма" отображается весь объём рентгенограммы. При этом вывода на экран не происходит.



3. Показ нижней челюсти (НЧ)

   При фиксации "Нижняя челюсть" в процессе рентгенографии отображается только область нижней челюсти. Высота показанного объема составляет ок. 8,5 см. Область верхней челюсти скрывается.

Совет: В случае неровно выросших зубов мудрости следует предпочесть открытую диафрагму, т.к. при показе верхней челюсти их полное отображение невозможно.

⚠ ОСТОРОЖНО

Перед каждым включением убедитесь в том, что диафрагма настроена правильно.

ВАЖНО

Если при одной из заданных настроек диафрагмы отклонения от обычного объемного изображения будут слишком велики, это может быть связано с тем, что диафрагма разрегулирована.
В таком случае свяжитесь с сервисным техником.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7.6 Позиционирование пациента

ПРИМЕЧАНИЕ

С целью защиты от излучения не следует проводить рентгеновскую съемку в 3D для получения снимков головы или панорамных снимков.

В обычном случае рентгеновская съёмка выполняется в положении пациента стоя. В особых случаях возможна также съёмка пациента в положении сидя, например, в рабочем кресле.

⚠ ОСТОРОЖНО

Рабочее кресло не должно иметь никаких деталей в потоке излучения и не должна ограничивать подвижность аппарата.

Подготовка

ВАЖНО

Примите во внимание диагностические ограничения при наличии в непосредственном окружении объектов, активно поглощающих рентгеновское излучение, например, металлических. Диагностические ограничения действуют и при использовании функции уменьшения металлических артефактов (MARS) и других выбранных настроек фильтров. Металлические имплантаты, мосты и пломбы, имеющиеся у пациента, могут сказаться на качестве изображения и, следовательно, на диагнозе.

- Пациент должен **снять** все **металлические предметы**, например, очки и украшения, с области головы и шеи, а также зубные протезы.
- Части тела, а также одежда, повязки, инвалидные коляски и кровати не должны мешать движениям аппарата! Выполнить тестовый цикл кнопкой T.
- Полностью открыть поворотную консоль аппарата.
- Настройте высоту аппарата с помощью кнопок „**вверх**“ и „**вниз**“ на панели Easypad примерно по росту пациента.


ВАЖНО

При нажатии кнопки R аппарат начинает движение, только если поворотная консоль находится в одном из двух конечных положений.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

7.6.1 Позиционирование пациента с накусочной пластиной

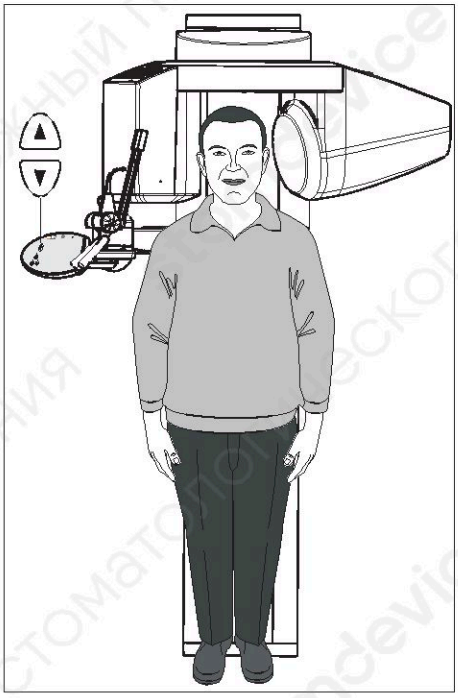

- Нажмите на **кнопку R**, чтобы перевести аппарат в положение входа.
- Пациент входит в аппарат спиной вперёд.
- Если поворотное кольцо при позиционировании пациента было случайно сдвинуто, повторное нажатие на кнопку “R“ позволяет снова перейти в положение входа.

7.6.1.1 Выравнивание пациента с помощью стандартной накусочной пластины

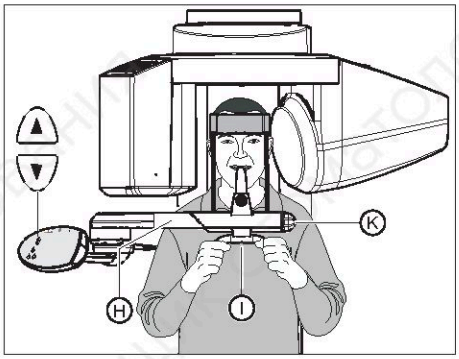

- Закройте поворотную консоль (H) до фиксации.
- Кнопками „**вверх**“ и „**вниз**“ на панели Easypad отрегулируйте рентгеновскую установку таким образом, чтобы **накусочная пластина и фронтальные зубы находились на одной высоте**.

Работа двигателя сопровождается акустическим сигналом.

⚠ ОСТОРОЖНО

Двигатель регулировки по высоте медленно начинает работу, а затем увеличивает свою скорость. Кнопку регулировки высоты удерживать нажатой до тех пор, пока не будет достигнута требуемая высота


- Пациент подходит к накусочной пластине и берётся за ручки (I).

ВАЖНО

Пациент должен стоять прямо со свободными плечами.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

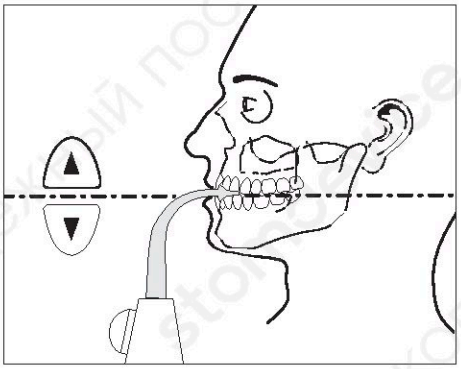


- Попросите пациента прикусить ложку накусочной пластины.

ВАЖНО

Высоту рентгеновской установки следует отрегулировать так, чтобы уровень прикуса после накусывания был строго горизонтальным.

7.6.1.2 Выравнивание пациента с опорой для подбородка, накусочной пластиной и контактной скобой

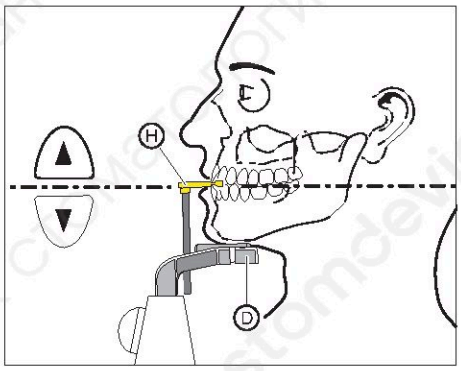


Показания:
– пациенты без зубов
– диагностика челюстного сустава
– цефалометрия

- Пациент входит в аппарат.
- Кнопками "вверх" и "вниз" отрегулируйте высоту аппарата так, чтобы подбородок пациента и опора для подбородка находились на одной высоте.
- Работа двигателя сопровождается акустическим сигналом.

⚠ ОСТОРОЖНО

Двигатель регулировки по высоте медленно начинает работу, а затем увеличивает свою скорость. Кнопку регулировки высоты удерживать нажатой до тех пор, пока не будет достигнута требуемая высота.

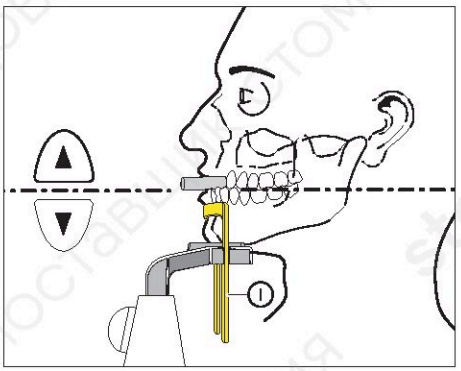


- С сомкнутыми челюстями пациент укладывает подбородок на опору для подбородка (D) и держится за ручки.
- Откинуть накусочную пластину (H).
- Пациент должен закусить накусочную пластину (верхние фронтальные зубы в надрезе, нижние фронтальные зубы выдвинуть вперед до упора).
- В случае с пациентом без фронтальных зубов вставьте контактную скобу (I) (дугой к штативу).
- Установите контактную дугу между подбородком и нижней губой и вставьте ватный валик.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7.6.2 Позиционирование пациента фиксатором головы (например, для KFO)

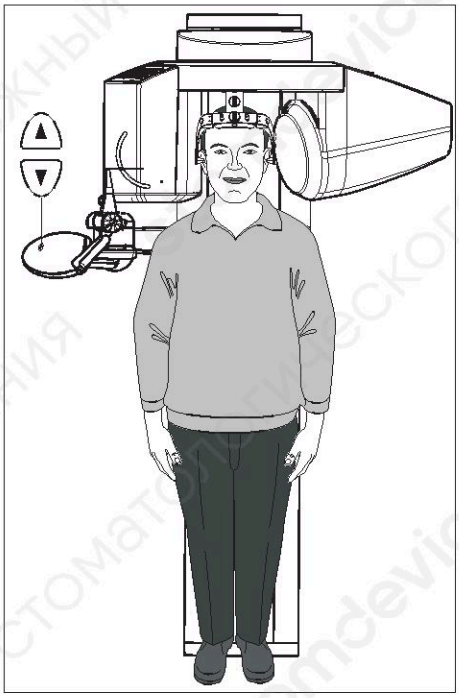


- Максимально раскрыть дуги опоры лба.
- Нажмите на **кнопку R**, чтобы перевести аппарат в положение входа.
- Наденьте на пациента предписанные принадлежности для защиты от излучения. Введите пациента затылком в аппарат.
- Если поворотное кольцо при позиционировании пациента было случайно сдвинуто, повторное нажатие на **кнопку R** позволяет снова перейти в положение входа.

⚠ ОСТОРОЖНО

Двигатель регулировки по высоте медленно начинает работу, а затем увеличивает свою скорость. Кнопку регулировки высоты удерживать нажатой до тех пор, пока не будет достигнута требуемая высота.


Выравнивание пациента

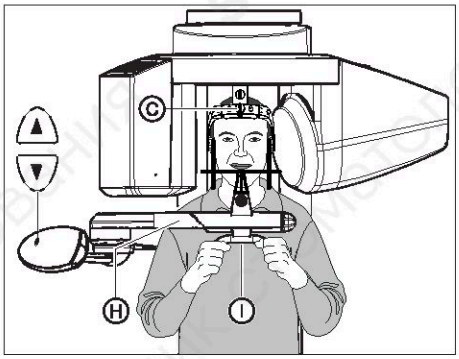

- Переместите рентгеновскую установку кнопками „**вверх**“ или „**вниз**“ на пульте управления так, чтобы **середина ушных вкладышей находилась на одной высоте с наружным слуховым проходом**.
  Движение двигателя сопровождается звуковым сигналом.
- Закройте дугу (C) фиксатора головы так, чтобы ушные вкладыши прилегали к наружному слуховому проходу.
- Закройте поворотную консоль (H) до фиксации.
- Пациент держится за рукоятки (I).

ВАЖНО

Для получения оптимального снимка пациент должен находиться в вертикальном положении, расслабив плечи.

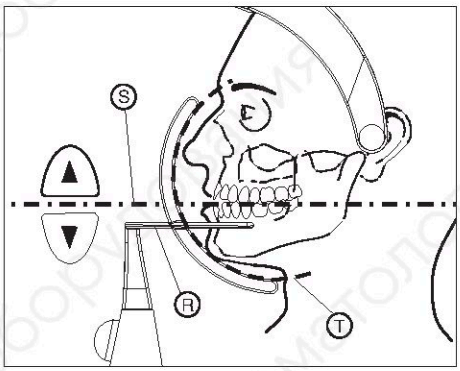

- Выставьте окклюзионный уровень (S) головы параллельно маркировочной линии (R) тонкой регулировкой кнопками „**вверх**“ или „**вниз**“.

ВАЖНО


Высоту рентгеновской установки следует отрегулировать так, чтобы окклюзионный уровень после выставления был строго горизонтальным.

- Правильно индицируемое положение можно настроить боковой пеленгацией регулятором объёма и с использованием возможностей вертикальной и горизонтальной регулировки.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

В качестве границы объёма следует рассматривать внутреннюю сторону (T) регулятора объёма.

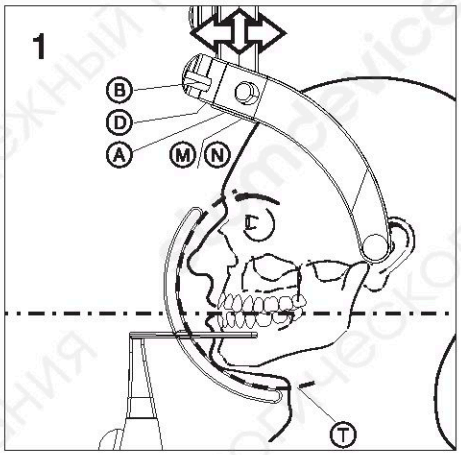

Пример 1: Нос и кончик подбородка в объёме, например, для оптимального представления силуэта Ceph-снимка.

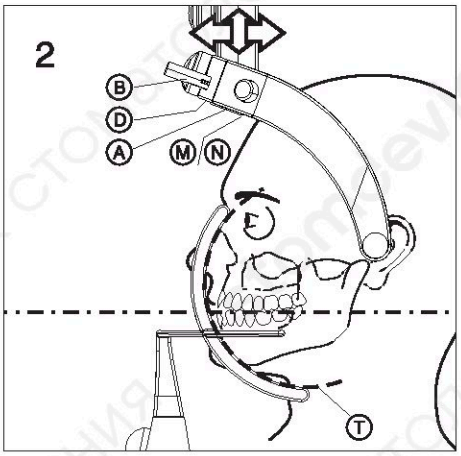

Пример 2: Возможность горизонтальной регулировки позволяет сместить заднюю область черепа (например, челюстные суставы) больше вглубь объёма. Для этого кончик носа и кончик подбородка могут быть выведены за пределы 3D объёма.

- В завершении зафиксируйте голову пациента, нажав на оба штифта (B) в направлении лба так, чтобы лобный упор (A) прилегал к голове. Выберите соответствующую обивку лобного упора M или N.
- Чтобы перевести лобный упор в нулевое положение, нажмите на кнопку (D).

ПРИМЕЧАНИЕ

При отводе вручную лобного упора назад фиксатор штифтов (B) получит повреждения.


Поэтому всегда нажимайте на кнопку (D) для снятия фиксации со штифтов (B).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7.6.3 Позиционирование пациента с шариковой накусочной пластиной


Использование шариковой накусочной пластины для создания сверлильного шаблона для имплантата

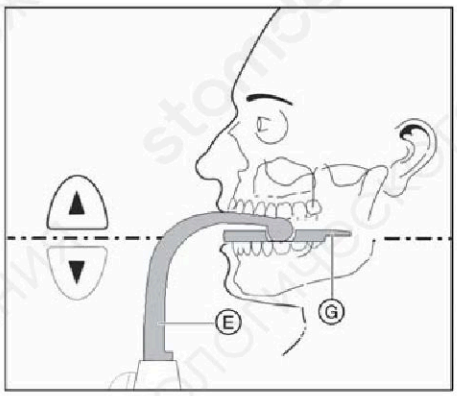

Для сканирования с шариковой накусочной пластиной выберите соответствующий держатель накусочной пластины. При рентгенографии нижней челюсти используйте держатель накусочной пластины (E). При рентгенографии верхней челюсти используйте держатель накусочной пластины (G).

В шариковой накусочной пластине (G) находятся рентгенонепрозрачных маркеров (шариков), служащих для ориентации в рентгеновском объёме. Возможны и другие варианты использования этой шариковой накусочной пластины.

Выравнивание пациента с помощью шариковой накусочной пластины

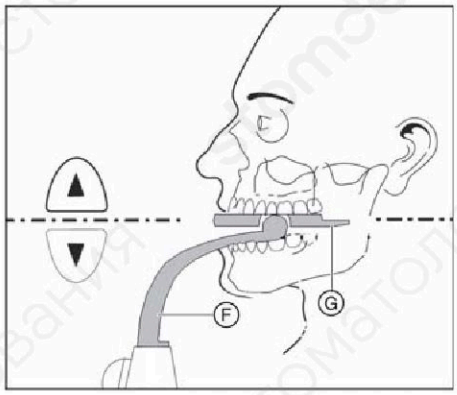


- Ввести шариковую накусочную пластину (G) в рот пациента с регистрацией.
- Закрыть поворотную консоль.
- Отрегулировать высоту аппарата так, чтобы шарики и резцы находились на одной высое. Шариковая накусочная пластина должна быть выставлена горизонтально.
- Пациента с открытым ртом аккуратно подвести к шарику держателя накусочной пластины.
- Пациент слегка накусывает держатель накусочной пластины.

ВАЖНО

Накусочная пластина должна касаться держателя накусочной пластины только над шариком. Если она прилегает спереди, требуется корректировка положения пациента или высоты аппарата.

7.6.4 Индикация средней сагиттальной

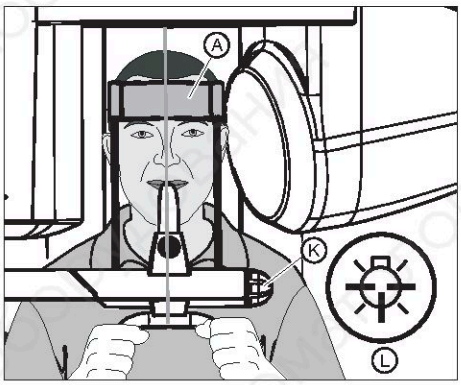

- Включите **световой прицел** кнопкой (L) на пульте управления. Он служит для настройки правильного положения пациента.
- Позиционируйте пациента так, чтобы световой луч проходил по центру прикуса и лица (симметрия - средняя сагиттальная).

Пока световой прицел включен, на сенсорном экране появляется красная пиктограмма светового прицела, см. главу Общие функции сенсорного экрана на панели Easypad.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

⚠ ОСТОРОЖНО

Следите за тем, чтобы световой луч, по возможности, не попадал в глаза пациенту (лазерное излучение). Световой прицел автоматически отключается примерно через 100 секунд.

- Зафиксируйте положение пациента, приложив опору для лба (A) с помощью поворотной ручки (K) к пациенту.
- В некоторых случаях полезным может оказаться дополнительная фиксация положения пациента с помощью фиксирующей ленты для головы (см. главу Накусочные пластины, опоры и фиксации [→ 32]).

Завершение подготовки

- Если световой прицел ещё горит, выключите его кнопкой (L) на пульте управления.

7.7 Включение рентгенографии

⚠ ОСТОРОЖНО


Обязательно соблюдайте действующие в вашей стране нормы защиты от излучения (см. также главу Защита от излучения [→ 12].

ВАЖНО

В строке комментариев на сенсорном экране не должно больше появляться ни одного справочного сообщения. Должно появиться сообщение "**Готовность к рентгенографии**".

Если дверь рентгеновского кабинета закрыта не до конца, сообщение „**Закройте дверь**" появится в строке комментариев сенсорного экрана и в закодированной форме **H321** - на дистанционном спусковом устройстве.

- Контролируйте программу и параметры рентгенографии.

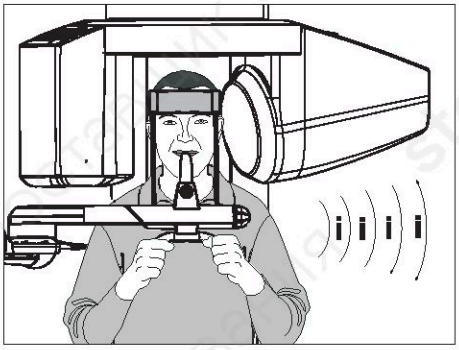


⚠ ОСТОРОЖНО

Проинструктируйте пациента и следите сами за тем, чтобы во время рентгенографии голова пациента была неподвижна!
Для обеспечения оптимального качества изображения пациент во время рентгенографии по возможности не должен дышать и глотать.
Обратите особое внимание на манеру поведения детей.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

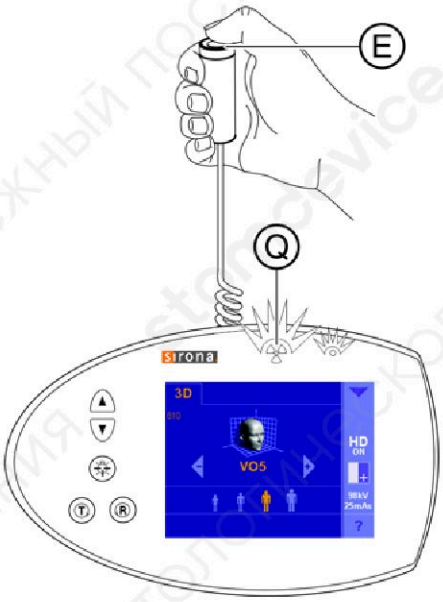

- Рентгенография выполняется нажатием на пусковую кнопку (E) непосредственно на рентгеновской установке либо на ДПУ.

Вращательное движение для выбранной программы рентгенографии выполняется автоматически.

Во время излучения загорается оптический индикатор излучения (Q) на пульте управления и на дистанционном пусковом устройстве. Излучение дополнительно сопровождается **акустическим сигналом**.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не отпустите случайно клавишу включения раньше времени. Дождитесь окончания рентгенографии.
В случае преждевременного прекращения рентгенографии вы получите существенно худшее качество изображения, так как полученная визуальная информация недостаточна для расчёта объёма.



- Рентгенография закончена, если:
  - В строке комментариев сенсорного экрана происходит переключение с „**Выполняется рентгенография**“ на „**Подтвердить данные рентгенографии кнопкой R**“.
  - На ДПУ появилось сообщение “**H 320**“, которое отображается попеременно с номером программы.
  - В конце рентгенографии рядом с номером программы отображается фактическое значение мАс.
  - В конце рентгенографии дополнительно слышна короткая последовательность звуковых импульсов (сервисный техник может её отключить).

Окончание рентгенографии отображается также на экране SIDEXIS, когда индикатор выполнения достигает 100 %.

Подтвердите рентгенограмму нажатием на кнопку “R“.

Затем снова нажмите на кнопку “R“, чтобы перевести аппарат во входное положение.

Теперь пациент может выйти из аппарата.

⚠ ОСТОРОЖНО

Во время переноса изображения выключение рентгеновской установки недопустимо. Процесс длится ок. 2,5 минут.

⚠ ОСТОРОЖНО

Память снимков аппарата очищается при выключении.

Изображения, не переданные в Sidexis, утрачиваются безвозвратно. В этом случае рентгенографию придется повторить.

➢ Дождитесь полной передачи данных рентгенографии. Выключайте аппарат только после того, как рентгеновский снимок откроется на экране Sidexis.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

После окончания рентгенографии

После окончания рентгенографии изображение рассчитывается в программе реконструкции и выводится на экран. Пока все виды не будут отображены на экране, может пройти от 2,5 до 5 минут в зависимости от выбранной программы и оснащения используемого ПК

ВАЖНО
Управление программой визуализации описано в приложенном Руководстве пользователя GALAXIS.

Запуск *"Суммарная поверхностная доза"* в SIDEXIS XG

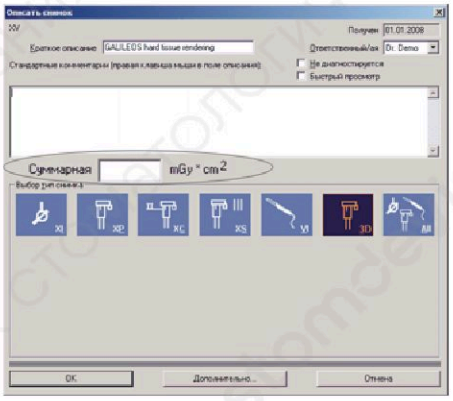

После съемки *"Суммарная поверхностная доза"* отображается в диалоговом окне *"Описать снимок"* в SIDEXIS XG.
Откройте диалоговое окно опцией *"[A]нализ"* → *"[O]писать снимок"* либо щелчком по появившейся пиктограмме у верхнего края окна.
Отображаемое диалоговое окно содержит доступную информацию к текущему открытому изображению.

Запуск *"Суммарная поверхностная доза"* в SIDEXIS 4



"Суммарная поверхностная доза" на этапе *"Examination"* отображается в пристыкованном окне *"Tools"* в палитре инструментов *"Info"* в SIDEXIS 4.
Отображаемое диалоговое окно содержит доступную информацию к текущему открытому изображению.

Прерывание рентгенографии

Если преждевременно отпустить спусковую кнопку, рентгенография прерывается.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

В строке комментариев появится сообщение „**Кнопка R, Подтвердить данные рентгенографии**“, и фактическое значение мАс в мигающем режиме отображается как на сенсорном экране под номером программы, так и на дистанционном пусковом устройстве.

Мигает светодиод готовности над кнопкой возврата "R".

⚠ ОСТОРОЖНО

Учтите, что перед повторением рентгенографии возможно измененные программные настройки снова должны быть выбраны.

- Два раза нажмите на кнопку "R" на пульте управления.
- После возврата поворотного блока повторить рентгенографию.

Автоматическая блокировка рентгенографии

(тепловая защита трубки)

Преждевременное включение новой рентгенографии предотвращается автоматической блокировкой рентгенографии.

После нажатия спусковой кнопки в строке комментариев сенсорного экрана появляется сообщение "**Готов к рентгенографии через "X" секунд**“.


При этом идет отсчёт времени охлаждения и отображается в "X".

Только после истечения времени охлаждения можно включить новую рентгенографию.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7.8 Дистанционное пусковое устройство (ДПУ)

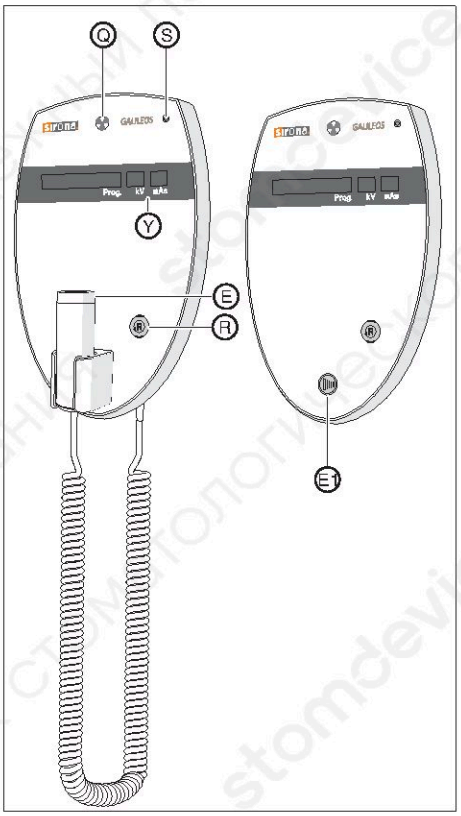

Если рентгеновская установка установлена в рентгеновском кабинете, который обеспечивает закрытие двери и визуальный контакт с пациентом, то включение рентгенографии может выполняться **дистанционным пусковым устройством**.

Для этого **спусковая кнопка (E)** может быть снята с аппарата и установлена на дистанционное пусковое устройство.

Пусковая кнопка (E1) может быть использована, если для визуального контакта не требуется длинный кабель.

Дистанционное пусковое устройство имеет **кнопку "R"** для квитирования рентгенографии и для возврата аппарата в исходное положение, оптический **индикатор излучения (Q)**, а также светодиодный индикатор "**Аппарат ВКЛ**" (S).

После включения аппарата загорается светодиод LED (S).

Для контроля работы индикатора излучения (Q) он загорается на длительное время.

Одновременно в поле индикации загораются три окна.

Примерно через 10 секунд появляется индикатор выполнения. После запуска аппарата индикация переключается на программу V05 с соответствующими значениями.

Пока на сенсорной панели Easypad **справочные сообщения** отображаются открытым текстом, эти же сообщения в кодированной форме отображаются и в поле **"Прог."**на дистанционном пусковом устройстве, постоянно **меняясь** с **названием программы**.

Когда все **справочные сообщения** подтверждены, в **поле индикации** постоянно отображается наименование программы **„Прог.“**, значения „**кВ**“ и „**мАс**“.

Теперь можно включать рентгенографию.

ВАЖНО
Если в поле **Прог.** появляется ряд точек („.....“), это означает, что аппарат находится в фазе подготовки (например, движения аппарата, переустановка параметров, время передачи программ и т. п.). Просто подождите, пока точки не исчезнут автоматически и снова не будет указываться готовность системы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

8 Список сообщений

8.1 Список справочных сообщений

Если Вы хотите запустить рентгенографию, на пульте управления могут отображаться справочные сообщения H3:

- Нажмите **спусковую кнопку. ВНИМАНИЕ Соблюдать меря защиты от излучения.**
  Сообщение **H3 / H4** .. появляется на пульте управления.
- Прочтите в приведенном ниже списке, что сделать, чтобы привести аппарат в состояние готовности к рентгенографии.

Справочное сообщение	Описание	Требуемые меры
H3 01	Поворотный блок не находится в начальном положении.	Клавиша R, выйти в исходное положение.
H3 20	Параметры рентгенографии еще не подтверждены.	Кнопка R, подтвердить параметры рентгенографии.
H3 21	Проверить дверной контакт для рентгеновского кабинета.	Закройте дверь.
H3 23	Полностью раскройте или закройте поворотную консоль.	Переведите поворотную консоль в конечное положение.
H4 03	SIDEXIS не готов к рентгенографии.	Включение SIDEXIS в состояние готовности к рентгенографии
H4 20	Изображение не удалось передать в SIDEXIS. **ВАЖНО:** Устранение ошибок на пути данных изображения (аварийное восстановление) описано в „Инструкция по эксплуатации компонентов ПО“, REF 61 98 191. **ВНИМАНИЕ!** Не выключайте аппарат, пока не будет завершено аварийное восстановление.	Получить имеющийся снимок.
S1 50	Датчик не готов к рентгенографии.	Дождитесь, пока датчик не будет готов к рентгенографии.

Указанными выше мерами устраняются справочные сообщения, связанные с ошибками управления.

Если справочное сообщение не может быть устранено вышеуказанными мерами, это указывает на наличие иной ошибки.

Найдите ошибку, как описано на последующих страницах.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

8.2 Структра сообщений об ошибках

Сообщения об ошибках показываются в виде кодов ошибок. Вывода открытого текста не происходит.

Код сообщений об ошибках имеет следующую структуру: Ex yy zz

Ex	Тип ошибки/классификация "устранения" для пользователя
yy	Расположение; модуль; частичная система или логический функциональный блок
zz	Порядковый номер с идентификацией ошибки

Все сообщения об ошибках сгруппированы по этим аспектам.

8.2.1 Ex

Разряд (x) должен обеспечить пользователю быструю основу для решения, как обращаться с этой ошибкой.

Ex	Описание	Требуемые меры	Группа ошибок
1	Системное предупреждение; системное указание	Квитировать сообщение об ошибке. Проинформировать службу технической поддержки. Дальнейшая работа аппарата обеспечена.	В эту группу попадают все ошибки, которые показывают еще приемлемые превышения допусков или указания на состояния, которые не препятствуют непосредственно работе аппарата.
2	Ошибки из-за перегрузки аппарата	Квитировать сообщение об ошибке. После определенного времени ожидания повторить операцию. Если сообщение об ошибке появляется снова, увеличить время ожидания. Если ситуация ошибки остается, проинформировать службу технической поддержки.	В эту группу попадают состояния, которые, например, показывают временный перегрев и т. п. Причина ошибки самостоятельно исчезает через определенное время ожидания.
3	При включении аппарата было распознано нажатие одной из кнопок.	Выключить и снова включить аппарат; если ошибка появится вновь, связаться со службой технической поддержки **ПРИМЕЧАНИЕ! После выключения аппарата главным выключателем необходимо подождать около 2 минут, прежде чем снова включить аппарат.**	В эту группу входят все ошибки, которые показывают недействительные состояния сигналов кнопок и защитные сигналы при включении.
4	Функциональная неисправность или механическое препятствие работе аппарата	Квитировать сообщение об ошибке; убедитесь в отсутствии препятствий движениям аппарата. Повторить последнюю операцию или рентгенографию. При повторном появлении ошибки без видимой причины: Проинформировать службу технической поддержки.	В эту группу входят все ошибки, которые сообщают о проблемах с движением действующей снаружи на аппарате моторики.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ex	Описание	Требуемые меры	Группа ошибок
5	Функциональная неисправность во время рентгенографии или подготовки к ней.	Для дальнейшей работы аппарата квитировать сообщение об ошибке. Повторить последнюю операцию или рентгенографию. При повторном появлении ошибки - проинформировать службу технической поддержки.	В эту группу входят все ошибки, которые появляются из определенного, вызванного оператором действия аппарата, т. к. необходимая для этого (внутренняя) частичная функция (программного или аппаратного обеспечения) не готова или вышла из строя.
6	Ошибка при самотестировании системы.	Для дальнейшей работы аппарата квитировать сообщение об ошибке. При повторении ошибки аппарат выключить и снова включить; если ошибка вновь появляется - связаться со службой технической поддержки.	В эту группу входят все ошибки, которые могут появиться спонтанно или без определенного действия. Они могут появляться при самотестировании системы.
7	Не устранимые системные ошибки.	Выключить аппарат; немедленно проинформировать службу технической поддержки.	В эту группу входят все ошибки, которые могут появиться спонтанно или без определенного действия. Они могут появляться при самотестировании системы. По соображениям безопасности продолжение эксплуатации аппарата невозможно.

8.2.2 yy

Разряды (yy) определяют расположение и логический функциональный узел, в котором возникла ошибка.

10	Центральная система управления DX 11; системные аппаратные средства
11	Центральная система управления DX 11; системное программное обеспечение
12	Центральная система управления DX 11; ошибка в центральной CAN-шине
13	Центральная система управления DX 11; периферия DX11, DX1 (моторика штатива, сенсорика штатива)
14	Центральная система управления DX 11; цифровое расширение (HSI, сеть ...)
15	Центральная система управления DX 11; конфигурация (неверное программное обеспечение, неправильное расположение модулей и т. п.)
06	Излучатель
7/71	Интерфейс пользователя
89	Датчик
42	Дистанционное управление

Расположением может быть DX-номер узла, представляющего целый функциональный блок аппаратных средств или логический программный функциональный блок на DX11 (центральная система управления).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

8.2.3 zz

Разряды (zz) представляют порядковые номера с идентификацией ошибки.

8.3 Сообщение об ошибке E1 10 07

Объяснение

Здесь описаны возможные причины и варианты устранения данной ошибки.

Случай 1

В случае более длительного простоя в работе (> 200 часов) для подготовки рентгеновского детектора (датчика) к работе требуется до десяти минут. Появится сообщение S1 50 (выполняется подготовка датчика).

В течение этого времени аппарат не готов к работе.

Если в течение этого времени будет достигнута готовность к рентгенографии, появится сообщение об ошибке E1 10 07.

Устранение

Квитируйте это сообщение нажатием на кнопку (R) и дождитесь исчезновения сообщения об ошибке.

ВАЖНО
Сокращение времени ожидания Выключение и включение аппарата **не** сокращает время ожидания!

Случай 2

Если сообщение об ошибке E1 10 07 появляется непосредственно после включения аппарата до достижения готовности к рентгенографии, сообщите об этом ответственному технику.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

9 Техническое обслуживание

9.1 Очистка и уход

9.1.1 Очистка

Регулярно удаляйте грязь и остатки дезинфицирующего средства обычным нейтральным чистящим средством.

ПРИМЕЧАНИЕ

При очистке и дезинфекции в аппарат через вентиляционные щели или спусковую кнопку может попасть жидкость.

Это может вывести из строя электрические компоненты аппарата.

- ➢ Не допускайте попадания разбрызгиваемых жидкостей в вентиляционные щели или спусковую кнопку.
- ➢ Нанесите жидкость сначала на ветошь для очистки. Затем протирайте ветошью зону вокруг вентиляционных щелей или спусковую кнопку.
- ➢ Не допускайте растекания жидкости по поверхности с попаданием в вентиляционные щели или спусковую кнопку.

9.1.2 Дезинфекция

Допускается лишь наружная дезинфекция только допущенными химическими дезинфицирующими средствами. Разрешается использовать только средства для дезинфекции, проверенные ответственными государственными органами или центрами сертификации в отношении бактерицидных, фунгицидных и вируцидных свойств и имеющие соответствующие допуски.

ПРИМЕЧАНИЕ

Средства по очистке и уходу могут содержать агрессивные компоненты.

Неподходящие средства по очистке и уходу вредны для здоровья и оказывают агрессивное воздействие на поверхность аппарата.

- ➢ Не используйте: Средства, содержащие фенол, перуксусную кислоту, пероксид и другие вещества, расщепляющие кислород, гипохлорит натрия и вещества, расщепляющие йод.
- ➢ Используйте только средства для очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Dentsply Sirona.

Постоянно обновляемый список допустимых средств можно найти в сети Интернет на Online-портале, посвященном техническим документам. Портал расположен по адресу:
www.dentsplysirona.com/manuals
Щелкните по пункту меню *"General documents"* и откройте документ *"Care, cleaning and disinfection agents"*.

Если у Вас нет доступа в Интернет, для заказа списка выберите один из двух приведенных ниже вариантов:

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

- Заказ в фирме по техническому обеспечению стоматологических практик
- Заказ в Dentsply Sirona:
  Тел: ++49 (0) 62 51 / 16-16 70
  Факс: ++49 (0) 62 51 / 16-18 18

REF **59 70 905**

Компания Dentsply Sirona рекомендует следующие средства для дезинфекции:

- MinutenSpray classic, фирма ALPRO®
- MinutenWipes, фирма ALPRO®

В США и Канаде:

- CaviCide® или
- CaviWipes ™ .

9.1.3 Стерилизация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инфекция может передаваться от пациента к пациенту.


Из-за неправильно стерилизованных принадлежностей происходит заражение пациентов.

➢ Стерилизовать принадлежности, разрешенные для стерилизации, только в автоклаве при температуре 132 °C (270° F), не менее 4 минут при давлении 2,1 бар (30,5 psi).

Следующие принадлежности можно стерилизовать:

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

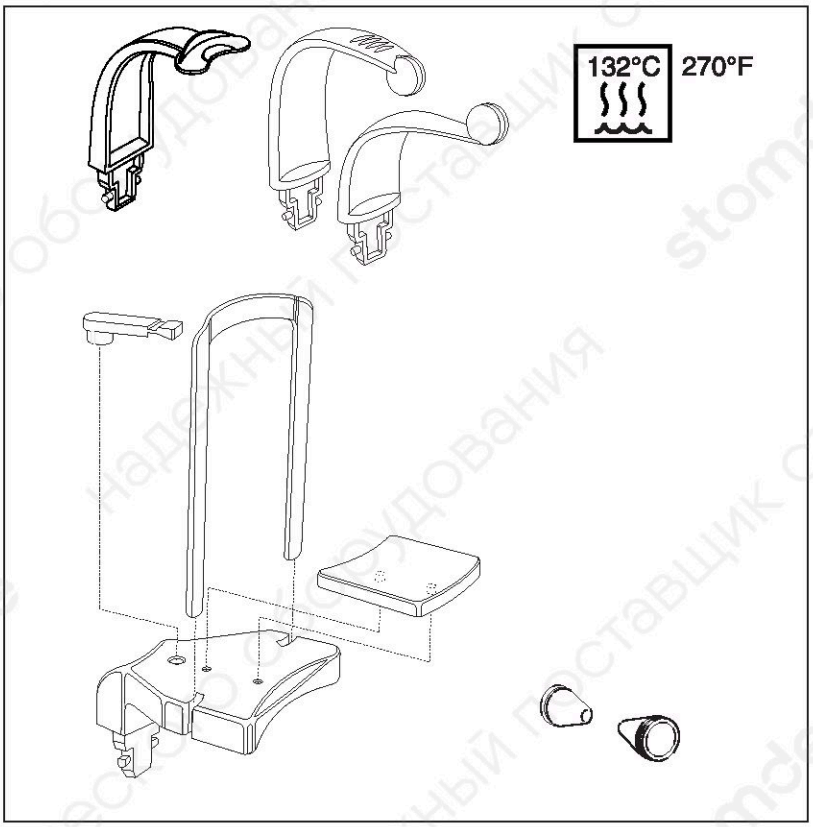

Используйте дополнительно гигиенические чехлы, см. „Гигиенические чехлы“ [→ 34].

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гигиенические чехлы являются одноразовыми изделиями.

Из-за загрязненных гигиенических защитных чехлов происходит заражение пациентов.

➢ Меняйте гигиенические чехлы после каждого пациента.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

9.2 Осмотр и техническое обслуживание

В интересах обеспечения здоровья и безопасности пациентов, обслуживающего персонала и третьих лиц необходимо с установленной периодичностью проводить инспектирование и техническое обслуживание.

Сведения, приведенные в документе *"Inspection and maintenance and safety-related checks"* REF *"61 25 533"*, могут вам в этом помочь. Документ можно загрузить по адресу http://www.sirona.com/de.html.

Ежегодная инспекция

Для обеспечения рабочей безопасности и функциональной надежности изделия Вы как пользователь должны регулярно обслуживать аппарат (не реже раза в год) или поручать это фирме по техническому обеспечению стоматологических практик.

Обслуживание сервисным инженером

Дополнительно к проводимым ежегодным осмотрам пользователем или уполномоченными лицами проводить обслуживание через 4, 7, 10, а затем каждые два года.

Контроль качества изображений

Регулярно, но не реже одного раза в год, пользователь обязан провести анализ качества изображений.

При использовании цифровых приемников изображений в качестве критерия оценки используется возрастающее число последующих обработок изображений с помощью регулятора яркости или контрастности в программе по обработке изображений (например, Sidexis).

Если этот критерий оценки независимо от анатомии пациента и возможных источников ошибок, например, позиционирования пациента, признается существующим, то необходимо немедленно вызвать техника для устранения возможных неисправностей аппарата.

Требования, обусловленные спецификой страны применения

Соблюдайте дополнительные требования, обусловленные спецификой страны применения.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

10 Демонтаж и утилизация

10.1 Демонтаж и повторная установка

При демонтаже и повторной установке аппарата следует действовать по указаниям, приведенным в инструкции по монтажу для нового монтажа, чтобы обеспечить работоспособность и устойчивость аппарата.

Если в окружение рентгеновского кабинета вносятся строительные изменения или производится установка нового оборудования, необходимо провести повторную калибровку рентгеновской установки.

10.2 Утилизация



На основании Директивы 2012/19/EU и предписаний федеральных земель по утилизации лома электрического и электронного оборудования мы указываем на то, что на территории Европейского Союза (ЕС) данная продукция подлежит передаче для специальной утилизации. Эти правила требуют экологически рациональной переработки / утилизации лома электронного и электрооборудования. Выбрасывать изделие вместе с бытовым мусором запрещено! На это указывает символ «Перечеркнутая урна».

Способ утилизации

Мы осознаем свою ответственность за нашу продукцию - от возникновения идеи до итоговой утилизации. Поэтому мы предлагаем вам возвращать нам лом электронного и электрооборудования.

В случае необходимости утилизации действуйте следующим образом:

В Германии

Для того, чтобы у вас забрали электрооборудование, подайте заявку на утилизацию в фирму Enretec GmbH. Для этого предлагаются следующие возможности:

- На домашней странице enretec GmbH (www.enretec.de) в разделе меню „eom“ нажмите кнопку „Возврат электрооборудования“.
- Либо вы можете обратиться непосредственно в компанию enretec GmbH.

  enretec GmbH
  Kanalstraße 17
  16727 Velten

  Тел.: +49 3304 3919-500
  E-Mail: eom@enretec.de

В соответствии с предписаниями по утилизации различных федеральных земель (Закон об электрическом и электронном оборудовании) мы, как производитель, берем на себя расходы на утилизацию лома соответствующего электрического и электронного

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

оборудования. Расходы на демонтаж, транспортировку и упаковку несет собственник / эксплуатирующая организация.

Перед демонтажем / утилизацией изделия необходимо провести его надлежащую подготовку (очистку / дезинфекцию / стерилизацию).

Наши специалисты заберут ваш нестационарный аппарат в практике, а стационарный - от кромки тротуара в согласованное между сторонами время.

Другие страны

Точные сведения по правилам утилизации в конкретной стране можно получить у специализированных поставщиков стоматологического оборудования.

10.2.1 Рентгеновская трубка GALILEOS

Рентгеновский излучатель этого аппарата содержит взрывоопасную трубку, небольшое количество бериллия, свинцовую обшивку, а также минеральное масло.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

11 Данные по дозе

Произведение дозы на площадь

Облучение указывается как произведение дозы энергии (Гр x см²) на площадь (DFP) на мАс каждой доступной ступени и диафрагмы.

Для компенсации ошибок при измерениях, а также вариантов систем и устройств следует учитывать допуск 20%.

GALILEOS работает с постоянно заданными парами значений кВ/мА.

Стандартный режим: VO5 / VO5 HC

Программа:	Ребенок	Девушка	Юноша	Крупный человек
	98 кВ/3 мА	98 кВ/4 мА	98 кВ/5 мА	98 кВ/6 мА
Значения:	6 мАс	8 мАс	10 мАс	12 мАс
эффективное время излучения:	2 с	2 с	2 с	2 с
DFP:	222 мГрсм^2	290 мГрсм^2	356 мГрсм^2	425 мГрсм^2
DFP, рентгенография нижней челюсти*:	129 мГрсм^2	168 мГрсм^2	207 мГрсм^2	247 мГрсм^2
DFP, рентгенография верхней челюсти*:	171 мГрсм^2	223 мГрсм^2	274 мГрсм^2	328 мГрсм^2

Режим HD: V05 HD / VO5 HD HC

Программа:	Ребенок	Девушка	Юноша	Крупный человек
	98 кВ/3 мА	98 кВ/4 мА	98 кВ/5 мА	98 кВ/6 мА
Значения:	15 мАс	20 мАс	25 мАс	30 мАс
эффективное время излучения:	5 с	5 с	5 с	5 с
DFP:	612 мГрсм^2	780 мГрсм^2	957 мГрсм^2	1139 мГрсм^2
DFP, рентгенография нижней челюсти*:	355 мГрсм^2	452 мГрсм^2	555 мГрсм^2	660 мГрсм^2
DFP, рентгенография верхней челюсти*:	471 мГрсм^2	600 мГрсм^2	737 мГрсм^2	877 мГрсм^2

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Сканирование шаблона: VOG

Программа:	
	98 кВ/6 мА
Значения:	30 мАс
Эффективное время излучения	5 с
DFP	1139 мГрсм^2
DFP, рентгенография нижней челюсти*	660 мГрсм^2
DFP, рентгенография верхней челюсти*	877 мГрсм^2

* рентгенография нижней челюсти: показ нижней челюсти
рентгенография верхней челюсти: показ верхней челюсти

Эффективные значения дозы

Облучение указывается как эффективное значение дозы D_{eff} (мкЗв).

Для компенсации ошибок при измерениях, а также вариантов систем и устройств ледует учитывать допуск 20%.

GALILEOS работает с постоянной настройкой 98 кВ и 6 мА.

Отсюда получаем следующие значения дозы для стандартной программы объема GALILEOS Comfort PLUS:

Программа				
Значения	6 мАс	8 мАс	10 мАс	12 мАс
Полный Эффективное значение дозы D_{eff}	28 мкЗв	38 мкЗв	47 мкЗв	56 мкЗв
Верхнечелюстной Эффективное значение дозы D_{eff}	20 мкЗв	27 мкЗв	34 мкЗв	41 мкЗв
Нижнечелюстной Эффективное значение дозы D_{eff}	22 мкЗв	29 мкЗв	37 мкЗв	45 мкЗв

Отсюда получаем следующие значения дозы для стандартной программы объема GALILEOS Comfort PLUS в режиме HD:

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Программа				
Значения	15 мАс	20 мАс	25 мАс	30 мАс
Полный Эффективное значение дозы D_{eff}	78 мкЗв	106 мкЗв	130 мкЗв	154 мкЗв
Верхнечелюстной Эффективное значение дозы D_{eff}	62 мкЗв	84 мкЗв	103 мкЗв	122 мкЗв
Нижнечелюстной Эффективное значение дозы D_{eff}	68 мкЗв	92 мкЗв	113 мкЗв	133 мкЗв

Источник

Исследование: „Сравнительная дозиметрия диагностической визуализации GALILEOS Dental CBCT“,
проф. Д-р д-р Джон Б. Людлов, департамент диагностики и общей стоматологии, университет Северной Каролины, факультет стоматологии, Чейпл Хилл, Северная Каролина, США

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений

© Sirona Dental Systems GmbH
D3437.201.08.10.12 12.2017
Sprache: russisch
Ä.-Nr.: 124 736
Printed in Germany
Отпечатано в Германии

Sirona Dental Systems GmbH

Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Germany
www.dentsplysirona.com

для заказа **64 18 508 D3437**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ