stomdevice

РАЗРАБОТКА ВЕГА-ПРО ПРОИЗВОДСТВО

EAC

АВЕРОН

СТОЛИК ПОДКАТНОЙ ПРИБОРНЫЙ



модель

СПП 1.0	
СПП 1.1	
СПП 1.4	

СПП 1.0, СПП 1.1: Декларация о соответствии
ТС N RU D-RU.АИ16.В.02124 от 30.07.2015

СПП 1.4: Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ22.В.13246/18 от 28.11.2018

Этикетка
АВЕ 148.000.001 ЭТ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Столик подкатной приборный СПП 1.х (далее – **СПП**) - предназначен для компактного размещения оборудования и инструментов, а также их оперативного перемещения без переноски. Мебель ГОСТ 16371-2014. ТО 5621-39-52331864-2015, ТО 31.09.11-39-52331864-2018 Мебель лабораторная.

Условия эксплуатации

окружающая температура .....10...35°С
влажность при 25°С, не более 80%

Основные технические характеристики

максимальная нагрузка на одну полку .....10 кг
масса, не более .....10 кг
габариты..... 400×420×720 мм

Комплектность	шт		шт
основание	— 1	шайба 5	— 4
стойка боковая лев/прав .	— 1/1	шайба гр.5	— 4
опоры.....	— 4	гайка колпачковая М5	— 4
планка декор. лев/прав ...	— 1/1	декор. колпачок для гайки М5 ..	— 4
перекладина	— 1		
к-т колесных опор	— 1		

для СПП 1.0
полка — 3 шт

для СПП 1.1
полка — 2 шт
полка с ящиком — 1 шт

для СПП 1.4
полка — 4 шт








ПОРЯДОК СБОРКИ

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).

Установить и закрепить колесные опоры **(2)** на основании **(1)** с помощью крепежа из комплекта.

Установить декоративные колпачки на гайки.

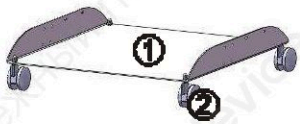


Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Примечание:

Ключ, поставляемый в комплекте с колесными опорами, предназначен для того, чтобы удерживать ось опоры при закручивании гайки другим ключом, под гайку S8.

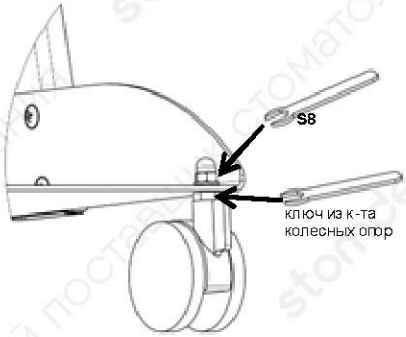

Установить и закрепить:

— боковые стойки **(3)**;


— перекладину **(4)**;

— полки (с ящиком, для СПП 1.1) последовательно снизу вверх.

Установить в боковых стойках **(3)** декоративные планки, подогнуть их язычки.

СПП готов к работе.



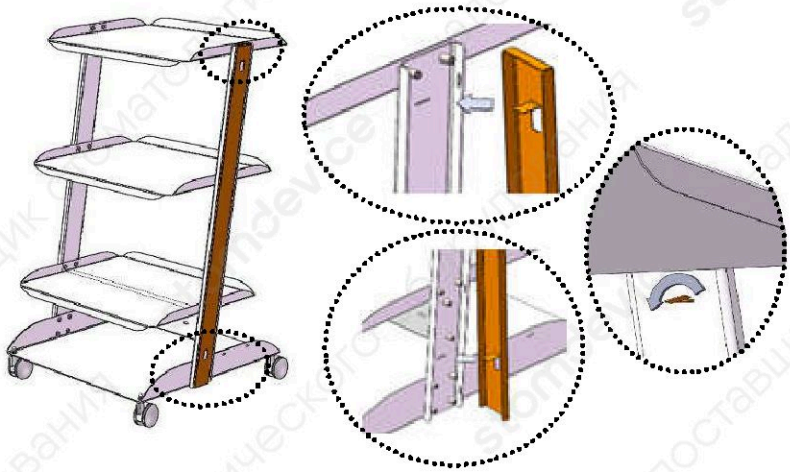

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

stomdevice

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

СПП 1.0	Зав. номер
СПП 1.1	Зав. номер
СПП 1.4	Зав. номер
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ