
stomdevice

РАЗРАБОТКА ВЕГА-ПРО ПРОИЗВОДСТВО

EAC

АВЕРОН

СТЕЛЛАЖ
СТЕЛЛАЖ 1.0 ДИРЕКТ ☐
СТЕЛЛАЖ 1.0 КОНЕР ☐

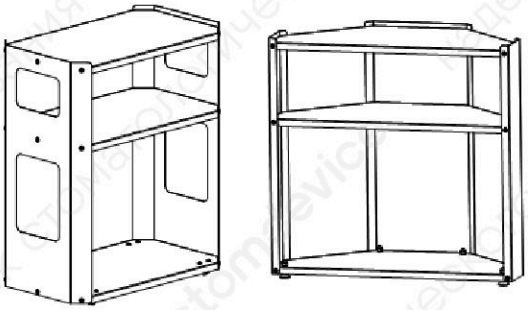

Этикетка
АВЕ 241.220.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ТС N RU D-RU.АИ16.В.02124 от 30.07.2015

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

СТЕЛЛАЖ 1.0 ДИРЕКТ	
СТЕЛЛАЖ 1.0 КОНЕР	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для моделей **СТЕЛЛАЖ 1.0 ДИРЕКТ** и **СТЕЛЛАЖ 1.0 КОНЕР** (далее – стеллаж). ТО 5621-039-52331864-2015.

1.2 Стеллаж предназначен для компактного размещения материалов, инструментов, принадлежностей для работы.
Рекомендуется применять совместно с **ПОЛКОЙ 2.1 КОНЕР** для оптимального использования угловой зоны (рис.3) между расположенными под прямым углом столами АВЕРОН (далее - стол): СУЛ/С3Т МАСТЕР.

1.3 Отличия моделей:

СТЕЛЛАЖ 1.0 ДИРЕКТ – центральный (прямоугольный, выкатной, три яруса, четыре роликовые опоры);
СТЕЛЛАЖ 1.0 КОНЕР – боковой (трапеция, три яруса, четыре регулируемые опоры).

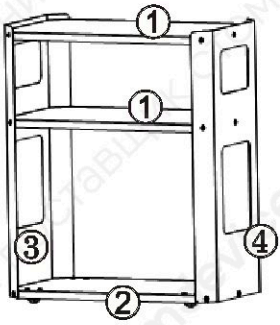


Рис.1
СТЕЛЛАЖ 1.0 ДИРЕКТ

1.4 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°С
- влажность при 25°С, не более 80%

1.5 Основные технические характеристики

	ДИРЕКТ	КОНЕР
• габариты, мм	530×305×635	655×310×635
• масса, не более, кг	7	7
• максимальная нагрузка на верхнюю полку, кг	10	10

1.6 Комплектность

	ДИРЕКТ, шт	КОНЕР, шт
1 – Полка	2	2
2 – Основание с опорами	1	1
3/4 – Стенка левая/правая	1/1	1/1
5 – Стенка задняя	–	1
Опора регулируемая (ролик)	4	4

Этикетка АВЕ 241.220.000 ЭТ

☒ - ПОЛКА 2.1 КОНЕР

Примечание: ☒ - поставка по дополнительной заявке

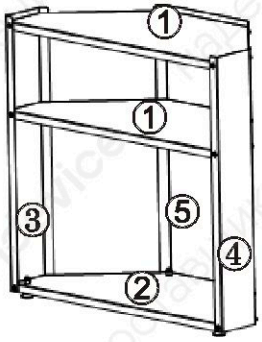


Рис.2
СТЕЛЛАЖ 1.0 КОНЕР

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice


2 ПОРЯДОК СБОРКИ

Во избежание перекосов стеллаж собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.
Крепеж установлен по месту, ролики и ножки оснований прикручены.

СТЕЛЛАЖ 1.0 КОНЕР


Установить и закрепить к полкам **(1)** заднюю **(5)** и боковые **(3/4)** стенки.
Установить собранную конструкцию пазами на винты основания **(2)**.

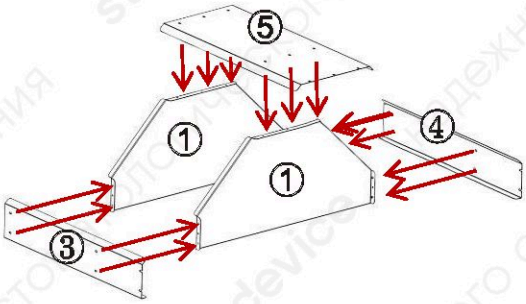


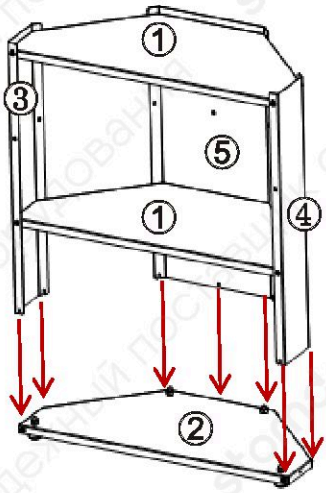

СТЕЛЛАЖ 1.0 ДИРЕКТ

Установить и закрепить боковые стенки **(3/4)** к полкам **(1)**.
Установить собранную конструкцию пазами на винты основания **(2)**.

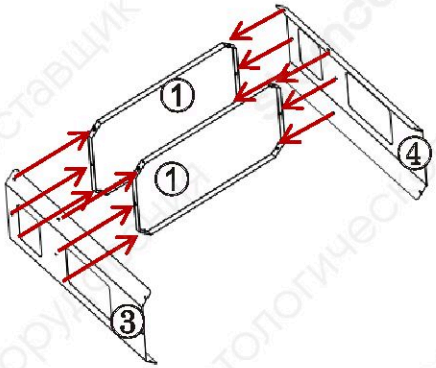

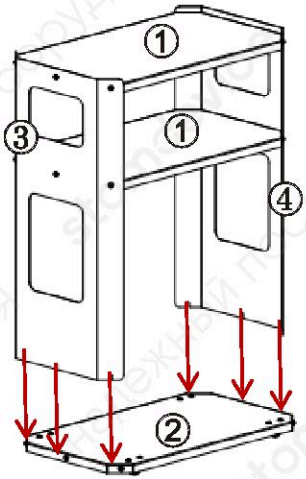

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Пример максимального заполнения угловой зоны, рис.3

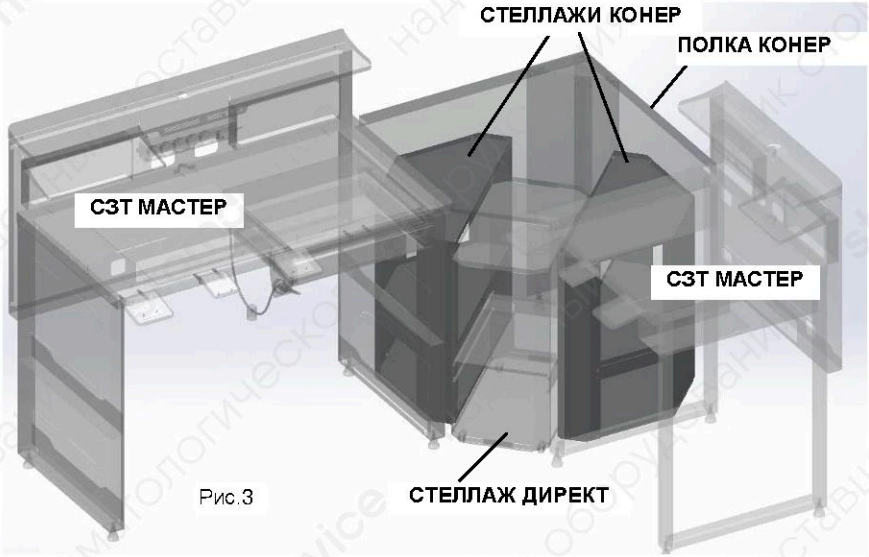


Рис.3

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02