
stomdevice



АВЕРОН

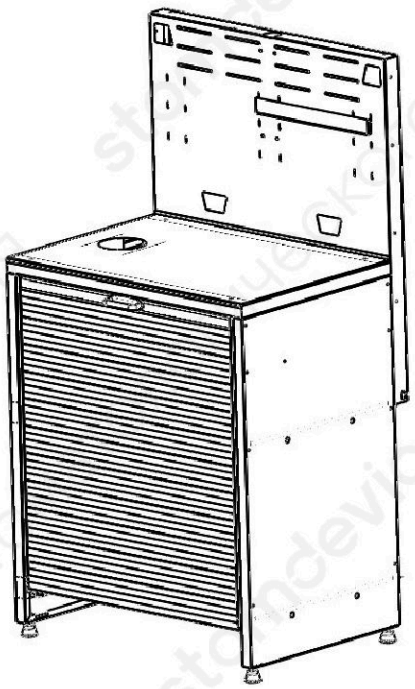

СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ лабораторный модель СУЛ 9.1 ГИПС

Этикетка
АВЕ 387.000.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ТС N RU D-RU.АИ16.В.02124 от 30.07.2015

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель СУЛ 9.1 ГИПС	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Стол универсальный лабораторный модель СУЛ 9.1 ГИПС (далее – **СУЛ**) предназначен для организации рабочего места по изготовлению гипсовых моделей в зуботехнических и литейных лабораториях. ТО 5621-39-52331864-2015.
Рекомендуется эксплуатировать совместно со следующей продукцией АВЕРОН (**⊠ - поставка по дополнительной заявке**):

- вакуумный смеситель СВЗ
- бункер для хранения и раздачи гипса БУНКЕР
- светильник люминесцентный ЛЮКС НЬЮ
- вибростолик портативный ВБ
- сменная емкость для сбора отходов КОНТЕЙНЕР 2.0 ОГП
- автономный фильтр-циклон АФЦ 1.0 МИНИ
- электроблок на 5 розеток с заземлением ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0
- подвесной ЛОТОК 1.0 МАСТЕР
- приставка, расширяющая полезную рабочую поверхность СТЕЛЛАЖ 9.1
- для соединения двух столов - полка прямая ПОЛКА 1.1 БРИДЖ
  - вертикальная панель ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ
  - вертикальная панель ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ БИГ

1.2 Особенности

- Материал столешницы – нержавеющая сталь.
- Отверстие в столешнице - для оперативного сбора отходов в установленную под ним емкость (не поставляется).
- Оптимальное крепление в пазах стенки с перфорацией дополнительного оборудования (БУНКЕР – до 3-х штук, СВЗ, ЛОТОК 1.0 МАСТЕР и пр.). «Окна» — для вывода кабелей, шлангов и пр.
- Удобная чистка шпателя о планку из нержавеющей стали.
- Возможность установки люминесцентного светильника, скрепления с СУЛ 9.1 МОЙКА, а также присоединения через ПОЛКА 1.1 БРИДЖ и ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ или 1.1 БРИДЖ БИГ, в т.ч. с подкатной тумбой.

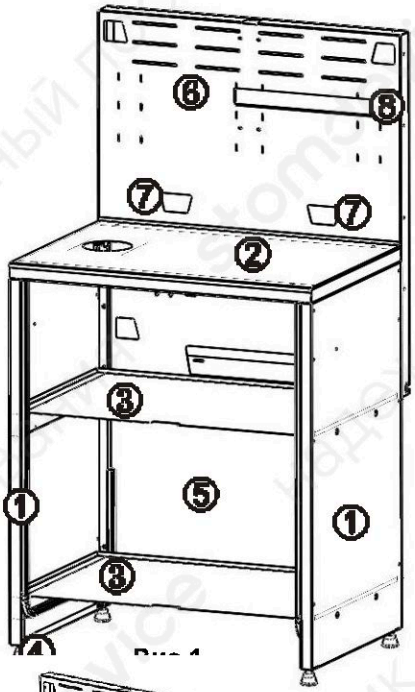


Рис.1

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

окружающая температура ..... 10...35°С
влажность при 25°С, не более..... 80%

2.2 Основные технические характеристики

габариты, не более .....790×600×1500 мм
столешница: ширина ..... 790 мм
глубина ..... 550 мм
высота над уровнем пола, не более ... 975 мм
масса, не более .....40 кг
максимальная нагрузка на столешницу ..... 100 кг
максимальная нагрузка на полку .....50 кг

2.3 Комплектность – согласно Упаковочному листу.

3 УСТРОЙСТВО

1 — Стойка боковая левая/правая
2 — Столешница с рамой
3 — Полка
4 — Ножки
5 — Стенка нижняя
6 — Стенка многофункциональная
7 — «Окна» для вывода кабелей, шлангов
8 — Рейлинг
9 — Жалюзи с ручкой
10 — Планка для чистки шпателя
А — Паз для проводов
АФЦ 1.0 МИНИ - ⊠ поставка по дополнительной заявке

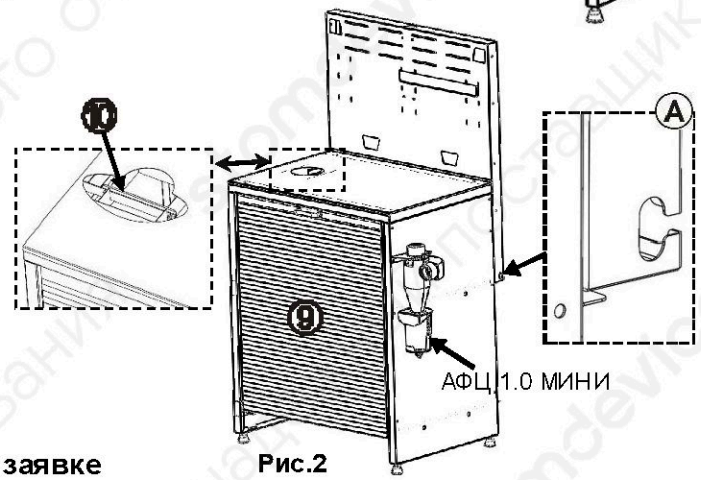


Рис.2

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Распаковать, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.

4.2 Собрать **СУЛ** в соответствии с рекомендациями, см. Приложение ПОРЯДОК СБОРКИ.

4.3 При необходимости, скомпоновать с другой имеющейся мебелью. Назначение установочных отверстий в боковых стойках и задней стенке – см. рис.3,4.

4.4 Пример скрепления с СУЛ 9.1 МОЙКА **(11)** – рис.5, через отв. в боковых стойках столов, рис.6,7, через ПОЛКА 1.1 БРИДЖ **(12)** и ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ **(13)** или 1.1 БРИДЖ БИГ **(15)**. Пример установки тумбы **(14)** – рис.7.

4.5 Разместить требуемые принадлежности, оборудование и приступить к работе.

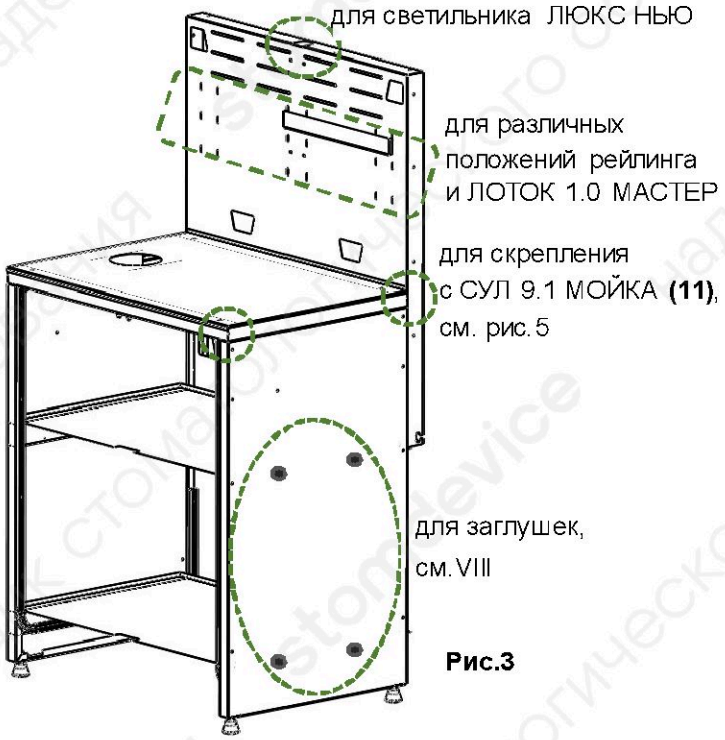


Рис.3

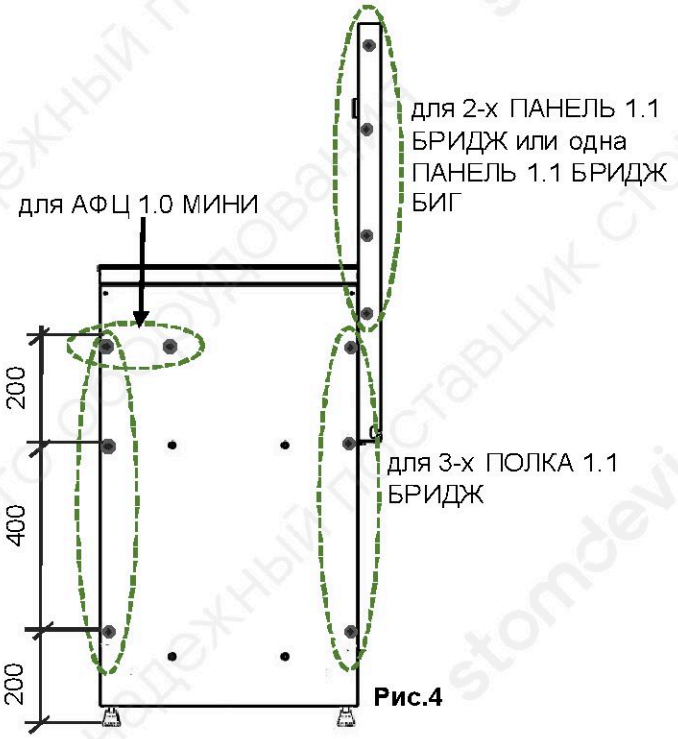


Рис.4

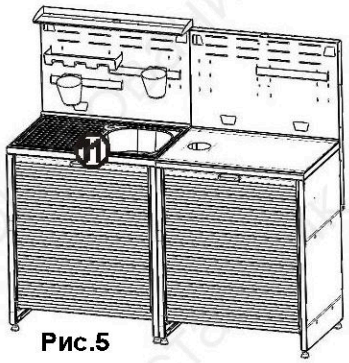


Рис.5

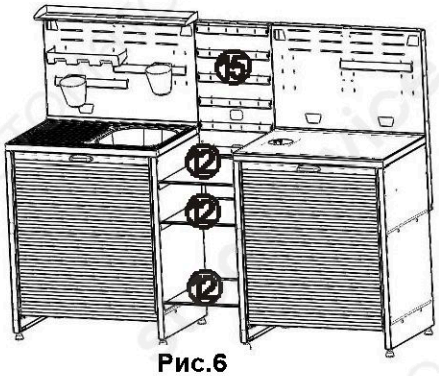


Рис.6


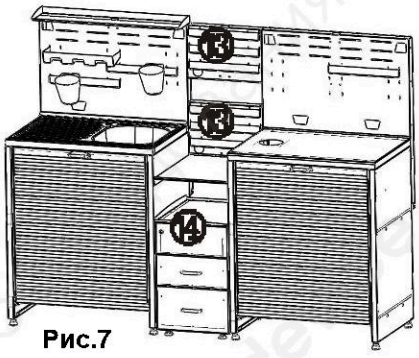


Рис.7

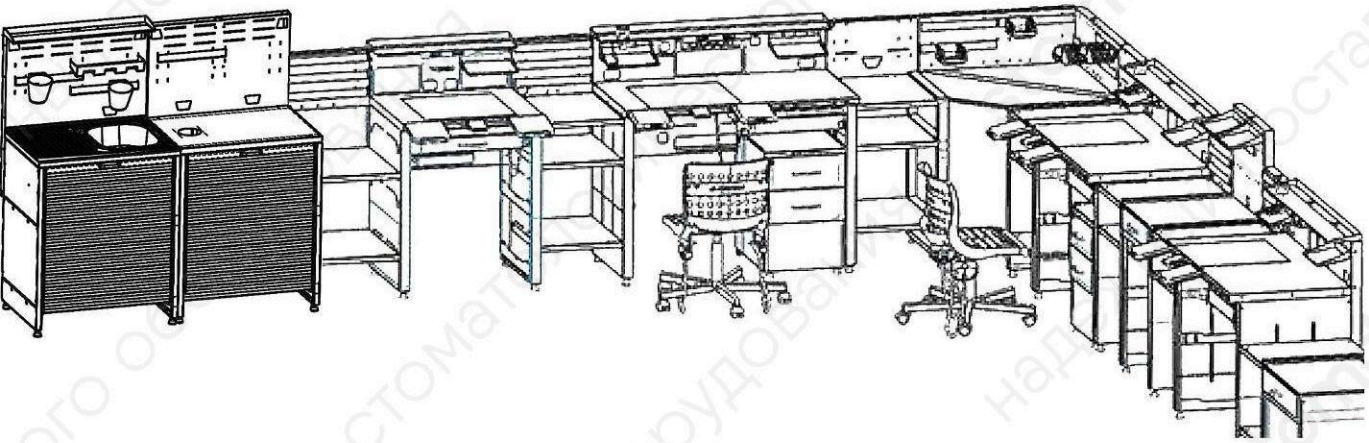

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для **СУЛ** установлены следующие виды ухода и техобслуживания, выполняемые персоналом, эксплуатирующим **СУЛ**, и содержащие операции:
— протирка внутренних, внешних поверхностей, в т.ч. столешницы от пыли влажной мягкой тканью (губкой);
— дезинфекция внутренних поверхностей и столешницы (дезинфицирующие растворы в соответствии с МУ 287-113-00).

ВНИМАНИЕ! **РЕКОМЕНДАЦИИ**


Для плавности хода жалюзи рекомендуется очищать и смазывать направляющие не реже 1 раза в месяц. Смазка - из комплекта поставки.
Допускается использование силиконовой смазки или технического вазелина.

Места, где обнаружена ржавчина, обработать автомобильным преобразователем ржавчины, например, «ЦИНКАРЬ», после чего промазать щели и стыки санитарным силиконовым герметиком.

6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

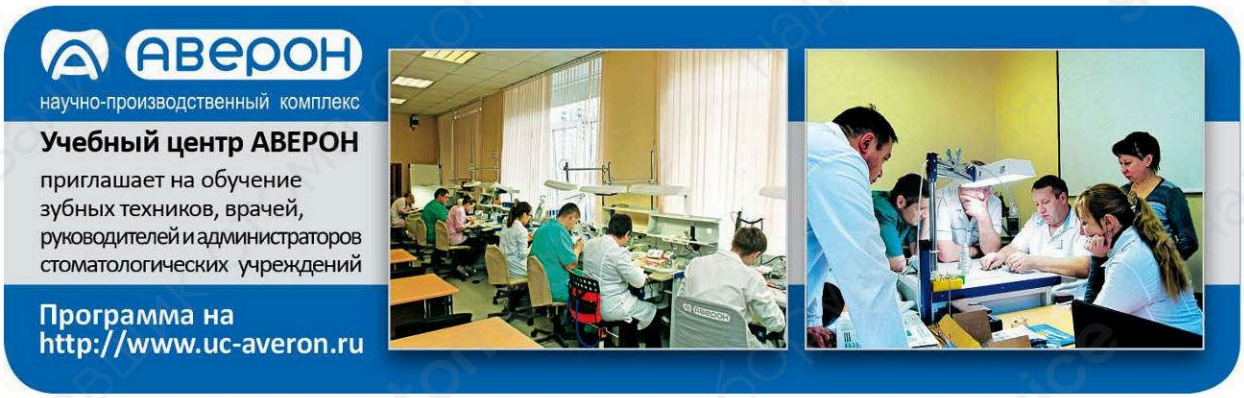

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ПОРЯДОК СБОРКИ

ВНИМАНИЕ! **РЕКОМЕНДАЦИИ**


При переворачивании конструкции во время сборки/разборки не прилагать чрезмерных усилий на стойки, соединенные с рамой.

Не затягивать крепеж в начале сборки (стойки, рама, задняя стенка и др. узлы) - наживить. После состыковки всех деталей окончательно протянуть крепления.

Для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертку).

Ⅰ

Поставить одну из боковых стоек **(1)** на передний торец




УСТАНОВИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ

Ⅱ


полку (3) верхнюю
Винты: М5×40 (2 шт)
Шайбы: 5 (2 шт)

полку (3) нижнюю
Винты: М5×40 (2 шт)
Шайбы: 5 (2 шт)

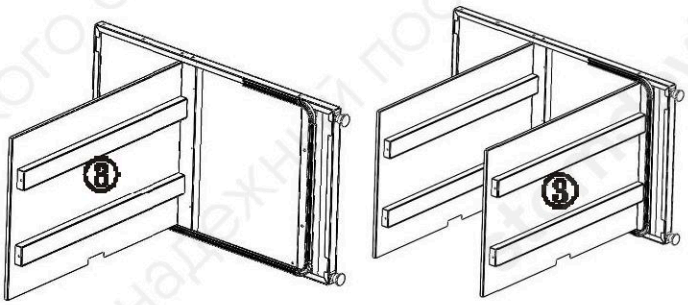

Ⅲ


вторую боковую стойку
Винты: М5×40 (2 шт)
Шайбы: 5 (2 шт)

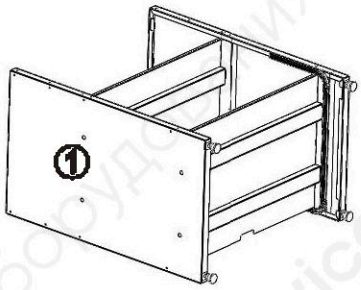

Ⅳ

стенку (5) нижнюю
Винты с п/ш М5×10 (4 шт)

стенку (6) многофункциональную
Винты с п/ш М5×10 (6 шт)

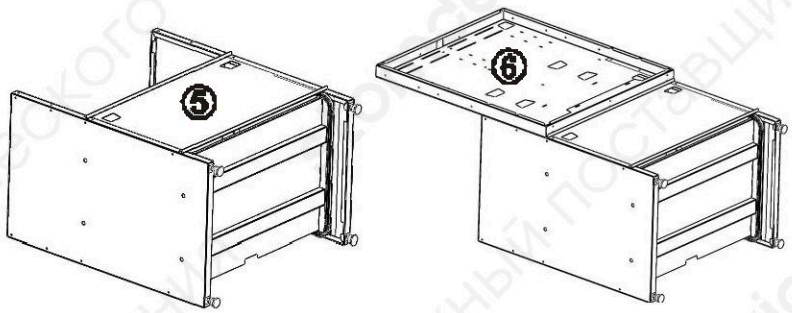

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

Ⓥ

Перевернуть и установить СУЛ на ножки.

Жалюзи **(9)** установить в направляющие, ориентировать ручкой наружу, край жалюзи с ручкой ориентировать в направлении ответных фиксаторов на раме - см. следующий пункт сборки.

НЕ УДАЛЯТЬ ДВЕ ПОЛОСЫ СКОТЧА
НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЖАЛЮЗИ!
ОНИ СКРЕПЛЯЮТ ЛАМЕЛИ ЖАЛЮЗИ МЕЖДУ СОБОЙ!

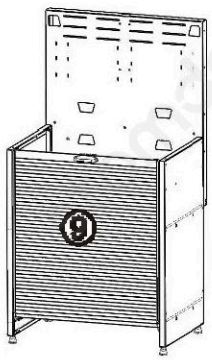

При необходимости настроить фиксаторы жалюзи, для этого:

— фиксаторы на обратной стороне жалюзи ослабить и сместить вверх по пазам. При закреплении выставить их параллельно ответным фиксаторам на раме;

— ответные фиксаторы на раме отрегулировать по направлению к фиксаторам на жалюзи.

Ⓥ

Раму со столешницей

к боковым стойкам в местах, указанных на рис. А


Винты с п/ш М5×10 (2 шт)

к задней стенке

Винты с п/ш М5×10 (3 шт)

Рекомендуется снять защитную пленку со столешницы





Ⓥ


Обезжирить стык между задней стенкой и столешницей. Снять подложку с бордюрной ленты и уплотнить этот стык.

Установить автономный фильтр-циклон АФЦ 1.0 МИНИ, справа/слева, поставка по дополнительной заявке.

Установить рейлинг **(8)** и другое необходимое оборудование.

◌ заглушки




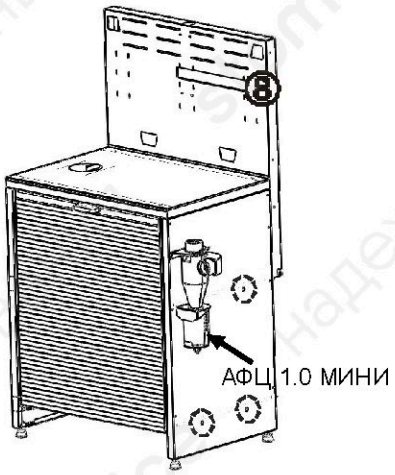

ПОДТЯНУТЬ ВЕСЬ КРЕПЕЖ, УСТАНОВИТЬ ЗАГЛУШКИ (8 шт., см. Ⅶ).

Отрегулировать вращением ножек устойчивое положение стола.

Для защиты от грязи рекомендуется размещать электроблок (не входит в комплектацию) под столешницей, если он применяется для подключения к сети используемых электроустройств (светильник, смесители, вибростолики и пр.). Варианты размещения электроблока на многофункциональной стенке под столешницей:

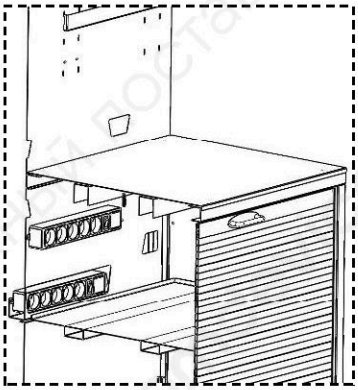

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ