
stomdevice

РАЗРАБОТКА ВЕГА-ПРО ПРОИЗВОДСТВО

АВЕРОН

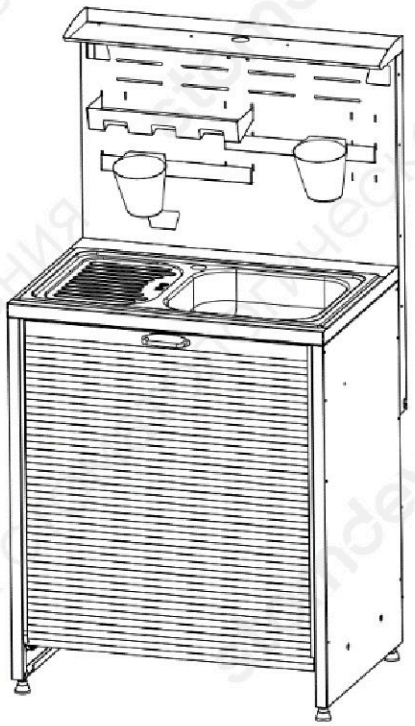

СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ лабораторный модель СУЛ 9.1 МОЙКА

Этикетка
АВЕ 409.000.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ТС N RU D-RU.АИ16.В.02124 от 30.07.2015

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель СУЛ 9.1 МОЙКА	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Стол универсальный лабораторный модель СУЛ 9.1 МОЙКА (далее – **СУЛ**) - предназначен для организации рабочего места по изготовлению гипсовых моделей в зуботехнических и литейных лабораториях. ТО 5621-39-52331864-2015.

Рекомендуется эксплуатировать совместно со следующей продукцией АВЕРОН (✉ **- поставка по дополнительной заявке**):

- светильник светодиодный ЛЮКС ЛЕД
- отделитель гипса проточный ОГП 2.0
- автономный фильтр-циклон АФЦ 1.0 МИНИ
- электроблок на 5 розеток с заземлением ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0
- подвесные ЛОТОК 1.0 МАСТЕР (устанавливается на рейлинг)
- приставка, расширяющая полезную рабочую поверхность СТЕЛЛАЖ 9.1
- для соединения двух столов - полка прямая ПОЛКА 1.1 БРИДЖ
  - вертикальная панель ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ

1.2 Особенности

- Полностью металлическая конструкция с полимерным покрытием, рис.1.
- Стационарная верхняя полка ПОЛКА 9.1.
- Съемная корзина.
- Пазы на задней стенке для крепления дополнительного оборудования и перестановки корзины.
- Отсек с элементами водоотвода отделен перегородкой от мест хранения материалов, принадлежностей, инструмента и др.
- Съемная внутренняя полка для хранения.
- Удобные пластиковые жалюзи легко открываются и фиксируются в закрытом положении.
- Возможность установки светильника, скрепления с СУЛ 9.1 ГИПС рис.4 или присоединения через ПОЛКА 1.1 БРИДЖ и ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ рис.5,6, в т.ч. с подкатной тумбой.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

окружающая температура .....10...35°С
влажность* при 25°С, не более.....80%

* - не регламентируется на мойку и элементы водоотвода

2.2 Основные технические характеристики

габариты, не более .....790x600x1540 мм
столешница:
ширина/глубина/высота над уровнем пола ....790/550/975 мм
масса, не более .....46 кг

2.3 Комплектность – согласно Упаковочному листу.
Смеситель в комплект поставки не входит.

3 УСТРОЙСТВО, рис.1

1 — Полка верхняя ПОЛКА 9.1
2 — Корзина для емкостей
3 — Стенка задняя многофункциональная
4 — Рейлинг
5 — Контейнер
6 — Рама с мойкой
7 — Полка малая
7а — Полка малая съемная
8 — Стойка левая
9 — Стойка правая
10 — Перегородка
11 — Заглушка
12 — Жалюзи с ручкой
13 — Ножки
14 — Полка нижняя
15 — Стенка нижняя
16 — Фильтр-циклон АФЦ 1.0 МИНИ (✉ **- поставка по дополнительной заявке**)
А — Паз для проводов



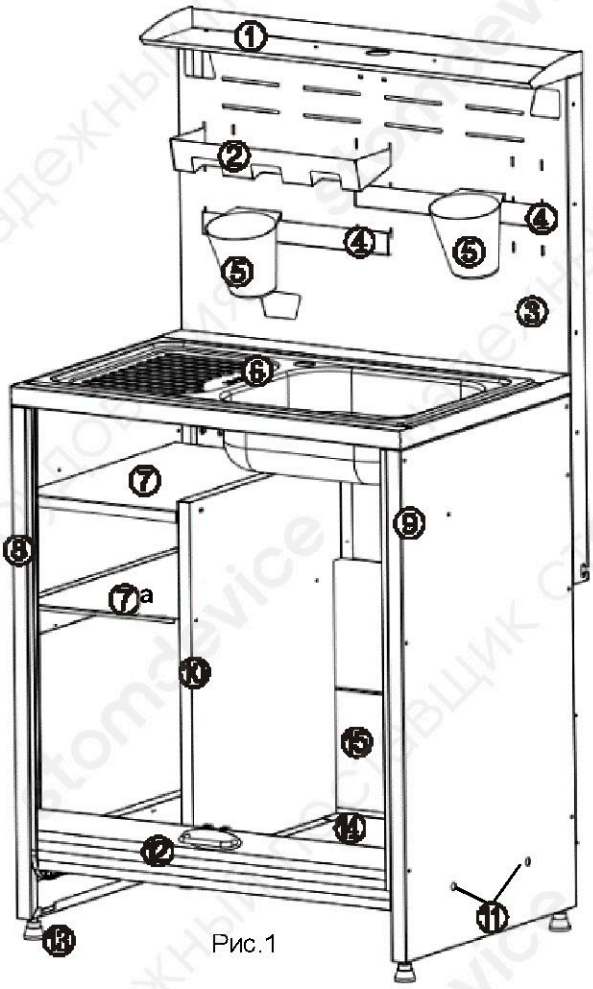


Рис.1

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

stomdevice

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Распаковать, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.

4.2 Собрать **СУЛ** в соответствии с рекомендациями, см. Приложение ПОРЯДОК СБОРКИ.

4.3 При необходимости, скомпоновать с другой имеющейся мебелью. Назначение установочных отверстий в боковых стойках и задней стенке – см. рис.2,3.

4.4 Пример скрепления с СУЛ 9.1 ГИПС – рис.4, через ПОЛКА 1.1 БРИДЖ и ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ (2 шт) - рис.5,6. Пример установки тумбы – рис.6.

4.5 Разместить требуемые принадлежности, оборудование и приступить к работе.



Рис.2

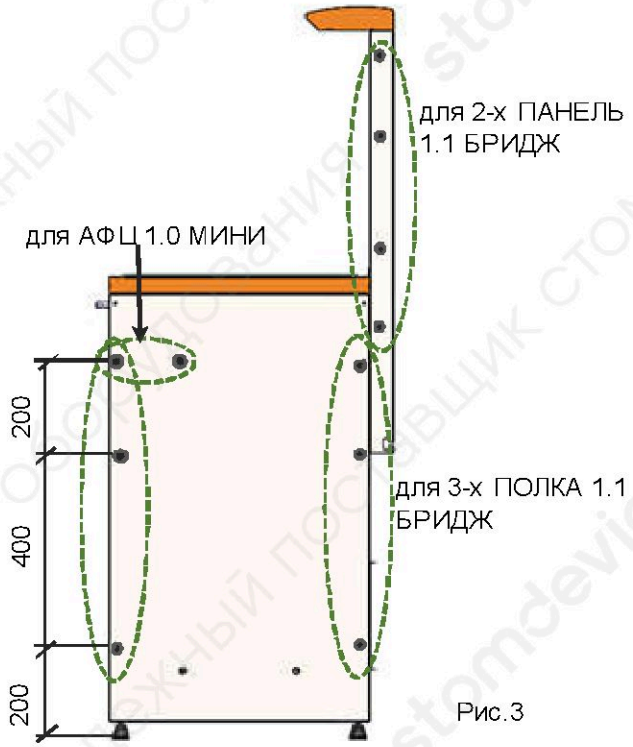
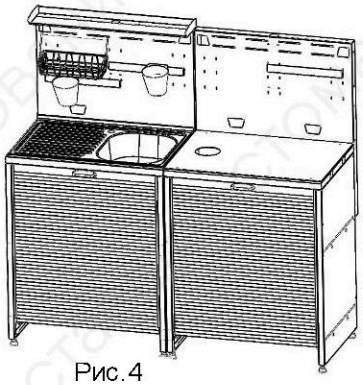
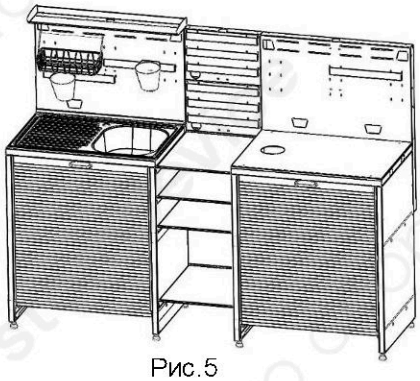
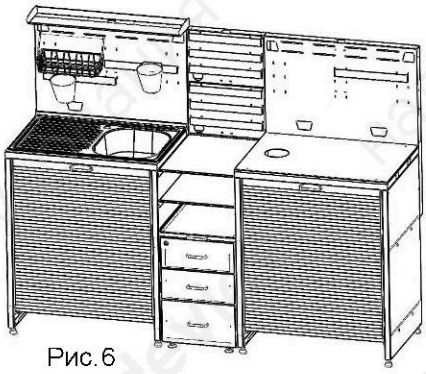
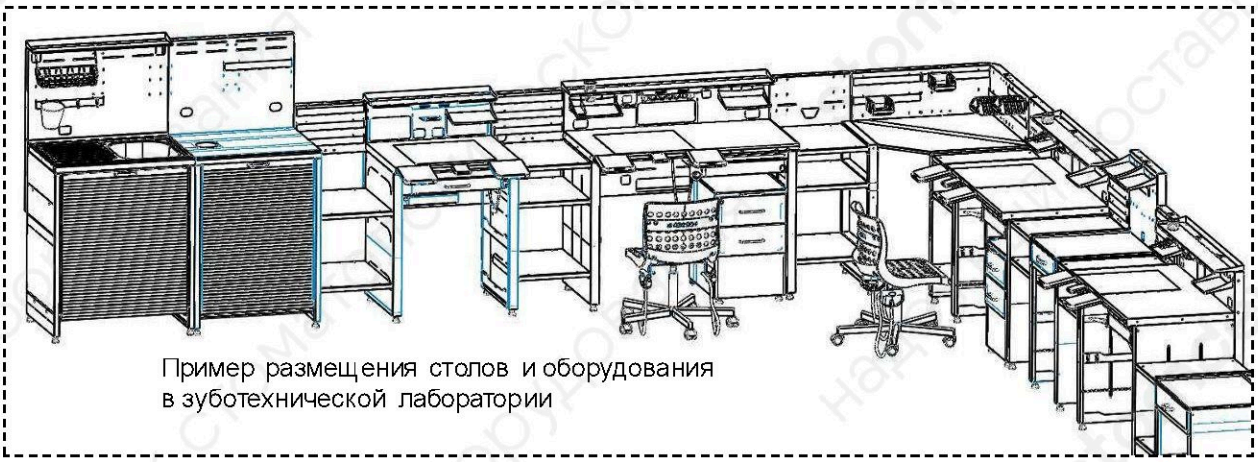


Рис.3


Рис.4


Рис.5


Рис.6


Пример размещения столов и оборудования в зуботехнической лаборатории

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для **СУЛ** установлены следующие виды ухода и техобслуживания, выполняемые персоналом, эксплуатирующим **СУЛ**, и содержащие операции:

– протирка внутренних, внешних поверхностей, в т.ч. столешницы от пыли влажной мягкой тканью (губкой);

– дезинфекция внутренних поверхностей и столешницы (дезинфицирующие растворы в соответствии с МУ 287-113-00).

ВНИМАНИЕ! **РЕКОМЕНДАЦИИ**

Для плавности хода жалюзи рекомендуется очищать и смазывать направляющие не реже 1 раза в месяц. Смазка - из комплекта поставки.
Допускается использование силиконовой смазки или технического вазелина.


Места, где обнаружена ржавчина, обработать автомобильным преобразователем ржавчины, например, «ЦИНКАРЬ», после чего промазать щели и стыки санитарным силиконовым герметиком.

6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

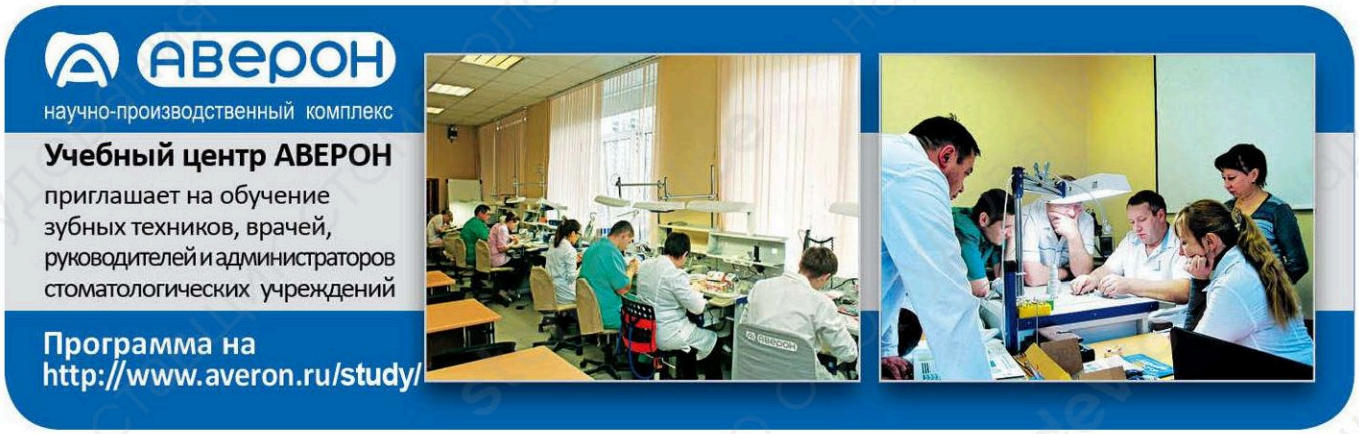

stomdevice

ПОРЯДОК СБОРКИ


ВНИМАНИЕ! **РЕКОМЕНДАЦИИ**

При переворачивании конструкции во время сборки/разборки не прилагать чрезмерных усилий на стойки, соединенные с рамой.

Не затягивать крепеж в начале сборки (стойки, рама, задняя стенка и др. узлы) - наживить. После состыковки всех деталей окончательно протянуть крепления.

Для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертку).

Поставить боковую стойку **(8)** на передний торец




УСТАНОВИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ

Ⅰ

стойки **(8,9)** с нижней полкой **(14)**


винты М5х40 (4 шт)
шайбы 5 (4 шт)

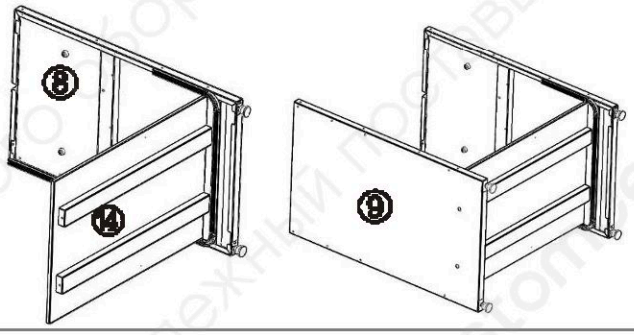

Ⅱ

стенку заднюю нижнюю **(15)** к стойкам
винты п/ш М5х10 (4 шт)
стенку многофункциональную **(3)** к стойкам


винты п/ш М5х10 (4 шт)

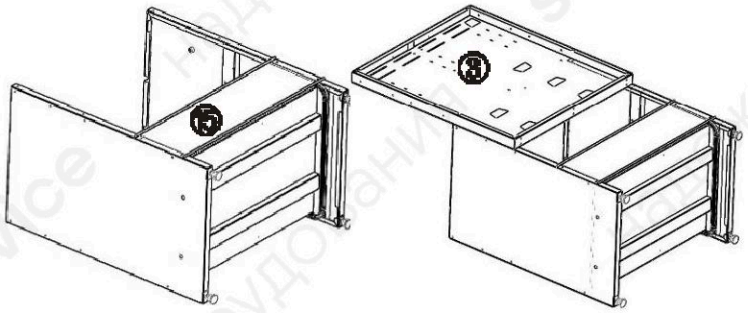

Ⅲ

Перевернуть и установить СУЛ на ножки.

Жалюзи **(12)** установить в направляющие, ориентировать ручкой наружу, край жалюзи с ручкой ориентировать в направлении ответных фиксаторов на раме **(6)** - см. следующий пункт сборки.

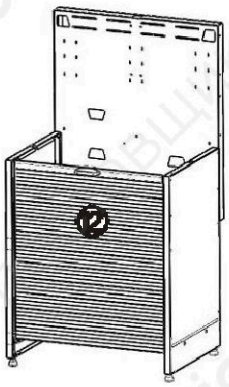

НЕ УДАЛЯТЬ ДВЕ ПОЛОСЫ СКОТЧА
НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЖАЛЮЗИ!
ОНИ СКРЕПЛЯЮТ ЛАМЕЛИ ЖАЛЮЗИ МЕЖДУ СОБОЙ!

При необходимости настроить фиксаторы жалюзи, для этого:
— фиксаторы на обратной стороне жалюзи ослабить и сместить вверх по пазам. При закреплении выставить их параллельно ответным фиксаторам на раме;
— ответные фиксаторы на раме отрегулировать по направлению к фиксаторам на жалюзи.

УСТАНОВИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ


Ⅳ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

раму с мойкой **(6)** к боковым стойкам **(8,9)** в местах, указанных на рис. А, винты п/ш М5х10 (2 шт), к задней стенке **(3)**, винты п/ш М5х10 (3 шт).

Обезжирить стык между стенкой **(3)** и рамой **(6)** с мойкой. Снять подложку с бордюрной ленты и уплотнить этот стык.



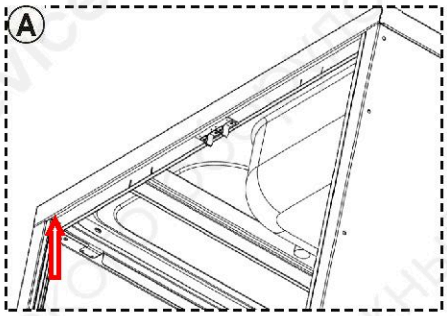



Ⅴ

перегородку **(10)** к нижней полке **(14)**, многофункциональной стенке **(3)** винты п/ш М5х10 (4 шт).

полку **(7)** к перегородке **(10)** и боковой стойке **(8)** винты М5х10 – 4шт.

поставить съемную малую полку **(7а)**.



Ⅵ

Установить верхнюю полку **(1)**, винты п/ш М5х10 (4 шт).

ПОДТЯНУТЬ ВЕСЬ КРЕПЕЖ.

Отрегулировать вращением ножек устойчивое положение стола.

Установить заглушки **(11)** в отверстия на стойках.

Закрепить сифон на мойке. При необходимости, установить смеситель (не входит в комплект поставки).

Закрепить ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 (поставка по дополнительной заявке).

Установить автономный фильтр-циклон АФЦ 1.0 МИНИ **(16)**, справа/слева (поставка по дополнительной заявке).

Установить под мойку ОГП 2.0 **(17)** (поставка по дополнительной заявке).

Установить в пазы рейлинги **(4)**. Для более надежной фиксации в пазах язычки зацепов сзади чуть отогнуть в сторону.

Установить корзину **(2)**, контейнеры **(5)**.



