

Краткая инструкция по обслуживанию

① Кнопка управления скоростью вращения: включение микромотора/ увеличение скорости вращения.
② Кнопка охлаждающей жидкости: кнопке охлаждающей жидкости можно присвоить два рабочих режима. В зависимости от установленного режима работы кнопка управления подачей охлаждающей жидкости имеет следующие функции:
короткое нажатие – включение/выключение расхода охлаждающей жидкости или
короткое нажатие – настройка расхода охлаждающей жидкости от 0 до 110 мл/с (4 ступени).
Длительное нажатие – активирование функции промывки вручную.
③ Кнопка выбора этапа программы:
короткое нажатие – переход к следующему этапу программы.
Длительное нажатие – возврат к предыдущему этапу программы.
④ Кнопка направления вращения микромотора: настройка направления вращения микромотора.



Присоединение комплекта шланга

1. Закройте зажим для шланга ⑦.
2. Закрепите шланг охлаждающей жидкости ① на прямом или угловом наконечнике.
3. Плотно закрепите зажимы ② на проводе микромотора.
4. Вставьте и защелкните переходник ③ для шланга.
5. Подсоедините шланг к насосу (расстояние между разъемом и входом насоса ④ должно составлять приблизительно 1 см) и заблокируйте насос.
6. Вставьте иглу-наконечник ⑥.
7. Откройте зажим ⑦ для шланга.

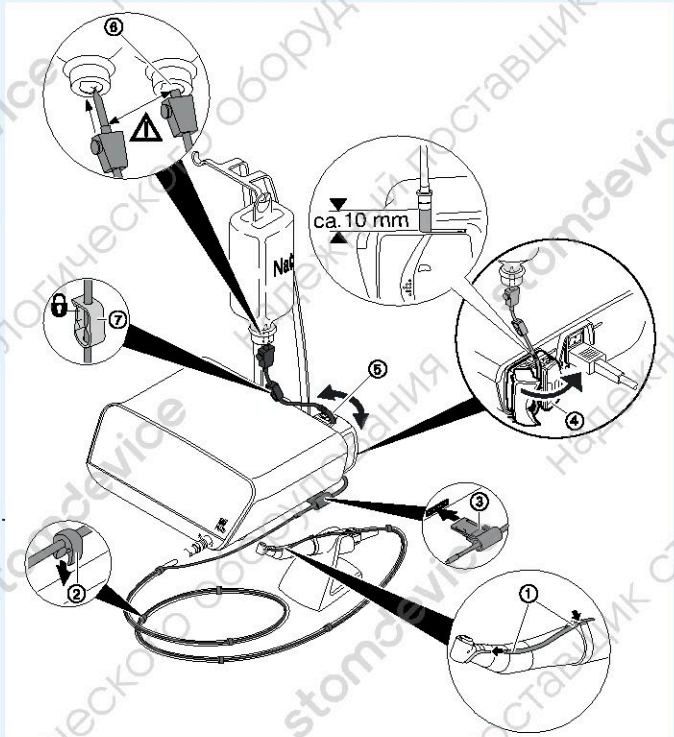

Указание


Открывать вентиляционное отверстие на игле-наконечнике ⑥ только при использовании стеклянных бутылок.

ОСТОРОЖНО

Эта краткая инструкция содержит описание только наиболее важных функций по обслуживанию системы. Перед первым использованием, а также перед использованием лицами, не имеющими опыта работы с этим изделием, необходимо прочесть и строго соблюдать входящую в комплект поставки инструкцию по эксплуатации.

KaVo. Dental Excellence.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

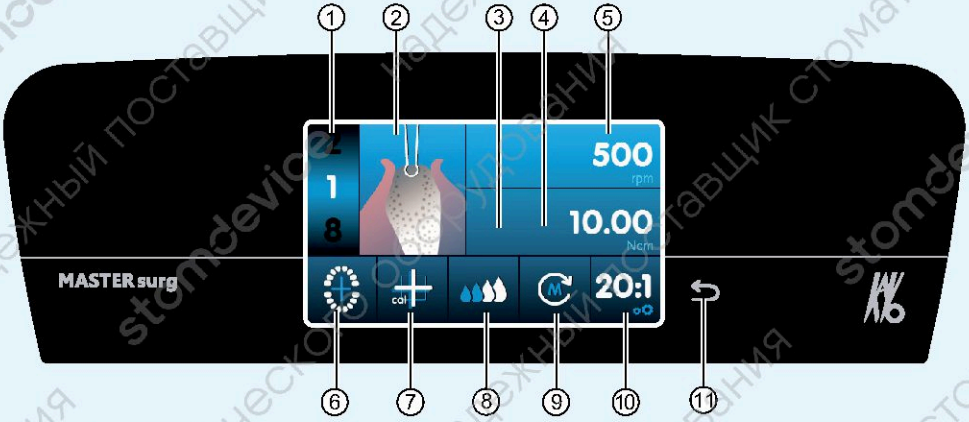

① Этап программы (от 1 до макс. 10)
② Графическое представление действия
③ Максимальный вращающий момент (отображается не для всех действий)
④ Ограничение вращающего момента
⑤ Скорость вращения
⑥ Индикация состояния беспроводного блока ножного управления/ввод позиции имплантата
⑦ Активация калибровки нажатием одной кнопки
⑧ Настройка расхода охлаждающей жидкости
⑨ Направление вращения микромотора
⑩ Передаточное отношение
⑪ Кнопка «Назад»

Изменение параметров и выполняемых операций

Выбор настройки аппарата
Нажмите и отпустите кнопку «Назад» ⑪, чтобы перейти к программе хирургического вмешательства или в меню выбора программы.
Длительное нажатие служит для вызова настроек аппарата.



Выбор или изменение параметра или действия
Функции ④ и ⑤: меняются перемещением регулятора вправо или влево или прикосновением к символам «+»/«-».

Функции ①, ⑧, ⑨ и ⑩: меняются непосредственно при прикосновении к соответствующей экранной кнопке.

Функции ②, ⑥ и ⑦: меняются в появляющемся диалоговом окне.

Сохранение происходит автоматически при закрытии окна параметра или вида операции.

Ограничение числа этапов программы
Нажмите номер этапа программы после последнего выбранного действия и выберите символ флажка.



Отмена ограничения числа этапов программы
Выберите этап программы с символом флажка и присвойте новое действие.

Индикация вращающего момента и документирование
Только при включенной функции документирования вращающий момент отображается в действии «Установка имплантата» в виде графика и сохраняется на SD-карте.

KaVo. Dental Excellence.

1.010.9701 · ly · 20170208 – 03 · ru
KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Tel. +49 (0) 7351 56-0 · Fax +49 (0) 7351 56-1488 · www.kavo.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ