stomdevice

KaVo PRIMUS 1058 S/TM/C/G

КраткоеS руководствоS поSэксплуатациииэ



KaVo. Dental Excellence.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВйЬьнSТых юъ ицьфSЭЛЕИлЗлСэ

ДанноеSкраткоеSруководствоSпоSэксплуатацииSсодержит описаниеSтолькоSсамыхSсущественныхSфункцийSуправления аппаратомзSОноSнеSзаменяетSРуководствоSпоSэксплуатациис входящееSвSкомплектSпоставкизSПоследнееSнеобходимо обязательноSсоблюдатьSвоSизбежаниеSвозникновенияSнеполадокSи поломокэ

КреслоSпациента

ЗапоминаниеS автоматическогоS положенияSкреслаэ

КлавишамиSили сSпомощьюS многофункциональногоS ножногоSблокаSуправленияS ткогдаSинструментыS находятсяSнаSдержателеуS установитеSкреслоSвS нужноеSположениеэ

КраткоSнажмитеS клавишуSТлКГэ

СветовыеSиндикаторыS мигаютSпримерноSчетыреS секундыSиSудерживайтеS необходимуюSклавишуS примерноSнаSсекундыS доSтехSпорSпокаSнеS прозвучитSсигналэ

ПрограммированиеS клавишSAPSSпомощьюS многофункциональногоS блокаSножногоSуправленияэ

НажавSнаSпедальSиSклавишуS APSдополнительноSнажмитеS выбраннуюSклавишуSнаS модулеSврачаSилиS ассистентаSиS удерживайтеSихSдоSтехS порSпокаSнеSпрозвучитS акустическийSсигналэ

МодульSуправления



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


ВйЬнSТ ых ю ъ ицьфъSЭлЕИ лЗ лСэ

КреслоSпациента

ВызовSавтоматическиS установленныхS положенийSкреслаэ

МодульSврачаSиSмодульS ассистентаSзчх онъяя

КратковSнажмитеSклавишуSТГ лКГэ

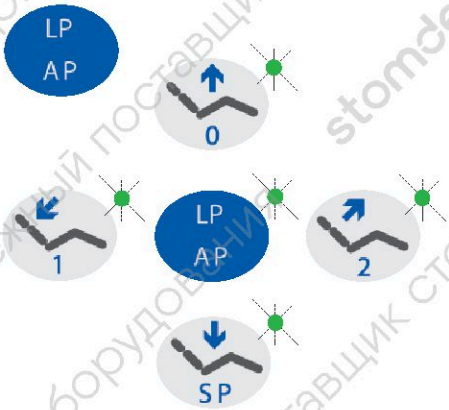

СветовыеSиндикаторыSмигаютS примерноSчетыреSсекундыSBSэтоSвремяSнажмитеS необходимуюSклавишуSКГэ

МодульSассистентаS врачаSЭэйцмйыя

КоротковSнажатьSнаSджойстикэ СветовыеSиндикаторыSнаS модулеSврачаSмигаютSпримерноS четыреSсекундыSBSтечениеSэтогоS времениSнажатьSнаSджойстикSBS соответствующемSнаправлениияэ



или

ТакSможноSвыбратьSавтоматическиS установленноеSположениеSкреслаS когдаSвсеSинструментыSнаходятсяS вSдержателеэ



ПриSповернутомSмодуле возможностьSперемещенияSкресла ограниченаэ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВйЬнSТьюх юъ ицьфSЭЛЕИлЗлСэ

ВыборSпамяти ВрачSи л ВрачSк

когдаSинструментыSнаходятсяS вSдержателе

ПереключениеSнаSмногофункциональном ножномSблокеSуправленияя

НажатьSнаSпедальSиSудерживаяSеесS задействоватьSкобуSвыключательэ

или


ПереключениеSнаSмодулеSуправления ИнхчьшнмЯ

УдерживатьSклавишуS предварительнойSустановкиSуровняS доSтехSпорSпокаSнеSпрозвучитSсигналэ

ВыборSпамятиSдляS ВрачаSи


ВыборSпамятиSдляS ВрачаSк


МодульSуправленияЯл Индикатор

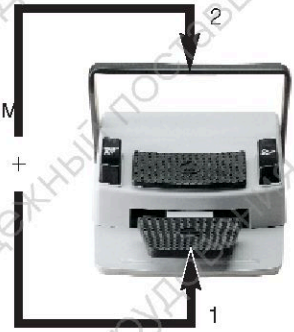





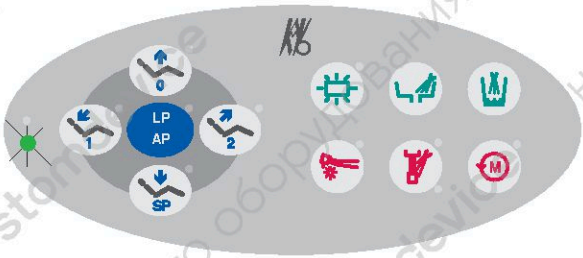

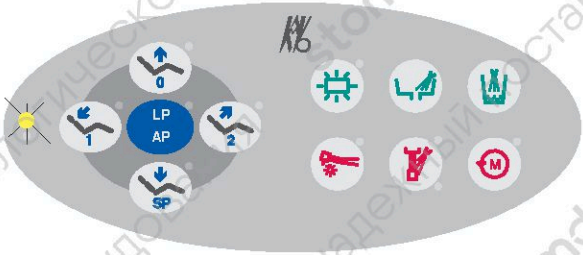

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ВйЬнSТьох ю ъ ицьфъSЭлЕИлЗлСэ

Инструменты

МодульSуправлениял Индикатор



или

УстановкаSрежимаS охлажденияэ

СнятьSинструментSSдержателяэ



РежимSохлажденияSаэрозоль



ЗанесениеSSSпамятьSчрцнSйцпнкйюэнцS
Инх чьшннмуя

НажатьSклавишуSТГлКГS
иSудерживатьSееSдоSтехS
порSSпокаSнеSпрозвучитS
сигналSSинструментSприS
этомSдолженSбытьSснятSSS
держателяэ





ЗанесениеSSSпамятьSхSSйцпнкйюэнх S
Инх чьшннмуя

НажатьSклавишуSпредварительнойS
установкиSуровняSиSудерживатьS
ееSдоSтехSпорSSпокаSнеSпрозвучитS
сигналSSинструментSприSэтомS
долженSбытьSснятSSSдержателяэ





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


ВйЬнSТьх ю ъ ицьфSЭЛЕИлЗлСэ

Инструменты

МодульSуправлениялS Индикатор

ВключениелвыключениеS подсветкиSинструментовЗиS регулировкаSинтенсивностиS подсветкиэ

СнятьSинструментSSдержателяSкратко нажатьSклавишуSпредварительнойSустановки подсветкиSинструментовэ



ПодсветкалS ВклэS

Интенсивностья тесли$ие$Sустановлен$блок Инх чьшнм

х оцэ



УдерживатьSклавишу предварительнойSустановки подсветкиSинструментовэ

ЗанесениеSSSпамятья

НажатьSклавишуSТлКГЗиS удерживатьSееSдоSтехSпорS показ$ие$Sрозвучит$сигнал$ЗS инструмент$при$Этом$должен$S быть$снят$S$держателяэ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ВйЬнSТыох ю ъ ицьфъSЭлЕИлЗлСэ

Регулировка интенсивности подсветки

Модуль Управления Индикатор

уровеньS с SиSжSь
тесли Установлен Блок Ин х чьшнму


Снять Sинструмент Sс Sдержателя э
Нажимать Sклавишу Sвыбора Sуровня Sдо S
тех Sпорс Sпока Sне Sпрозвучит Sсигнала S



КратковSкSразаSнажать Sклавишу
установки Sуровня э



Интенсивность Sподсветки S
регулируется Sпо Sцs Sступенямs э
помощью Sклавиш S Плюс Sили
Минус э

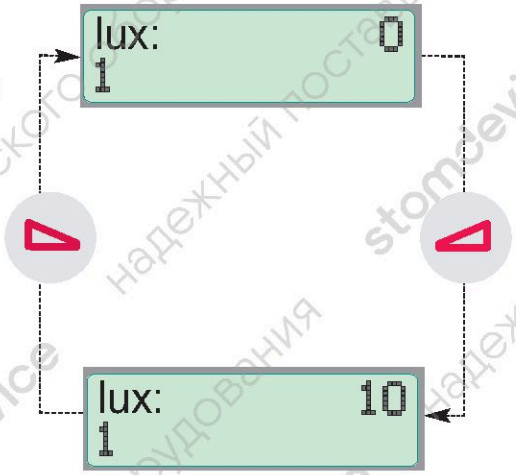

Занесение Sв Sпамять

Нажимать Sклавишу Sвыбора Sуровня Sдо S
тех Sпорс Sпока Sне Sпрозвучит Sсигнала э



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ВйЬнSТых юъ ицьфЭЛЕИлЗлСэ

РегулированиеSчислаSоборотовSтурбиныэ

МодульSуправлениялS Индикатор


тесли Sустановлен Sблок SИнх чьшнмуSуровень SиSжS

СнятьSинструментSSдержателяэ



НажиматьSклавишуSвыбораSуровняSдоS техSпорSпокаSнеSпрозвучитSсигналэ

ПереключениеSрежимовS Максимум S иS Ручной SсуществляетсяSSпомощью клавишS Плюс SиS Минус э

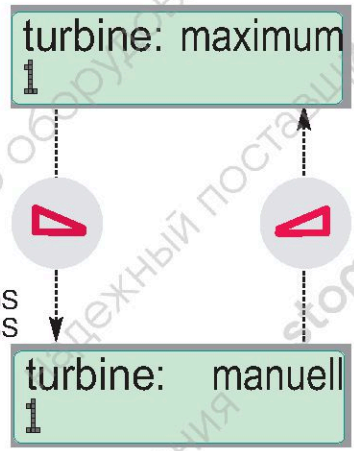

РежимS Максимум я
ПриSлюбомSположенииSпедалиSтурбинаS всегдаSработаетSSмаксимальнымS числомSоборотовэ

РежимS Ручной я
CSпомощьюSпедалиSмногофункциональногоS блокаSножногоSуправленияSможноSвыбратьS числоSоборотовSтSихццццSмингиSлевый упорS
педалиуSдоSццццSмингиSправыйSупор педалиуэ

ЗанесениеSSпамятья


НажиматьSклавишуSвыбораSуровняSдоS техSпорSпокаSнеSпрозвучитSсигналэ




УстановкаSлевогоS вращенияSдвигателяэ



или



РежимSлевогоSвращенияS двигателяSS Вклэ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ВйЬнSТьох ю ъ ицьфъSЭлЕИлЗлСэ

РегулированиеSчислаS оборотовSдвигателяSп НастройкаSинтенсивностиS ГАквЬЬлйфы ЗЬИшЬКФЕмыянSкццSач

тесли Установлен Блок Инх чьшнму Уровень ниже

СнятьSдвигательSс ГАквЬЬлйфы НажатьSклавишуSвыбораS уровняSиSудерживатьSеёSдоS техSпорS показаниеSпрозвучитSсигналэ

ПараметрSможетSбытьS изменен SпомощьюSклавишиS Плюс SилиS Минус э

РежимS Минимум я ДвигательSкSвццSмингп ДвигательSвТчSвццSмингп

РежимS Максимум я ДвигательSвSиSдвигатель ВТчSвццццSмингп


ГАквЬЬлйфы ЗЬИшЬКФЕмыянSкццSач

МинимумSяSиSSМаксимумSвц ВеличинаSшагаSсоставляетS цожьэ

ЗЬИшЬКФЕмыянSкццSач ИцSиS ьцэцццS цпи Ий SцSкццэцццS цпи

ЗанесениеSвSпамятьэ

НажатьSклавишуSвыбораSуровняS иSудерживатьSеёSдоSтехSпорS показаниеSпрозвучитSсигналэ

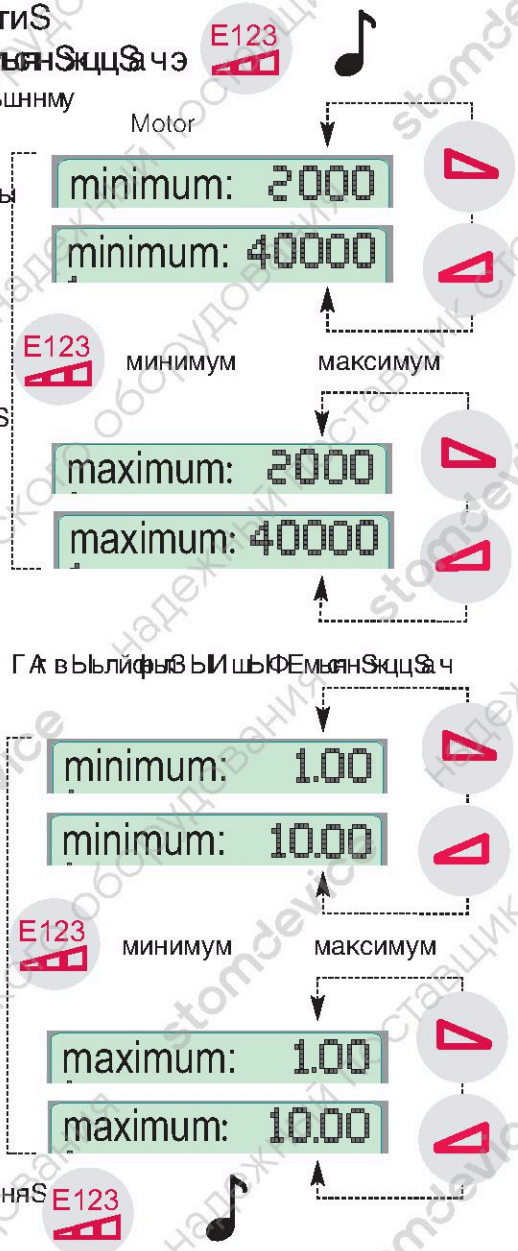

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ВЙЬнЅТых юъ ицьфЅЭЛЕИлЗлСэ

ВКЛлВЫКЛЅфункций подогреваЗиЅподсветки дляЅмногофункциональногоЅ шприцаэ

МодульЅуправленияЛ
Индикатор

НастройкаЅнаЅмодулеЅврачаэ

СнятьЅмногофункциональныйЅшприцЅс держателяэ
ПереключательЅдержателяЅактивируетсяэ



НажатьЅклавишуЅпредварительнойЅустановкиЅ подачиЅпреяЅ
или
нажатьЅклавишуЅпредварительнойЅ установкиЅподачиЅпреяЅнаЅмногофункциональнойЅ ножнойЅпедалиэ



или



ГоритЅсветовойЅиндикаторЯфункцииЅ подогреваЗиЅподсветкиЅдляЅ многофункциональногоЅшприцаЅмодуляЅ врачаЅпредустановленыэ



ЗанесениеЅвЅпамятьЯ

НажатьЅклавишуЅТЛКГЗиЅ удерживатьЅееЅдоЅтехЅпорЅ покаЅнеЅпрозвучитЅсигналЅиЅ инструментЅприЅэтомЅдолженЅ бытьЅснятЅсЅдержателяэ



ВремяЅостаточногоЅсвеченияЗиЅинтенсивностьЅподсветки неизменныэ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВйЬнSТьюхюъ ицьфъSЭлЕИлЗлСэ

ВКЛлВЫКЛЗфункций подогреваЗиЗподсветки дляЗмногофункциональногоS шприцаэ

МодульЗуправлениялИндикатор

НастройкаЗнаЗмодулеЗассистентаЗзчхсньэ



СнятьЗмногофункциональныйЗшприцS держателяэ
КратковременноЗнажатьЗклавишуЗподачиS воздухаЗилиЗводыэ
НажатьЗклавишуЗпредварительнойS установкиЗраспыленияЗаэрозоля или клавишуЗпредварительнойS установкиЗраспыленияЗаэрозоляS наЗмногофункциональномЗблокеS ножногоЗуправленияэ



или



ГоритЗсветовойЗиндикаторяS предустановленаЗфункцияS подогреваЗдляS многофункциональногоЗшприцаS модуляЗассистентаэ
НажатьЗклавишуЗпредварительнойS установкиЗподсветкиЗинструментовэ



ГоритЗсветовойЗиндикаторяЗподсветка дляЗмногофункциональногоЗшприца модуляЗассистентаЗадействованаэ



ЗанесениеЗвЗпамятья
НажатьЗклавишуЗТГлКГЗиS удерживатьЗеёЗдоЗтехЗпорS покаЗнеЗпрозвучитЗсигналЗSS инструментЗприЗэтомЗдолженS бытьЗснятЗсЗдержателяэ



ВремяЗостаточногоЗсвеченияЗиЗинтенсивностьЗподсветки неизменныэ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ВйЬнSТых юъ ицьфЭЛЕИлЗлСэ

УстановкаSвремениSсутокэ

НажатьSклавишуS ЧасыSиSудерживатьS
ееSдоSтехSпорSпокаSнеSпрозвучитS
сигналэ



УстановитьSчасыSSпомощьюSклавиши
Плюс SилиS Минус э



СноваSкороткоSнажатьSклавишуS ЧасыSэ

УстановитьSминутыэ



СноваSкороткоSнажатьSклавишуS
ЧасыSэ

СброситьSсекундыSнаSноль э



Запоминаниеэ
НажатьSклавишуS ЧасыSиS
удерживатьSееSдоSтехSпорSпокаS
неSпрозвучитSсигналэ


Таймер

ЗапускSтаймера



НажатьSклавишуS Таймер э
УстановленноеSвремяSистекаетS
ПоSистеченииSустановленногоS
времениSраздаетсяSсигналэ

УстановкаSтаймераэ



НажатьSклавишуS Таймер SиSудерживатьS
ееSдоSтехSпорSпокаSнеSпрозвучитSсигналэ
УстановитьSнужноеSвремяSSпомощьюS
клавишS Плюс SилиS Минус э
МаксSзнSминутSцSсекунд

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВйЬнSТ ых ю ъ ицьфъSЭлЕИ лЗ лСэ

КакSработатьSSS п ФункциональнымиS клавишамиэ


МодульSуправлениял Индикатор

НастройкаSфункции

НажиматьSклавишуSиSилиSиSдоSтехS порSпокаSнеSпрозвучитSсигналэ



ЗапускаетсяSрежим программированияэ

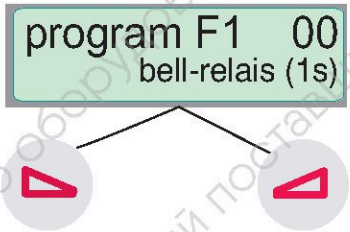

ВыбратьSфункциюSможноSприS помощиSклавишSплюс SиSминусэ

СохранениеSфункции
НажиматьSклавишуSиSилиSиSдоSтехS порSпокаSнеSпрозвучитSсигналэ



ВызовSфункции
СохраненнаяSфункцияSзапускаетсяс еслиSкратковременноSнажатьSнаS клавишуSиSилиSиSдоэ



ПредварительноSзапрограммированыSимSфункцийэ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВйЬнЅТьюх юъ ицьфЅЭлЕИлЗлСэ


ФункцияЅгидроочисткиэ

МодульЅуправлениялЅ

Индикатор

ВызовЅфункцииэ

НажатьЅклавишуЅТ лКГ Ѕподготовкаузѕ
СветовыеЅиндикаторыЅКГ ЅмигаютЅ
примерноЅчетыреЅсекундыэ

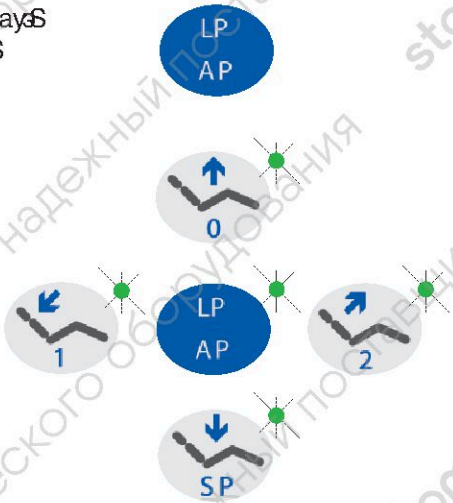

НажатьЅклавишуЅ ЧашаЅлевательницы зѕ
ВключаетсяЅфункцияЅгидроочисткиѕ
ПриЅповторномЅнажатииЅфункцияЅ
отменяетсяэ



Эта Ѕфункция Ѕ помощью Ѕ включения Ѕ елективных Ѕ клапанов Ѕ и вакуум-насоса Ѕ обеспечивает Ѕ автоматическую Ѕ промывку Ѕ водой Ѕ в Ѕ течение Ѕ примерно Ѕ ьцЅ секунд Ѕ отсасывающих Ѕ инструментов тот Ѕ корпуса Ѕ фильтра Ѕ до Ѕ системы Ѕ епарации уѕ Ѕ Система Ѕ поласкивания чаши Ѕ левательницы Ѕ при Ѕ этом Ѕ несколько Ѕ раз Ѕ включается Ѕ и Ѕ выключается эѕ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВйЬнSТьюхюъ ицьфъSЭлЕИлЗлСэ

ДобавлениеSсредстваS ЫпнцйфSМодульSуправлениялИндикатор

ЕслиSемкостьSдляSсредстваSЫпнцйфSпустаSраздаетсяSсигналSритмичноSповторяющийсякаждыеSцSсекундэ


цSSS


stomdevice

ВйЬнSТых юъ иць ф$ЭЛЕИлЗлСэ


ПрограммаSпромывкиS инструментов

ЭлементS управленияиндикация

тольконSSкомбинацииSSкомплектом дляSинтенсивнойSстерилизациию



НажатьSклавишуSТ лКГSсветодиодыS КГSмигаютSвSсекундыуSВоSвремяSмиганияS короткоSнажатьSклавишуS Спрей зS



СтерилизационнуюSнасадкуSнадетьS наSкерамическуюSлевательницуS илиSставитьSSSстеклянную Sлевательницуэ

ИнструментыSставитьSSSстерилизационныйS комплектSнаSлевательницеэ



ДляSтогоSчтобыSпоказатьSремяSпромывкиS инструментовSиSтрехSилиSмногофункциональногоS наконечникаSнажатьSпедальэ

СтандартноеSначениеSдляSпрограммыSпромывкиS составляетSцяццяццSминутуSнаSинструментэ




КлавишамиSкSКреслоSвверхSиSкСКреслоSвнизаS можноSнастроитьSремяSотSцяццSдоSдяцSминутэ

ЗапуститьSпрограммуSпромывкиSинструментовSбS ПовторноSнажатьSклавишуS Спрей SприS следующемSвключенииSаппаратаSнапримерS наSследующийSденьэ



КонецSпрограммыSпромывкиS инструментовSмигаютSсветодиодS Спрейвоздух Sжелтым Sсветодиод S Спрейвода Sзеленым Sсветодиод S Гч ны S зеленымSиSсветодиодS Сервис Sжелтым S Уложить Sинструментыэ

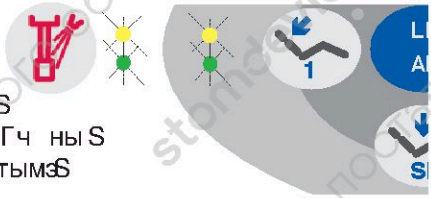

ПрерываниеSпрограммыSпромывкиSбSПовторнымS нажатиемSклавишиS Спрей SилиSвыключениемSиS включениемSаппаратаSможноSнезамедлительноS прервать Sпрограмму Sпромывк



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВйЬнSТьюхюъ ицьфъSЭлЕИлЗлСэ

ИнтенсивнаяSстерилизация топцияу

ЗапускSинтенсивнойSстерилизацииS безSавтоматическогоSтребованияя й

ПриSуложенныхSинструментахS нажиматьSклавишуSпокаSниеSп розвучитSзвуковойSсигналиSниеS начнетSмигатьSсветодиодS сSсекуднымSтактомуэ

ИнструментыSставитьSвS стерилизационнуюSнасадкуS наSлевательницеэ

ЗапускSфункцииэ


НажатьSклавишуSАвтоматическиS выполняетсяSинтенсивнаяSстерилизацияэ

КонецSинтенсивнойSстерилизацииэ


ЭлементыSуправленияS индикация



ЗаявкаSнаSинтенсивную стерилизацию тсветовойS индикаторSмигаетSс интерваломSвSкSсекуу

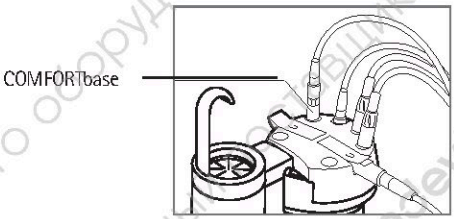



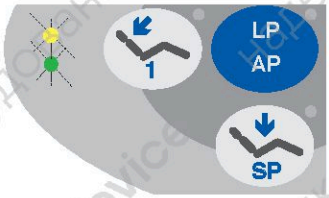

ПослеSпромывкиSинструментовSSSвысокойSконцентрацией средстваSы пнцйфначалоSвремениSожиданияSуказывается сигналомSдлительностьюSSSекундыSSSВремяSожиданияSдлится ьцSминутэSSSВSтечениеSэтогоSвремениSаппаратSможноSвыключитьSSПосле окончанияSинтенсивнойSстерилизацииSмигаютSсветодиодыSПрибор ВКЛаSиSСервисаSSПослеSукладкиSинструментовSаппаратSновaSготов кSработеэ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

ВйЬнSТых юъ ицьфЭЛЕИлЗлСэ

ПерейтиSчерезS фазуSвоздействия

ЭлементS управленияиндикация

Функцияэ





ИнтенсивнаяSстерилизацияSпроисходитS наSэтапеSпромывSпередSтехнологическимS перерывомуBВыключитеSиSвключитеS аппаратSновазBИнтенсивнаяSстерилизация включаетсяSнаSэтапеSпромывSНачинаетсяS процессSавтоматическойSпромывкиS ПослеSокончанияSпроцессаSпромывки разложитеSиSрассортируйтеSинструментыэ



ИнтенсивнаяSстерилизацияSпроисходитS наSэтапеSпромывSвремяSожиданияuS КлавишаSинтенсивнойSстерилизацииS иSгидроколлоидная клавишаS одновременноSприводятсяSвS действиеSиSудерживаютсяSвS нажатомSсостоянииэ



ОдновременноSприводитсяSв действиеSножнаяSпедальSдляSв ключенияSакустическогоSсигналаS ИнтенсивнаяSстерилизацияS включаетсяSнаSэтапеSпромывSПослеSокончанияSпроцессаSпромывки разложитеSиSрассортируйтеSинструментыэ

ЭтаSфункцияSнеобходимаSкогдаSначалсяSужеSзапущенный процессSстерилизацииSиSбезусловноSнеобходимоSвключение секцииSобработкиSнапримерSприSнесчастномSслучаеSв клиникеSиSтэдэ

ПослеSпрекращенияSинтенсивнойSстерилизацииSконцентрация оксигеналаSповышенаSПоэтомуSпроцессSавтоматической промывкиSдлительностьSокол0xSминутуSнельзяSпрерыватьэ ПослеSокончанияSпроцессаSпромывкиSзадаетсяSнормальная концентрацияэ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




stomdevice

ВйЬнSТыкюъ ицьфБЭЛЕИлЗлСэ

Предупредительные Сигналы — Индикатор

Предохранительное Устройствоэ

Предохранительное Устройство Задействовано, если Мигает Один Из Световых Индикаторов Клавиш автоматического Положения э

Расположение Я	Спинка Кресла Сиденье Кресла	ЭГ	
	Нижняя Сторона Параллелограмма Кресла		
	Вакуумгстоп		
	Скоба На многофункциональном блоке ножного управления	ТГ лКГ	
	Модуль Ассистентки Врача	КГ и	
	Модуль Пациента Когда Он находится над Креслом Пациента	КГ ж	
	Микровыключатель модуль Врача У	КГ ц	

Предохранительные Устройства немедленно Блокируют происходящие В Данный Момент Перемещения Кресла э

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВйЬнSТ ьох ю ь иць ф ЭлЕИ лЗ лСэ

ДругиеSпредупредительныеSсигналыэ Индикатор

ЕмкостьSдляSсредстваS Ы пнцйфSпустаэ


РаздаетсяSсигналSповторяющийсяSкаждыеSицSекундэ

ЕмкостьSдляSсредстваS Ы пнцйфSнаполненаэ

ицSзвуковыхSсигналовSSинтерваломSзSиSекэ


СепараторSамальгамыэ

Эох х ны ыацэ
МигаетSсветовойSиндикаторS Эныпп э
ОнSтишьSуказываетSнаSнеисправностьS
сепаратораSамальгамыSБолееSподробнаяS
информацияSотображаетсяSнаSдисплееS
сепаратораSамальгамыSиSсодержитсяSвS
соответствующемSРуководствеSпоS
эксплуатациие

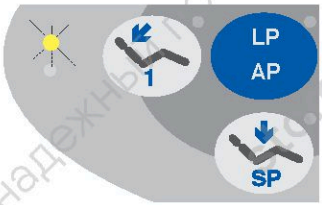

ОтсасывающийSклапанSнашиSплевательницыSпереполненэ

СветовойSиндикаторS Эныпп SмигаетSвS
течениеSицSекундSвSдействованS
аварийныйSвыключательSотсасывающегоS
клапанаSнашиSплевательницыSОтключаетсяS
подачаSводыSдляSполаскиванияSнашиS
плевательницыSиSдляSустройстваSнаполненияS
стаканаэ

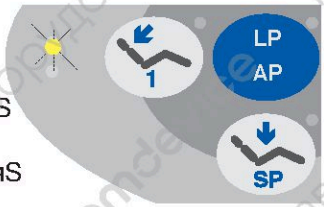

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВйЬнSТыхюъ ицьфбЭЕИлЗлСэ

ФункцииSмногофункциональногоSблокаSножного управления

— ФункциисSактивируемыеSприSснятыхSSдержателя инструментахэ

— ФункциисSактивируемыесSкогдаSинструментыSнаходятсяSа держателеSилиSкогдаSинструментSснятSSдержателяSиSдин разSбылSзадействованSпереключательSнаSнесущейSскобевэ



вSФункцииSперемещенияSкреслаSновaSотключаютсяSприSнажатии педалиэ


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ВйЬнЯТьох ю ицьфSЭлЕИлЗлСэ


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ВйЬнSТьюхюъ ицьфЭЭлЕИлЗлСэ

Инхчьшннм

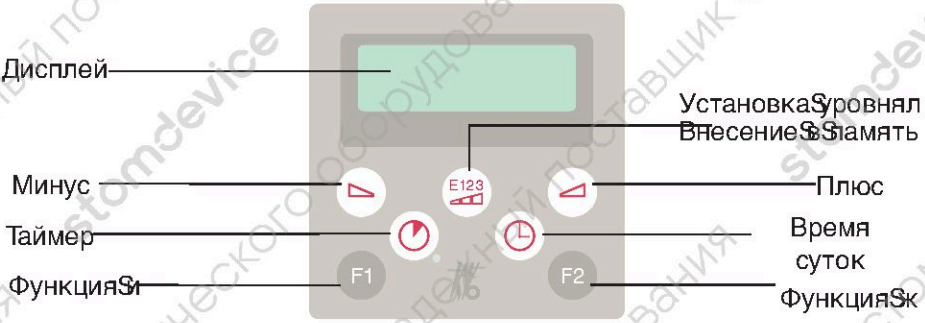

МодульSврача

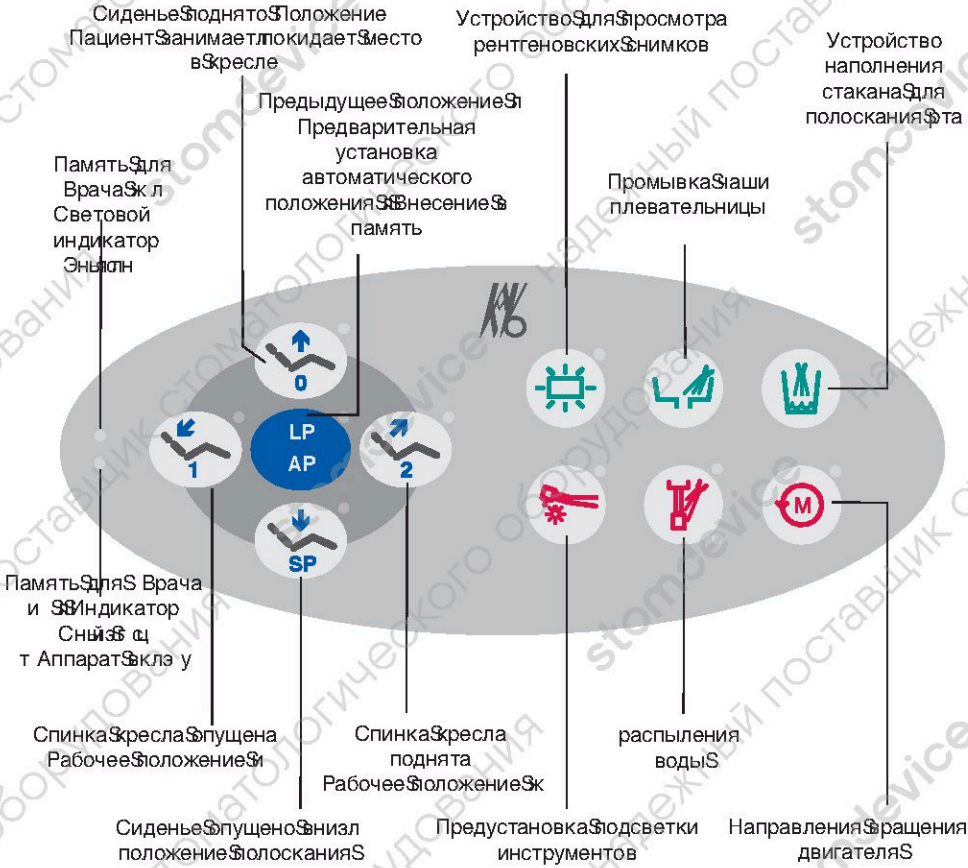

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



1.001.6820 Fk 20140820-08 ru

KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ