stomdevice X-CID 2

Représentation des voyants




Voyant éteint fixe | Voyant Power | Voyant allumé fixe | Voyants clignotants | Voyant défaut fixe


MICRO-MEGA®
5-12, rue du Tunnel
25006 Besançon Cedex - France

CE


AFFICHAGE EN FONCTIONNEMENT NORMAL

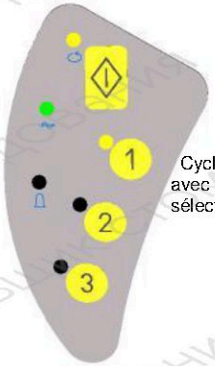


Cycle en cours avec la station 1 sélectionnée

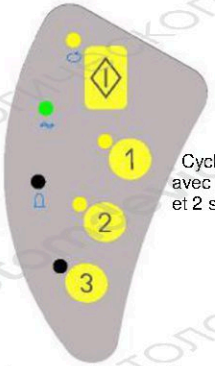

Cycle en cours avec les stations 1 et 2 sélectionnées

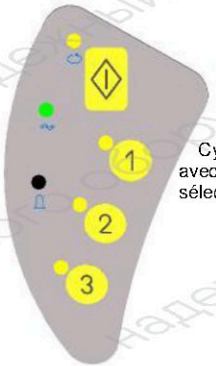


Cycle en cours avec les 3 stations sélectionnées

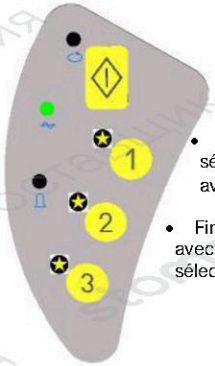


- 3 stations sélectionnées avant départ cycle
- Fin de cycle avec les 3 stations sélectionnées


AFFICHAGE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

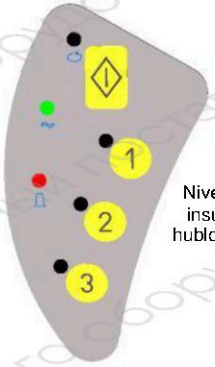


Niveau d'huile insuffisant ou hublot mal fermé

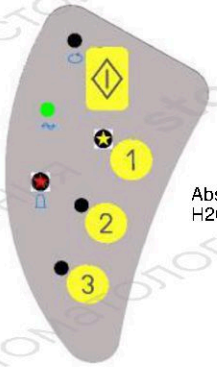

Absence de liquide H2O ou X-Cidol®2

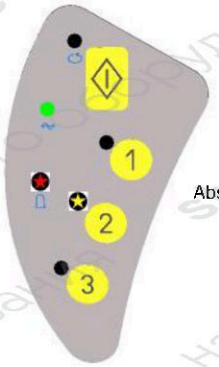

Absence d'air

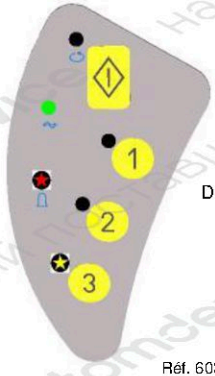

Défaut moteur

☞ Se référer au manuel d'utilisation pour plus de détails

Réf. 60300550-D 06/13
Année du marquage CE : 2006

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice X-CID 2


Représentation des voyants

Voyant éteint fixe | Voyant Power | Voyant allumé fixe | Voyants clignotants | Voyant défaut fixe


MICRO-MEGA®
5-12, rue du Tunnel
25006 Besançon Cedex - France

CE


AFFICHAGE EN FONCTIONNEMENT NORMAL

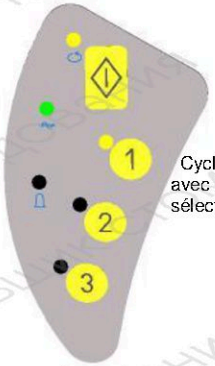


Cycle en cours avec la station 1 sélectionnée

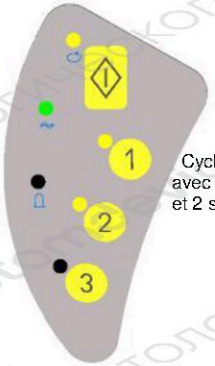

Cycle en cours avec les stations 1 et 2 sélectionnées

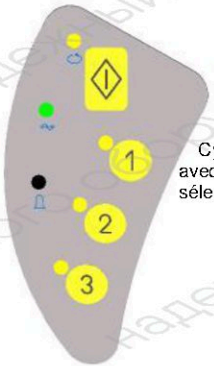


Cycle en cours avec les 3 stations sélectionnées

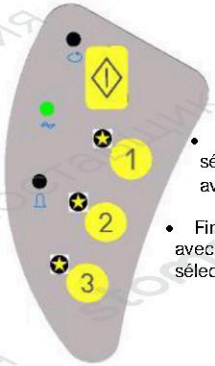


- 3 stations sélectionnées avant départ cycle
- Fin de cycle avec les 3 stations sélectionnées


AFFICHAGE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

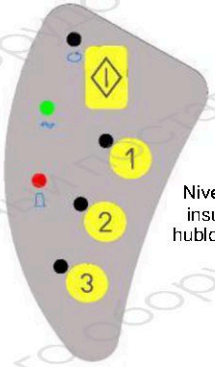


Niveau d'huile insuffisant ou hublot mal fermé

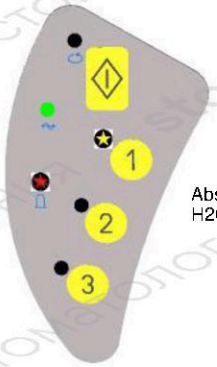

Absence de liquide H2O ou X-Cidol®2

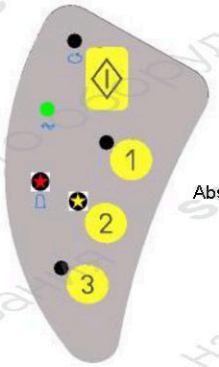

Absence d'air

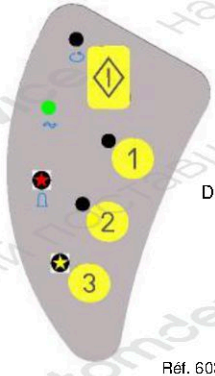

Défaut moteur

☞ Se référer au manuel d'utilisation pour plus de détails.

Réf. 60300550-D 06/13
Année du marquage CE : 2006

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ