
Руководство по установке Бесколлекторного мотора BL-1000

1. Компоненты:

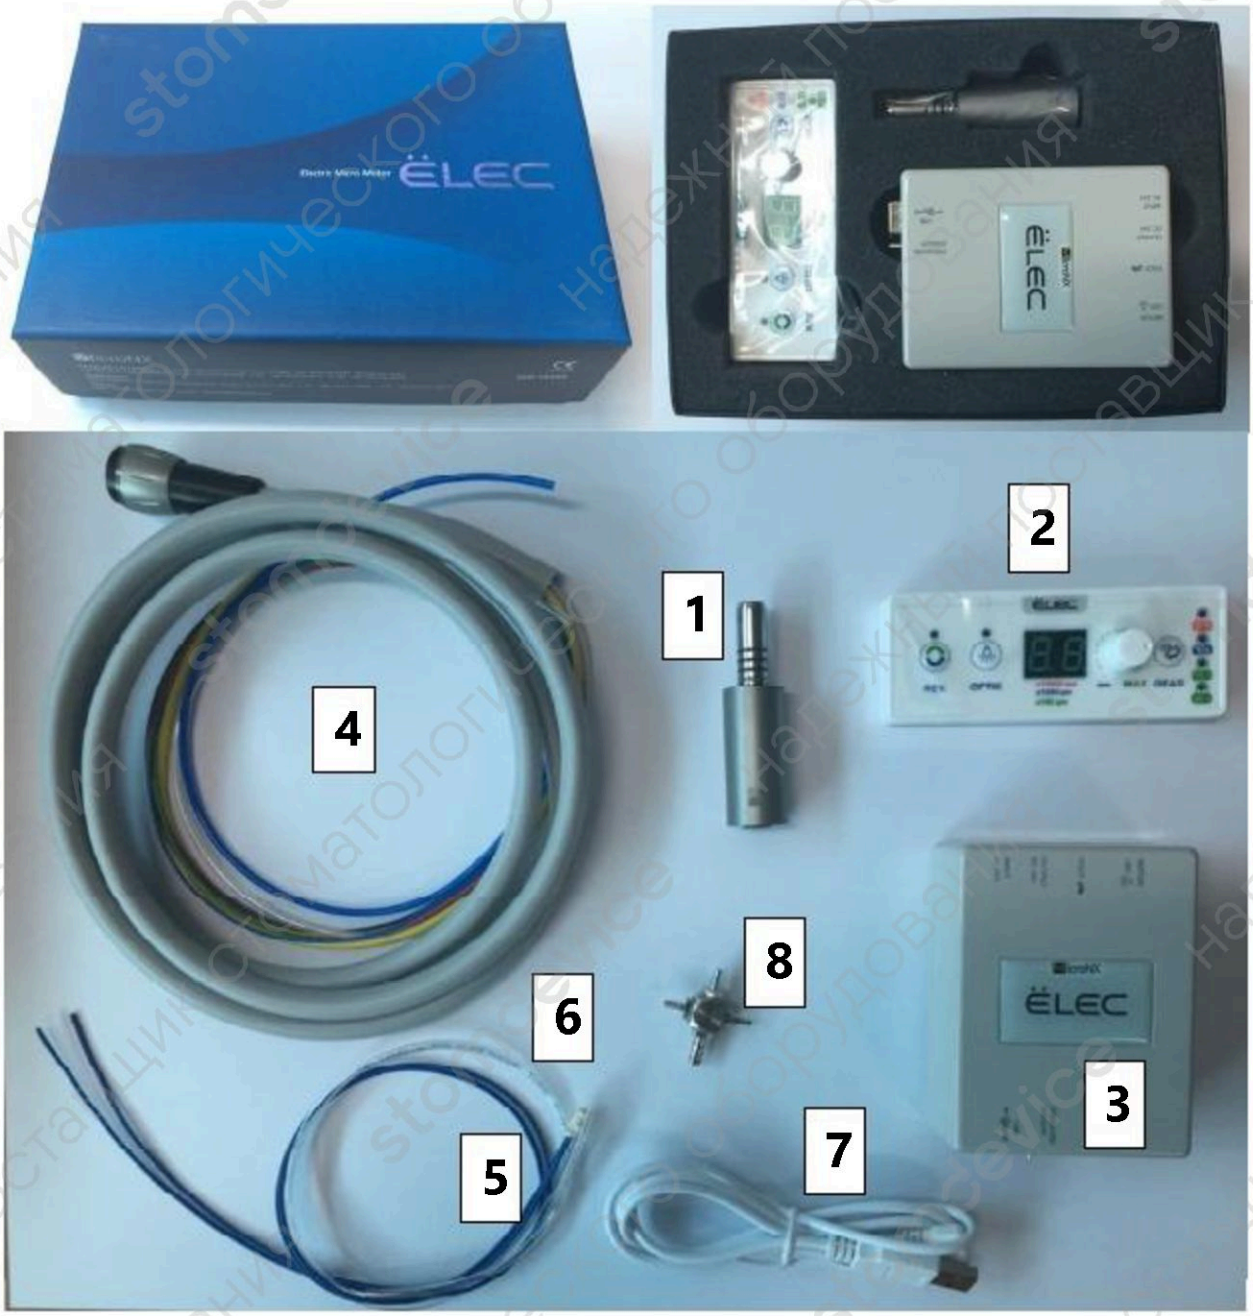

№	Наименование	№	Наименование
1	Бесколлекторный мотор	5	24 AC Кабель(синий)
2	Панель управления	6	Тюбинг воздуха
3	Основная панель	7	USB Кабель
4	Тюбинг	8	Штуцер (доп.опция)

2. Установка

2-1. Откройте панель установки










2-2. Выберите какой наконечник удалить. Обычно, установка комплектуется 2-мя высокоскоростными и 1-м пневмодвигателем. В таком случае рекомендуется убрать один высокоскоростной наконечник.



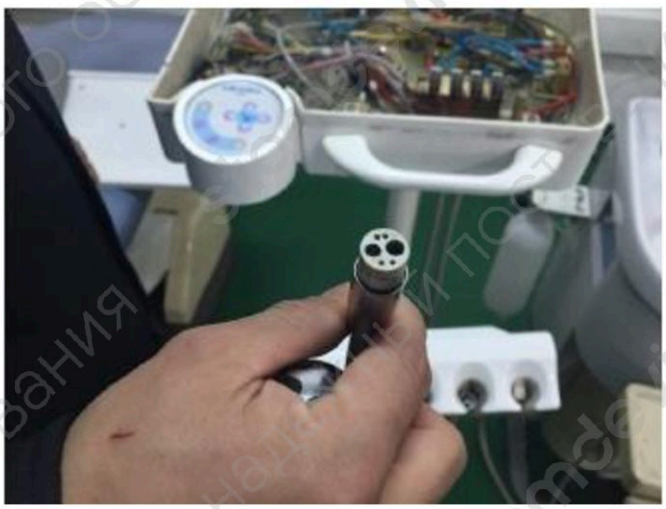

2-3. При удалении наконечника обязательно проверьте каналы подачи воды и воздуха, это поможет вам при установке микромотора.

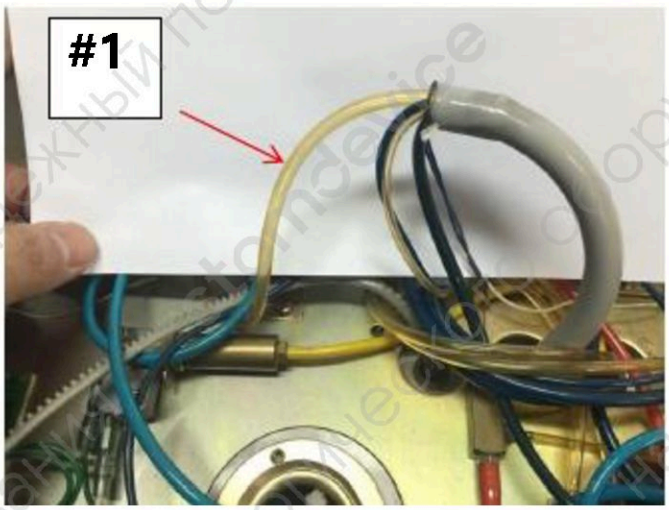

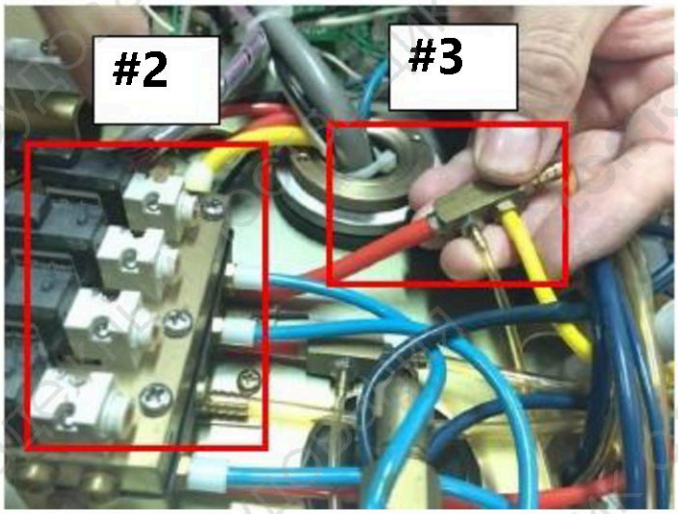



#1 Тюбингвоздухадлянаконечникаудаляется. Этот тюбинг соединяется со штуцером №3.

#2 Гребенка: Устройство для регулировки подачи воды и воздуха от установки до инструментов

#3 Штуцер: Устройстводляобъединениявоздуха, идущего от гребенки.


2-4Для установки мотора вам понадобится штуцер-тройник. Удалитепрежнийтюбингдлязаменынаштуцер, который объединяет подачу воздуха от 3 каналов. (если старый штуцер подходит, можете его не удалять)

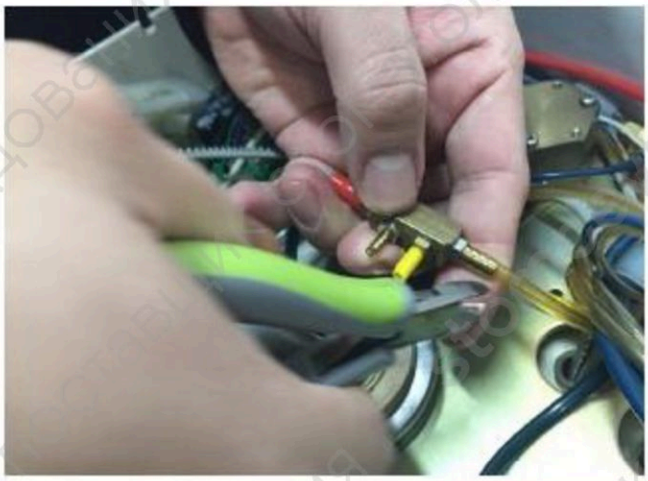

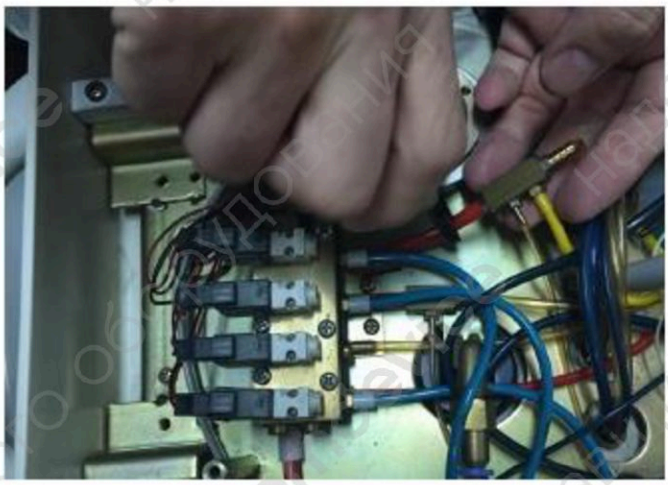




2-5Удалитепрежнийтюбингдляподачиводы. Запомнитеэтотпункт, потомучтотюбингдляподачиводымикромоторабудетподсоединен.

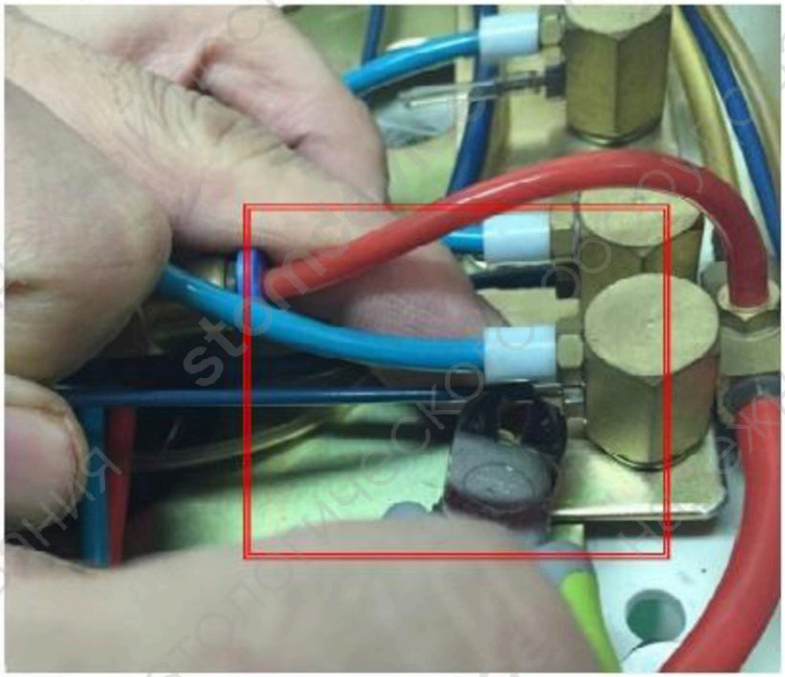



2-6. Вставьте тюбинг микромотора в стол врача установки. Еслиразъемнеподходит, согните пластиковый разъем, как на картинке ниже.



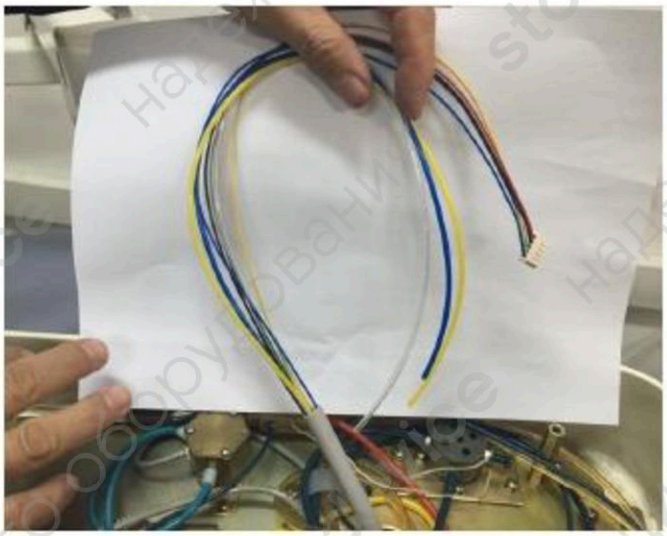

2-7Закрепитетюбинг, чтобыонневылетел из столика врача.

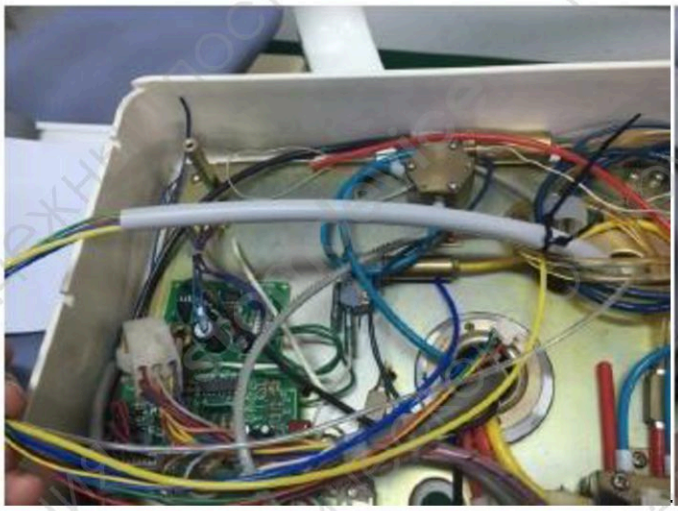

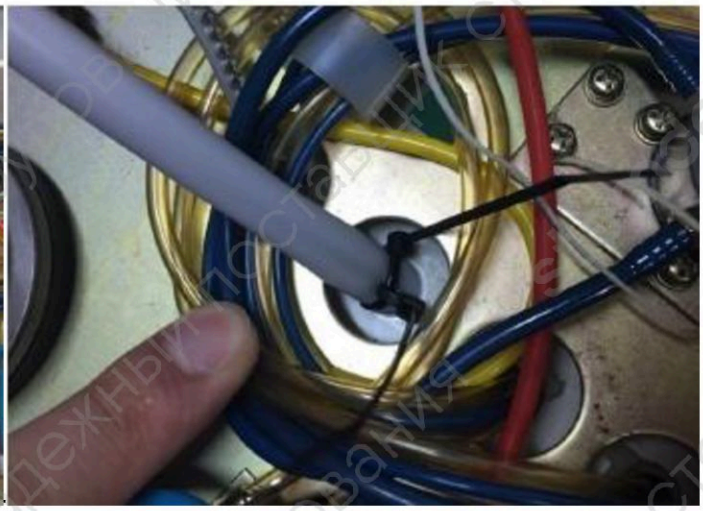


2-8Соединитеосновнуюпанельстюбингомвоздуха.








2-9Соедините 1.тюбинг охлаждения мотора (прозрачный), 2. спрей (желтый), 3. тюбинг пневматикикштуцеру (П. 2-4)

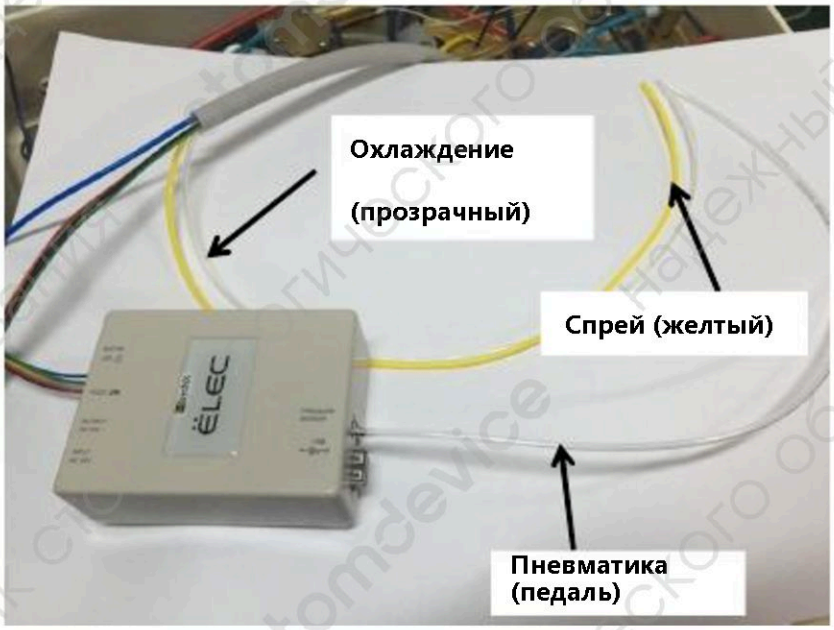





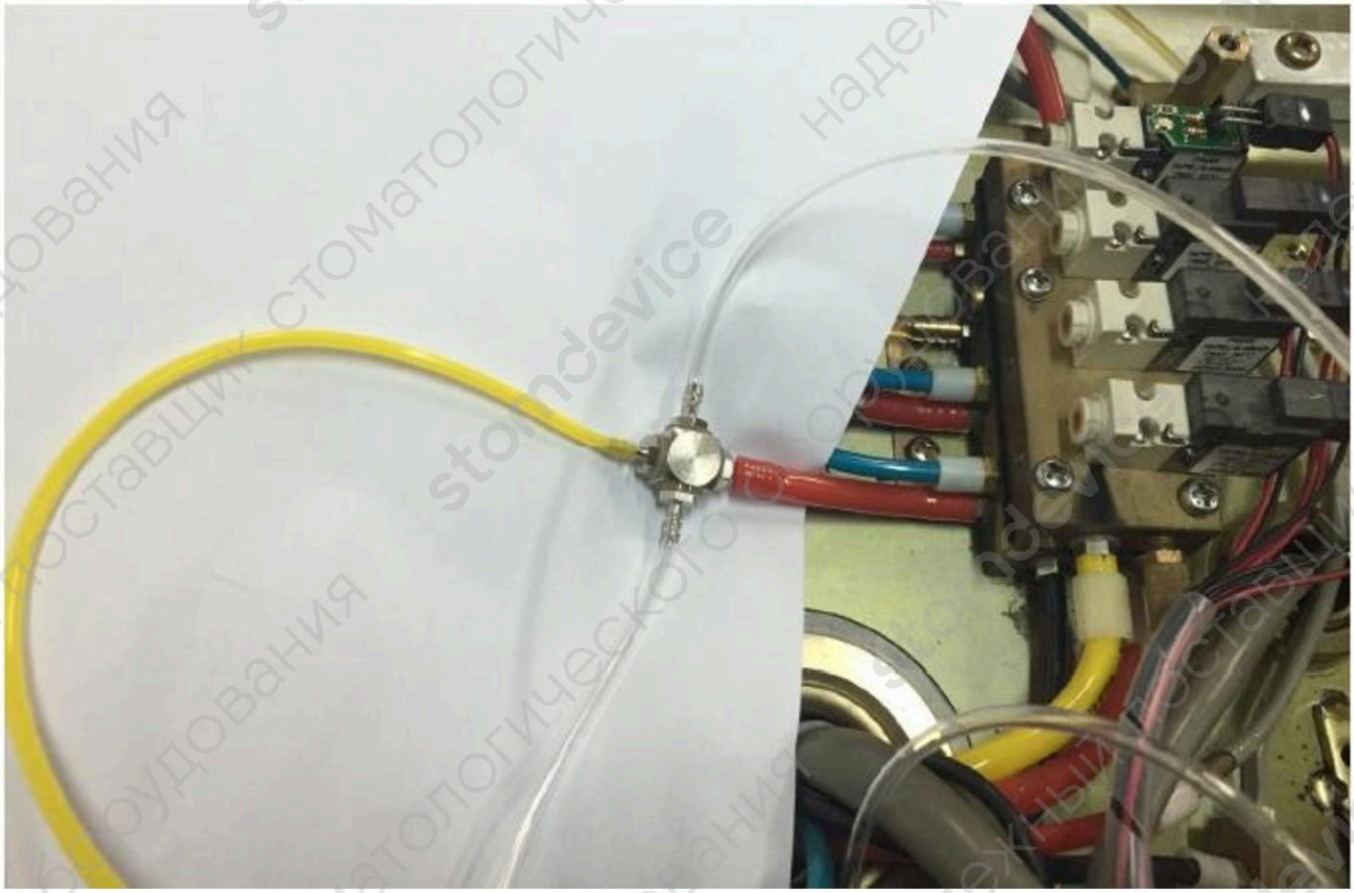

2-10Соединитетюбингвнутреннейподачиводы (голубой) кподачеводы (П. 2-5).



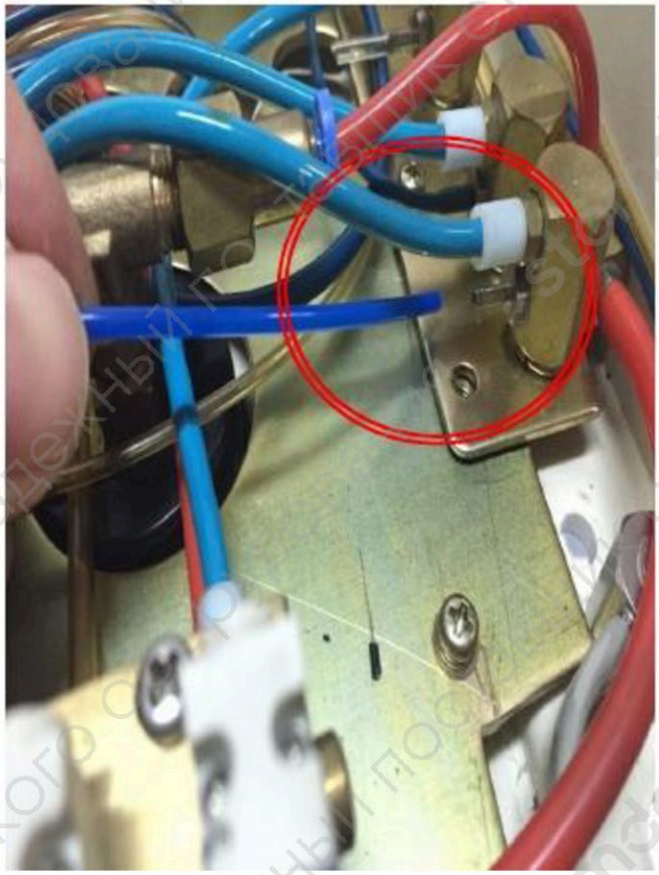


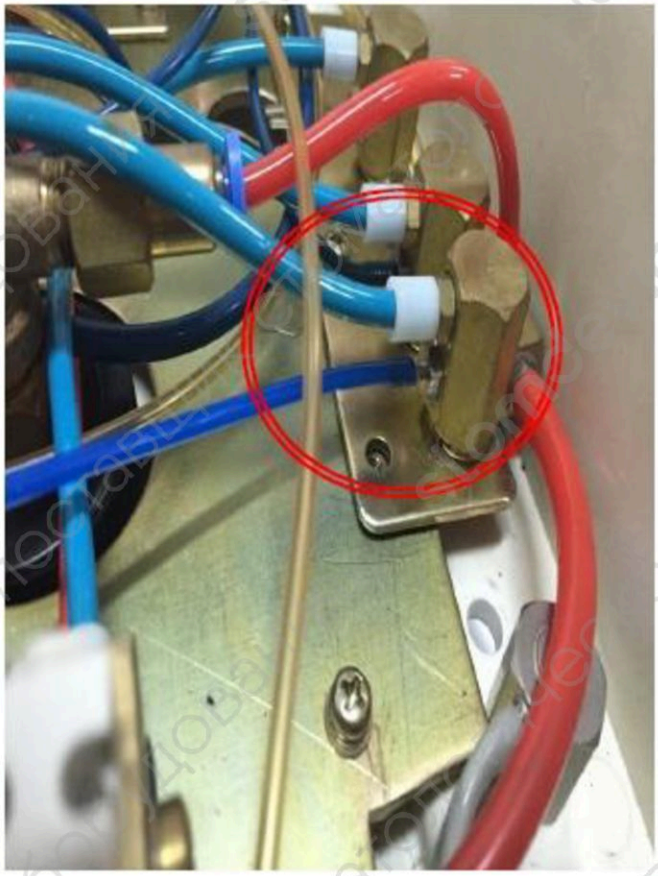





2-11Послесоединениякабеляпеременноготокав 24Вскабелемосновнойпанели, подсоедините этот кабель к переменному току в установке.



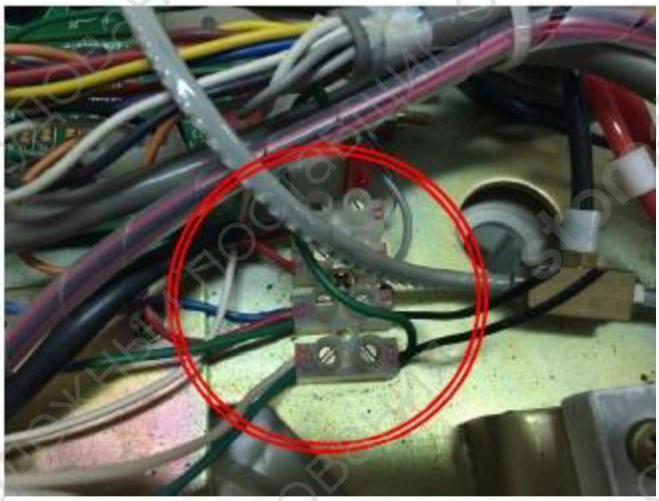

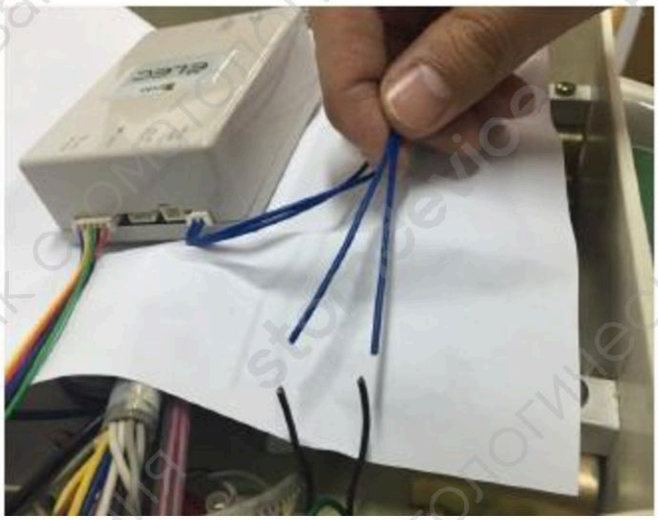

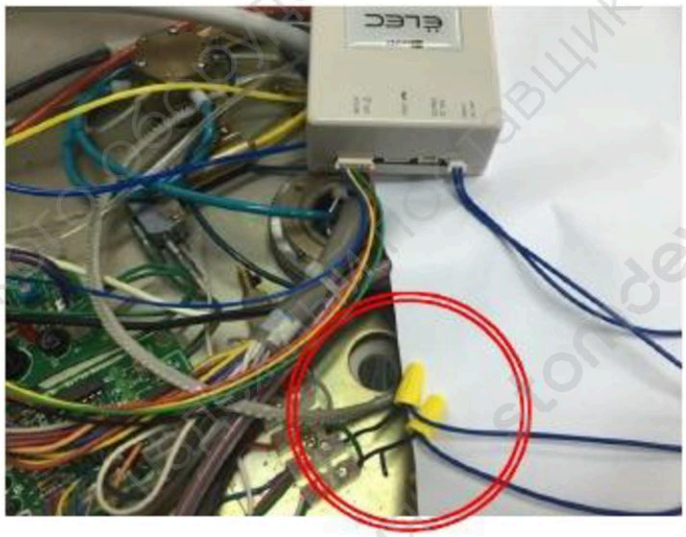

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы получить нормальный вращательный момент, необходимо чтобы была подача переменного тока 24В к мотору. Поэтому если у вас нет возможности подключить подачу тока от установки, установите адаптер, как на картинке ниже.



2-12Послеприсоединениякабеля USB косновнойпанели, выведитевторойразъемвыведите из установки, чтобы соединить его с панелью управления.





2-13Закройте столик врача и закрепите панель управления на столике или где вам удобно.





ВНИМАНИЕ: ЧАСТОЕ ОТКЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ ИЗНОСА РАЗЪЕМОВ.