stomdevice

Инструкция по смазке

TWINPOWER TURBINE 4H

Для спрея: Спрей AR, Распылитель 4H (Дезинфицируется этанолом) Спрей AR

№ 5010212 или № 5010216



№ 5010307
PAR-4HEX-O
PAR-4HX-O
PAR-4HMX-O



№ 5010293
PAR-4HEX-O-KV
PAR-4HX-O-KV
PAR-4HMX-O-KV



Распылитель 4H

№ 5010295
PAR-4HEX-O-WH
PAR-4HX-O-WH
PAR-4HMX-O-WH




№ 5010297
PAR-4HEX-O-SR
PAR-4HX-O-SR
PAR-4HMX-O-SR



№ 5010299
PAR-4HEX-O-NK
PAR-4HX-O-NK
PAR-4HMX-O-NK



Существуют различные распылители для каждого типа муфты. Проверить, правильный ли распылитель, можно, посмотрев сбоку от него.
Нет отметки: муфты MORITA CP4-O/WO и CP5-O (PAR-4HEX-O, PAR-4HX-O, PAR-4HMX-O)
KV: Быстросъёмное соединение KaVo (PAR-4HEX-O-KV, PAR-4HX-O-KV, PAR-4HMX-O-KV)
WH: Быстросъёмное соединение W&H (PAR-4HEX-O-WH, PAR-4HX-O-WH, PAR-4HMX-O-WH)
SR: Быстросъёмное соединение SIRONA (PAR-4HEX-O-SR, PAR-4HX-O-SR, PAR-4HMX-O-SR)
NK: Быстросъёмное соединение NSK (PAR-4HEX-O-NK, PAR-4HX-O-NK, PAR-4HMX-O-NK)
Отметку муфты см. здесь

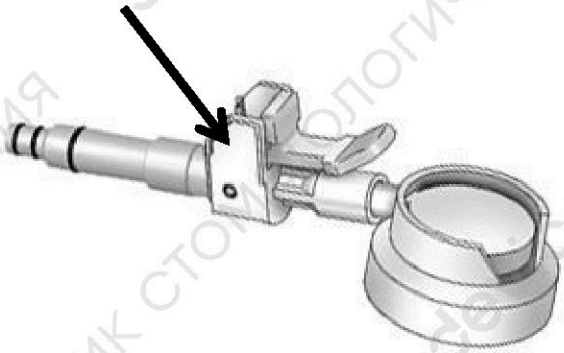

Обслуживание

распылитель патрона





Вставить до конца

Встряхните банку со спреем AR 2-3 раза перед использованием. Поднимите рычаг распылителя и поверните распылитель патрона вниз в рабочее положение. Накройте головку марлей, вставьте распылитель и распыляйте в течение 2 секунд.

Для соединения с наконечником





Опустите рычаг распылителя. Вставьте распылитель в соединительный элемент наконечника и распыляйте в течение 2 секунд.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Поднимайте и опускайте распылитель полностью, иначе масло может брызнуть и попасть в глаза.
Рычаг должен щелкнуть и заблокироваться в конечном положении.
Накрывайте головку марлей перед распылением внутрь патрона. Если спрей случайно попадет в глаза, промойте их обильно водой и обратитесь к врачу. С кожи смывайте спрей мылом и водой.

Сервис



Прикрутите распылитель на аэрозольную банку так, чтобы отверстие для соединения с наконечником торчало наружу. Вставьте распылитель в соединительный элемент наконечника и распылите в течение 2 секунд.

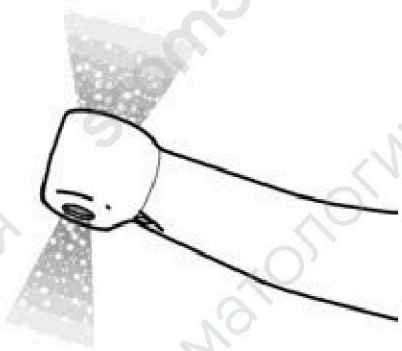

Соедините наконечник с трубкой. Включите наконечник на 2-3 секунды, чтобы выдуть излишки смазки и прочистить головку. Очистите колпачок спреем AR.

Вставить новый картридж



Распылите немного спрея AR внутри головки.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Вставьте распылитель в соединительный элемент наконечника и распылите в течение 2 секунд.



Соедините наконечник и включите его минимум на 15 секунд, чтобы выдуть излишки смазки из головки. Затем протрите наконечник марлевой салфеткой.

После замены картриджа обязательно используйте спрей AR.
* Заказывайте картриджи капсулы у местного дилера или в офисе «ДЖ. МОРИТА».
* При заказе указывайте модель: PAR-4HEX, PAR-4HX или PAR-4HMX.



Смазать спреем AR.

Отсоединить наконечник и нажать на ножную педаль.
Выходит ли воздух из трубки с достаточной силой?

НЕТ Дефектная трубка. Обратитесь в сервис.

ДА Если другие наконечники работают хорошо, заменить картридж капсулы.
Убедитесь, что используется правильный картридж капсулы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

LUBRINA

Обслуживание наконечника



* Для очистки н смззкн наконечника требуется около 25 секунд.

Бключпте главный выключатель
(Загорается зеленый индикатор питания).



Откройте переднюю дверпт.

* Прн креплении с микродвигателями (прямой, обратный и пр.) иногда бор должен быть вставлен, а иногда нет. См. руководство пользователя для **крепления с микродвигателями**.

A ПРИМЕЧАНИЕ

* *При использовании некоторых наконечников может выделяться масляный туман, если не естаелен дор.*

• *Б зависимости от тина наконечника* л .нтфтлы. .шоккп їьгсіе.тя?лвея .чосляным лнамгн. *В этом случае необходимо снизить давление до 0,3 У1Па.*



Прикрепите наконечник к муфте так. чтобы патрон смотрел назад (см. фото).
Аэрозольная банка А предназначена для сопл 1 н 2.
Аэрозольная банка В - для сопл 3 и 4.

A ПРИМЕЧАНИЕ

Снегине *за тем, чтобы не повредить уплотнительное кольцо на муфте, прикрепляя наконечник, иначе может разбрызгиваться масло, либоаппарат не будет работать должным образом*

Замечание об эксплуэтапин

♦ Ветаяыяе' нлкрнгчник идя, чтсрьг *он шелкнул, встав на место.*
Наконечник может выскочить to время обслуживания, если не прикреплен должным образом.

• £ели латэви с.чавгрлзи *на переднюю двергцу, внутренняя ловерхност*Б*блока будет быстрее загрязняться.*

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Нажмите вык.твочатель селектора. соответствующий подключенным наконечникам.
Загорятся ігяпидятцтет селектора
(Если накали неправильно, просто нажните еше раз выключатель. чтобы вынтючнть его).



закройте переднюю дверну.

Заменяв ле об зксплуэтапвл

t *Lubrina не начнет раооту при открытой передней дверле.*



Нажмите ныключатель ((Старт?)
Ин титагоры наконечников будут мигать во время проведения Обслуживания.

* Нажмите выключатель «Старт?: снова, если пропелера остановилась. не завершившись.

А ПРИМЕЧАНИЕ

Не быбкрайте муфту дез прикрепленного к ней наконечника. В противном случае при нажатш еикиочвтелл «Старт» начнет разорызгиватвея маело.

Заменяв ле об зксплуэтзпвн

* Нзпгапйс *не википайте азрозо.иные Панки so время обслуживания.*
* *При открытш передней дверцы процедура оослухеивания немедленно оепынаетшается.*




* Если спреи в банке заканчивается во время обслуживания, начнет мигать индикатор опустошения баики. и лропелура остановится Замените банку я кхкмнте выключатель «Старт» для повторення процедуры сначала.

По завершении обслуживания всея наконечников их ниджэторы погаснут, раздастся звуковой сигнал. загорится индикатор завершения.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

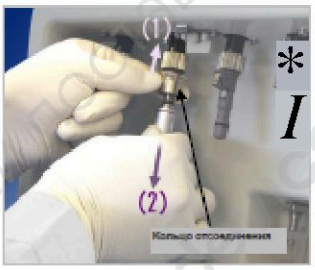

Откройте переднюю дверцу и выньте наконечники.
Держите нановечнп:-: одной рукой, а второй ткните вверх КОЛЬЦО ОТСОЄДИНЄННЗ (ДЛЯ муст :КсрЕ7і").

Замена кве её эксплуатация

* *Используйте этанол. Оля дезгінфекигги {этанол 76 - ДО* рръе.чныд *процентов/ для удаления масла с наконечника.*

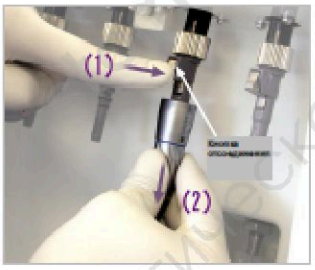

Для креплений с микродвигателями держите крепление ОДНОЙ РJZOH. а второй нзэтгю.пте кнопку отсоединекия.



Выньте наконечники и закроите дверцу

A ПРИМЕЧАНИЕ
CzfdJim м тел. чтс?ри *не порезать* нкльцы *о переднюю дверцу* ьдгг *другие детали,* е кіілім иавряечншся.



ВыкдЕчпге главный выключатель после нспольмвания. Индикатор питання выключится.

A ПРИМЕЧАНИЕ
• *После чспользаеанкя обязательно аыключайте слоеный выключатель.*
• Гтлнаяцрлт икок-я» лре.ня *не будет использоваться, выключите его из розетки* я *закройте главный воздушный клапан.*

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tri Auto ZX2

Смазка

* **Мы рекомендуем для смазки угловых головок использовать аппарат по уходу стоматологических наконечников Lubrina**

Угловая головка перед автоклавированием должна быть смазана маслом-спреем LS spray или Morita Multi spray.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не используйте какие либо другие смазочные спреи кроме LS spray или Morita Multi spray.
- Отсутствие смазки на угловом наконечнике приведет к нарушению работы.



(3) Накройте угловой наконечник куском марли или другой подходящей тканью.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Не допускайте попадания брызг спрея в Ваши глаза и т.д., всегда оборачивайте угловой наконечник марлей и т.п.



(2) Привинтите распылительную насадку на баллончик со спреем. Затем вставьте его в хвостовик углового наконечника, и распыляйте в течение 2 секунд. Используйте марлю и т.п., чтобы вытереть излишки спрея с внешней стороны углового наконечника.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Никогда не направляйте спрей на человека.
- Никогда не используйте спрей вблизи открытого пламени.
- Крепко держите угловой наконечник и баллончик со спреем во время использования спрея. Иначе давление спрея может привести к тому, что угловой наконечник вылетит из Ваших рук.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Всегда встряхивайте баллончик спрея два-три раза перед использованием. Используйте баллончик в вертикальном положении.



(1) Установите угловой наконечник на кусок марли, чтобы позволить всем излишкам спрея стечь.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Наконечник с мотором может быть повреждён, если угловой наконечник присоединить, не дав сначала стечь излишкам спрея.





⚠

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ