stomdevice

TIP GUIDE




Насадки к ультразвуковым скалерам и их применение

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Компания NSK предлагает широкий выбор насадок к ультразвуковым скалерам VARIOS для различного клинического применения.

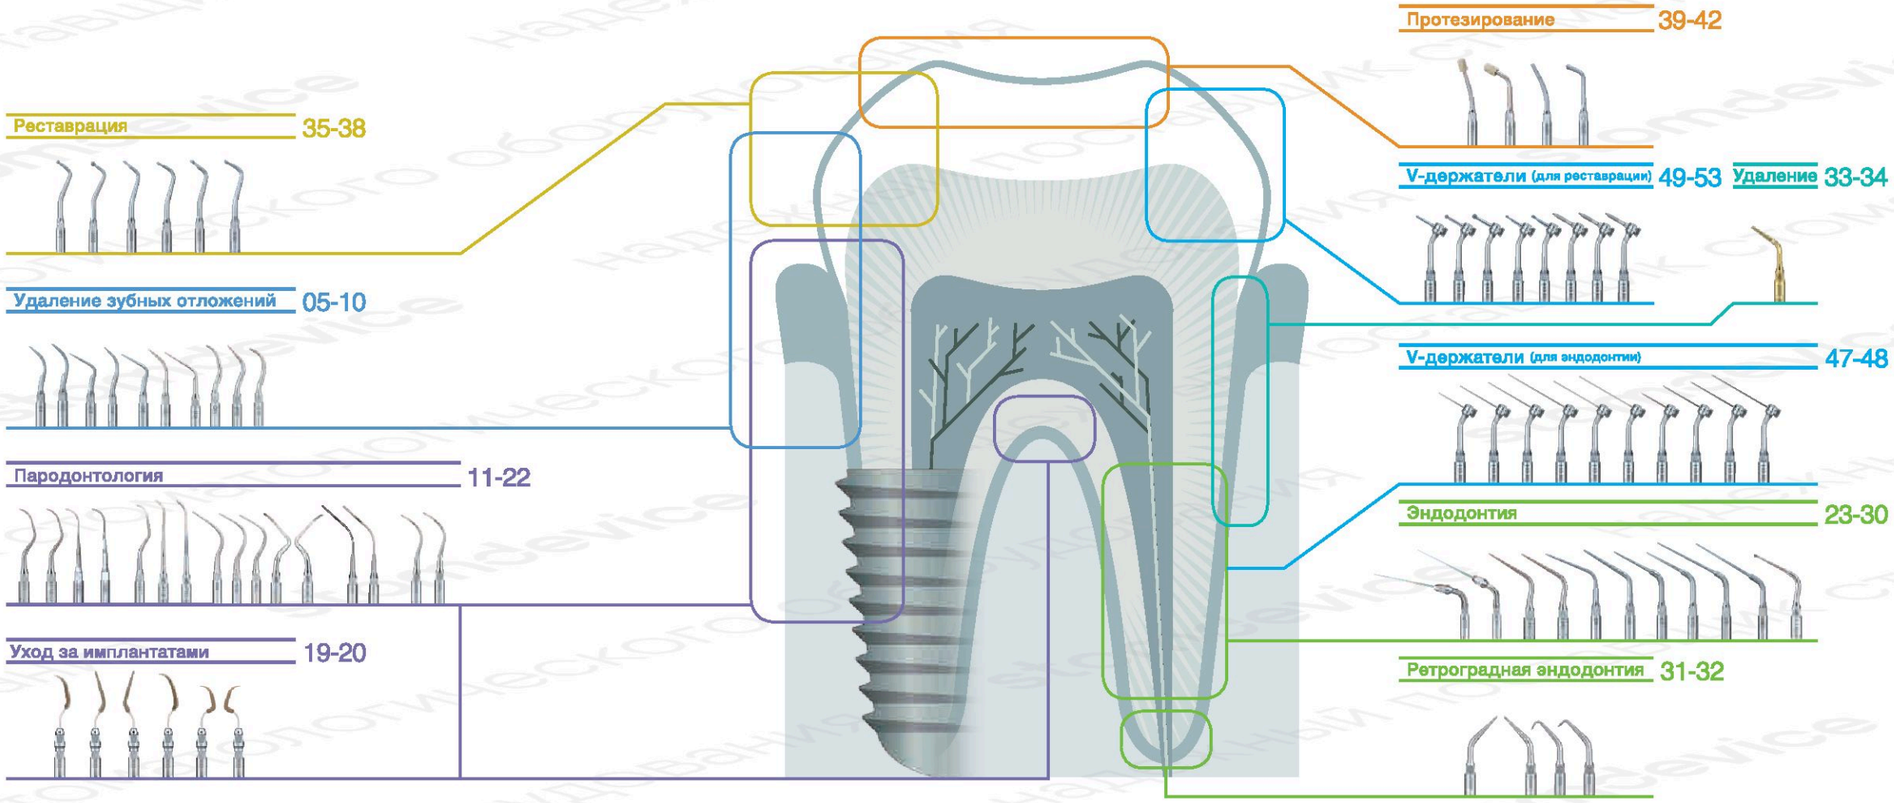

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Насадки Varios2 / Varios

Насадки NSK могут устанавливаться на наконечники ультразвуковых скалеров Varios и Varios2, а также на наконечники ультразвуковых скалеров Satelec®. Дополнительно NSK производит ряд насадок для ультразвуковых скалеров EMS®. Ниже представлено иллюстрированное руководство по всем насадкам Varios, их применению и установке.

Насадки NSK для скалеров





Система с V-держателем от NSK

Насадки NSK с маркировкой NSK и Satelec® можно напрямую присоединять к наконечникам ультразвуковых скалеров Varios от NSK и Satelec®.

Насадки NSK для скалеров



Насадки с маркировкой EMS® можно напрямую присоединять к наконечникам ультразвуковых скалеров EMS®.

Varios2



NSK Наконечник Varios2 с оптикой
LED С оптикой VA2-LUX-HP



NSK Наконечник Varios2 без оптики
Без оптики VA2-HP

Varios



NSK Наконечник Varios с оптикой
С оптикой VA-LUX-HP



NSK Наконечник Varios без оптики
Без оптики VA-HP



Наконечники ультразвукового скалера Satelec®



Наконечники ультразвукового скалера EMS®

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ключевые особенности правильной эксплуатации ультразвукового скалера

Ультразвуковые вибрации эффективно удаляют твердые зубные отложения, а эффект кавитации ультразвукового скалера NSK удаляет и разрушает биопленку.
Ниже представлены "четыре особенности" для достижения максимальной эффективности работы скалера:


пункт 1 Правильное расположение насадки

Серия ультразвуковых скалеров NSK оснащена пьезоэлектрическим генератором, который создает линейное возвратно-поступательное движение насадки.
В зависимости от того, какая часть насадки контактирует с зубом, генерируется различная мощность колебаний. Воздействие на зуб и результат работы изменяются в зависимости от части насадки, взаимодействующей с зубной поверхностью. Наибольший эффект достигается при касании насадкой стороной 2-3 мм от ее кончика.




пункт 2 Угол работы насадки

Располагая насадку под углом 15 градусов или менее по отношению к поверхности зуба, можно использовать 2-3 мм поверхности насадки от кончика. Чем больше будет угол, тем больше воздействие на зубную поверхность, так как сам кончик насадки (который является наиболее мощной частью насадки) прикладывается к поверхности. Соответственно, большая нагрузка на зубную поверхность и дискомфорт пациента могут возрасти.



пункт 3 Прикладываемая сила и движение насадки

Усилия, прикладываемые к насадке, должны быть очень незначительными.
Наиболее эффективные ультразвуковые вибрации создаются движениями кончика насадки по зубной поверхности. При удалении наиболее твердых и массивных зубных отложений необходимо использовать кончик насадки, так как он обладает достаточной мощностью для удаления камней, воздействуя на зону крепления камней к зубной поверхности. При «чрезмерном усилии, прикладываемом к насадке» или «усилии, прикладываемом к одной точке зубной поверхности» возможно повреждение зубной поверхности или причинение боли пациенту. При данной манере работы вы не используете все преимущества ультразвукового скалера.

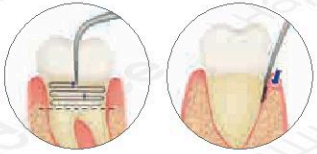

пункт 4 Установка мощности

Очень важно правильно настроить мощность в соответствие с типом зубного налета.
Мы рекомендуем ограничить мощность в начале процедуры и медленно повышать ее в зависимости от ситуации в полости рта.

stomdevice



Удаление зубных отложений


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Удаление зубных отложений

МОДЕЛЬ G1

- Для удаления наддесневого камня.
- Для удаления зубного камня в узких межзубных пространствах.
- Для удаления зубного камня возле края десны.

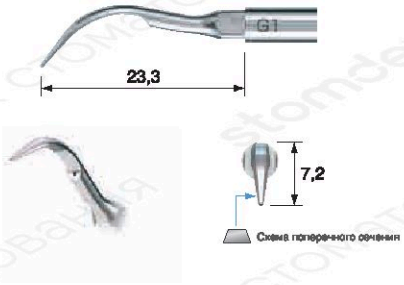

NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G1** КОД ЗАКАЗА **Z217101**


EMS® МОДЕЛЬ **G1-E** КОД ЗАКАЗА **Z291101**



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ G2

- Для удаления наддесневого камня.

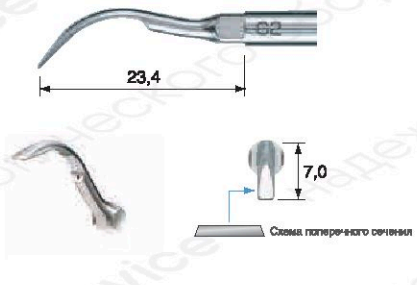

NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G2** КОД ЗАКАЗА **Z217102**

EMS® МОДЕЛЬ **G2-E** КОД ЗАКАЗА **Z291102**



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ G3

- Для удаления наддесневого камня.




NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G3** КОД ЗАКАЗА **Z217103**

EMS® МОДЕЛЬ **G3-E** КОД ЗАКАЗА **Z291103**



Однокорневые / Многокорневые зубы

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



МОДЕЛЬ G4

- Для удаления наддесневого камня.
- Для удаления зубного камня возле края десны.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G4** КОД ЗАКАЗА **Z217104**


EMS® МОДЕЛЬ **G4-E** КОД ЗАКАЗА **Z291104**



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ G5

- Для удаления наддесневого камня.
- Для удаления зубного камня в узких межзубных пространствах.
- Для удаления зубного камня возле края десны.
- Для удаления десневой биопленки под естественными зубами.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G5** КОД ЗАКАЗА **Z217105**



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ G6

- Для удаления наддесневого камня.
- Для удаления зубного камня в узких межзубных пространствах.
- Для удаления зубного камня возле края десны.
- Для удаления десневой биопленки под естественными зубами.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G6** КОД ЗАКАЗА **Z217106**

EMS® МОДЕЛЬ **G6-E** КОД ЗАКАЗА **Z291106**



Однокорневые / Многокорневые зубы

Следуйте рукоятке по выбору вашей мощности на стр. 55-56

Satelec, Piezon и Minitwist являются зарегистрированными товарными знаками компании Electro Medical Systems SA, Швейцария.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Удаление зубных отложений

МОДЕЛЬ G8

- Для удаления наддесневого камня.
- Для удаления зубного камня в узких межзубных пространствах.
- Для удаления зубного камня возле края десны.

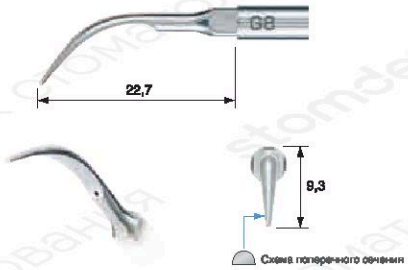

NSK Satelec МОДЕЛЬ G8 КОД ЗАКАЗА Z217108



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ G9

- Для удаления наддесневого камня.
- Для удаления зубного камня в узких межзубных пространствах.
- Для удаления зубного камня возле края десны.
- Для удаления десневой биопленки под естественными зубами.




NSK Satelec МОДЕЛЬ G9 КОД ЗАКАЗА Z217109



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ G11

- Для удаления наддесневого камня.

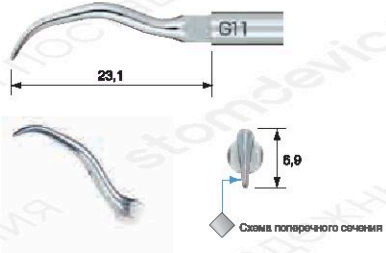


NSK Satelec МОДЕЛЬ G11 КОД ЗАКАЗА Z217411



Однокорневые / Многокорневые зубы


* Схема поперечного сечения - это изображение среза 1 мм от конца насадки. Размер насадки на рисунке отличается от реального размера.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



МОДЕЛЬ G12

- Для удаления наддесневого камня.

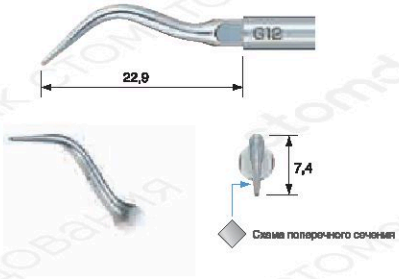


NSK Satelec МОДЕЛЬ **G12** КОД ЗАКАЗА **Z217412**



Однокорневые
/ Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ G13

- Для удаления наддесневого камня.

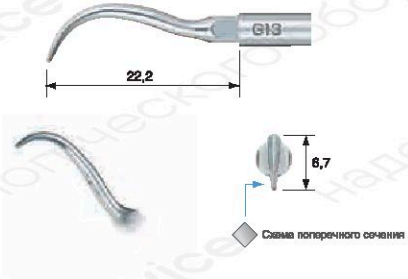

NSK Satelec МОДЕЛЬ **G13** КОД ЗАКАЗА **Z217413**



Однокорневые
/ Многокорневые зубы

Следуйте рукавчику, чтобы выбрать другие модели на стр. 55-56

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice




Пародонтология

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Пародонтология

МОДЕЛЬ P1

- Для удаления зубного камня в узких межзубных пространствах.
- Для удаления биопленки.








NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P1** КОД ЗАКАЗА **Z217404**

МОДЕЛЬ P1D

- Для удаления зубного камня в узких межзубных пространствах.
- Для удаления зубного камня глубоко под десной.
- Для хирургической обработки абсцессов.
- Для очистки стенки внутри пародонтального кармана.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P1D** КОД ЗАКАЗА **Z217405**

- Алмазное покрытие




P1: Однокорневые
P1D: Однокорневые / Многокорневые зубы

* Схема поперечного сечения для изображения зубов 1 мм от кончика насадки. Форма насадки на схеме и реальная может незначительно различаться.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice



МОДЕЛЬ P2D

- Для удаления зубного камня в узких межзубных пространствах.
- Для удаления зубного камня глубоко под десной.
- Для хирургической обработки зоны разделения корней.
- Для хирургической обработки абсцессов.
- Для очистки стенки внутри пародонтального кармана.



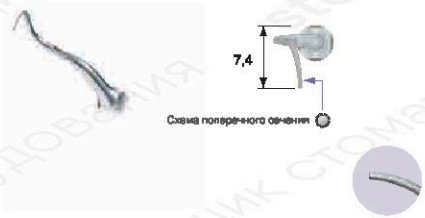

NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P2D** КОД ЗАКАЗА **Z217402**


- Алмазное покрытие
- С правосторонним изгибом



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ P3D



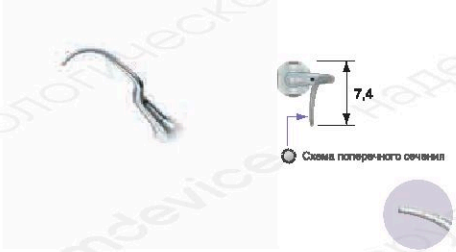

NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P3D** КОД ЗАКАЗА **Z217403**

- Алмазное покрытие
- С левосторонним изгибом



Однокорневые / Многокорневые зубы

P2D / P3D (Вид сверху)




Следуйте руководству по выбору насадок на стр. 55-56

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Пародонтология

МОДЕЛЬ P10

- Для удаления наддесневого камня.
- Для удаления зубного камня в узких межзубных пространствах
- Для удаления зубного камня возле края десны.
- Для удаления десневой биопленки.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P10** КОД ЗАКАЗА **Z217410**

- Острая кромка



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ P11R

- Для удаления зубного камня в узких межзубных пространствах
- Для удаления зубного камня глубоко под десной.
- Для удаления десневой биопленки.
- Для удаления биопленки в зоне разделения корней.
- Для хирургической обработки зоны разделения корней.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P11R** КОД ЗАКАЗА **Z217408**

- Острая кромка
- С правосторонним изгибом



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ P11L









NSK Satelec® MODELO **P11L** КОД ЗАКАЗА **Z217409**


- Острая кромка
- С левосторонним изгибом



Однокорневые / Многокорневые зубы

† Схема поперечного сечения - это изображение среза 4 мм от конца насадки. Размер изделия на рисунке не является реальным размером.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



МОДЕЛЬ P20

- Для удаления десневой биопленки.



NSK Satelec	МОДЕЛЬ P20	КОД ЗАКАЗА	Z217420
EMS	МОДЕЛЬ P20-E	КОД ЗАКАЗА	Z291420



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ P21R

- Для удаления десневой биопленки.




NSK Satelec	МОДЕЛЬ P21R	КОД ЗАКАЗА	Z217422
EMS	МОДЕЛЬ P21R-E	КОД ЗАКАЗА	Z291422

- С правосторонним изгибом



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ P21L

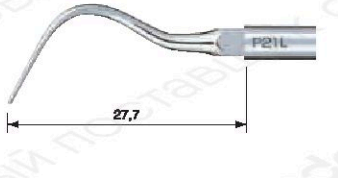

NSK Satelec	МОДЕЛЬ P21L	КОД ЗАКАЗА	Z217421
EMS	МОДЕЛЬ P21L-E	КОД ЗАКАЗА	Z291421

- С левосторонним изгибом



Однокорневые / Многокорневые зубы

Следуйте рукавицеру по выбору фасок и конусности на стр. 55-56

EMS®, Piezon и Minimaster являются зарегистрированными товарными знаками компании Electro Medical Systems SA, Швейцария.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Пародонтология

МОДЕЛЬ P25R


МОДЕЛЬ P25L

- Для удаления десневой биопленки.
- Для удаления биопленки в зоне разделения корней.







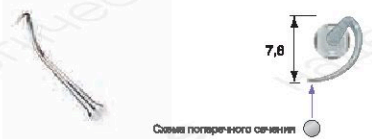

NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P25R** КОД ЗАКАЗА **Z217424**

EMS® МОДЕЛЬ **P25R-E** КОД ЗАКАЗА **Z291424**

- С правосторонним изгибом

NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P25L** КОД ЗАКАЗА **Z217425**

EMS® МОДЕЛЬ **P25L-E** КОД ЗАКАЗА **Z291425**

- С левосторонним изгибом



Однокорневые / Многокорневые зубы



Однокорневые / Многокорневые зубы


P11R / P11L / P21R / P20 / P21L (Вид сверху)



* Схема поперечного сечения - это изображение среза 1 мм от конца насадки. Размер наконечника может отличаться от реального размера.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



МОДЕЛЬ P26R

- Для удаления зубного камня в узких межзубных пространствах.
- Для удаления зубного камня глубоко под десной.
- Для удаления десневой биопленки.
- Для удаления биопленки в зоне разделения корней.
- Для хирургической обработки зоны разделения корней.

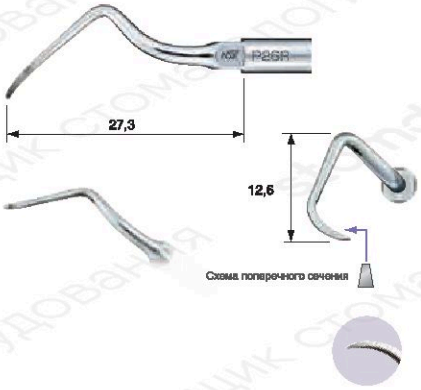

NSK Satelec МОДЕЛЬ **P26R** КОД ЗАКАЗА **Z217426**

- Острая кромка
- С правосторонним изгибом



Однокорневые / Многокорневые зубы

МОДЕЛЬ P26L



NSK Satelec МОДЕЛЬ **P26L** КОД ЗАКАЗА **Z217427**

- Острая кромка
- С левосторонним изгибом



Однокорневые / Многокорневые зубы

P25R / P25L / P26R / P26L (Вид сверху)



Следуйте рукавицу по выбору вкусов мощности на стр. 55-56

Satelec, Piezon и miniLED являются зарегистрированными товарными знаками компании Electro Medical Systems SA, Швейцария.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Пародонтология (Насадка для ухода за имплантатами)

МОДЕЛЬ V10





NSK Satelec

МОДЕЛЬ **V10** КОД ЗАКАЗА **Z217041**

- Включает ключ E-типа для замены насадок
- Пластиковая насадка не включена

МОДЕЛЬ V-P10

Предназначены для обработки зубных протезов и имплантатов. Изготовлены из специального материала, не повреждающего металлические поверхности и имплантаты.





МОДЕЛЬ **V-P10** КОД ЗАКАЗА **Y900184**


- 3 шт в упаковке
- Держатель V10 не включен



МОДЕЛЬ V-P11R

V-P11R/L – насадки с двумя изгибами, левосторонним и правосторонним. Данные насадки являются экстрадлинными и обеспечивают легкий доступ в труднодоступные места. Они позволяют избежать пересечения с соседними зубами или контурами. Их форма была разработана так, чтобы наилучшим образом соответствовать различной морфологии зуба. Эти универсальные насадки подходят для широкого спектра применений - от передних зубов до премоляров.



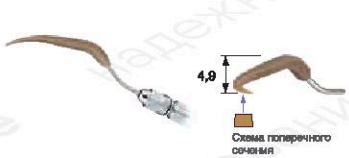

МОДЕЛЬ **V-P11R** КОД ЗАКАЗА **Y1002165**

- 3 шт в упаковке
- С правосторонним изгибом
- Держатель V10 не включен



МОДЕЛЬ V-P11L






МОДЕЛЬ **V-P11L** КОД ЗАКАЗА **Y1002166**

- 3 шт в упаковке
- С левосторонним изгибом
- Держатель V10 не включен

† Схема поперечного сечения – это изображение среза 1 мм от конца насадки. Размер изделия на схеме не обязательно отражает его реальный размер.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



МОДЕЛЬ V-P12

V-P12 – это более длинная версия популярной насадки V-P10. Она имеет широкий ряд применений, включая уход за имплантатами и другими протезными приспособлениями. Её форма обеспечивает легкий доступ ко всем областям лечения.

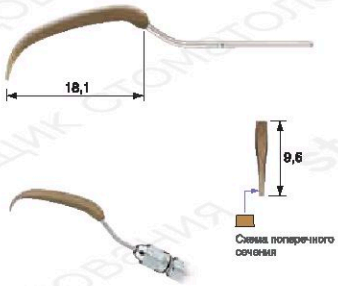

МОДЕЛЬ **V-P12** КОД ЗАКАЗА **Y1002167**


- 3 шт в упаковке
- Держатель V10 не включен



МОДЕЛЬ V-P26R

МОДЕЛЬ V-P26L

V-P26R/L – это насадки с двумя изгибами. Широкие углы обеспечивают доступ к областям, куда невозможно добраться с помощью насадок V-P11R/L или других обычных инструментов. Эти насадки идеально подходят для доступа к дистальной поверхности коренных зубов и угловым зонам, поскольку конец насадки очень схож с морфологией зуба.

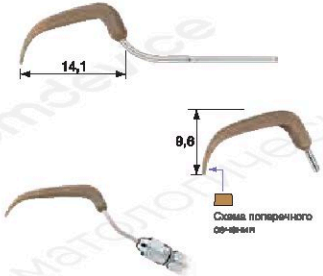

МОДЕЛЬ **V-P26R** КОД ЗАКАЗА **Y1002168**

- 3 шт в упаковке
- С правосторонним изгибом
- Держатель V10 не включен



МОДЕЛЬ **V-P26L** КОД ЗАКАЗА **Y1002169**

- 3 шт в упаковке
- С левосторонним изгибом
- Держатель V10 не включен



МОДЕЛЬ Perio Control Kit



NSK Satelec

МОДЕЛЬ **Perio Control Kit** КОД ЗАКАЗА **Y1002606**

- Держатель V10
- V-P11R, V-P11L, V-P12, V-P26R, V-P26L: по 1 шт каждого вида
- Включает ключ E-типа для замены насадок

Следуйте рукавицеру по выбору вкусов жидкости на стр. 55-56

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Пародонтология (для промывки и очистки)

Предназначены для эффективной очистки зуба после удаления пораженных тканей или снятия отложений.*Не применяется для соскабливания.

МОДЕЛЬ P40

- **Безопасна для обработки пародонтальных карманов вне зависимости от их состояния благодаря маркировке 3 мм и 6 мм от кончика насадки.**






NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P40** КОД ЗАКАЗА **Z217550**

- Диаметр насадки ø 0,6 мм

МОДЕЛЬ P41

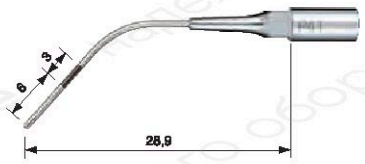



NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P41** КОД ЗАКАЗА **Z217555**

- Диаметр насадки ø 0,8 мм




Два отверстия для ирригации

- Ирригация из двух отверстий, расположенных на боковой поверхности кончика насадки.
- Эффективная очистка независимо от угла расположения насадки.
- Закругленный кончик для безопасной работы с периодонтом.

† Схема поперечного сечения – это изображение среза 1 мм от конца насадки. Размер изделия на схеме не обязательно отражает его реальный размер.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



МОДЕЛЬ **Набор Perio A**



NSK Satelec®

МОДЕЛЬ **Набор Perio A** КОД ЗАКАЗА **Y900144**

- P1D, P2D, P3D, P10: по 1 шт каждого вида
- Держатель для насадок: 1 шт.

МОДЕЛЬ **Набор Perio B**



NSK Satelec®

МОДЕЛЬ **Набор Perio B** КОД ЗАКАЗА **Y900145**


- P20, P25R, P25L: по 1 шт каждого вида
- Держатель для насадок: 1 шт.

Следуйте рукавайду по выбору вкусов мощности на стр. 55-56

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Эндодонтия

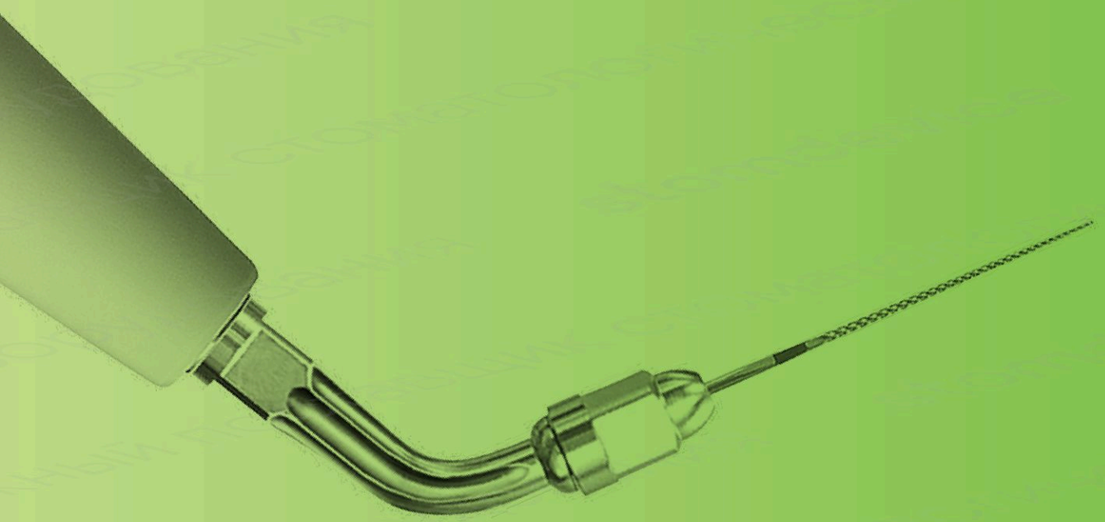

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ E4

• Применяется для очистки каналов и удаления инородных тел.



NSK Satelec МОДЕЛЬ E4 КОД ЗАКАЗА Z217428

• Диаметр насадки ⌀ 0,6 мм
* Для насадок E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11 и E12 необходимо использовать прилагаемый ключ E-типа для замены насадок

МОДЕЛЬ E7

• Для удаления пломбировочного материала и инородных тел.



NSK Satelec МОДЕЛЬ E7 КОД ЗАКАЗА Z217307

• Вода не требуется

МОДЕЛЬ E8

• Для удаления пломбировочного материала и инородных тел.




NSK Satelec МОДЕЛЬ E8 КОД ЗАКАЗА Z217308

• Вода не требуется



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



МОДЕЛЬ E4D

• Применяется для чистки и расширения корневых каналов.



NSK Satelec МОДЕЛЬ E4D КОД ЗАКАЗА Z217528

• Алмазное покрытие

МОДЕЛЬ E7D

• Для расширения стенок корневого канала.



NSK Satelec МОДЕЛЬ E7D КОД ЗАКАЗА Z217317

• Алмазное покрытие

МОДЕЛЬ E8D

• Для расширения стенок корневого канала.



NSK Satelec МОДЕЛЬ E8D КОД ЗАКАЗА Z217318

• Алмазное покрытие



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


МОДЕЛЬ E5

• Для латерального уплотнения.



NSK Satelec МОДЕЛЬ **E5** КОД ЗАКАЗА **Z217305**

• Вода не требуется



МОДЕЛЬ E6

• Для латерального уплотнения.



NSK Satelec МОДЕЛЬ **E6** КОД ЗАКАЗА **Z217306**


• Вода не требуется



* Схема показывает размеры эл. изображенных выше наконечников. Реальные размеры могут отличаться от указанных.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



МОДЕЛЬ **E15D**

• Для локализации корневых каналов и удаления кальциевых отложений.





NSK Satelec МОДЕЛЬ **E15D** КОД ЗАКАЗА **Z217319**

• Алмазное покрытие



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ E11

• Держатель для U-файлов с углом наклона 120°






- Для U-файлов (диаметр хвостовика: 0,8 мм)
- Для чистки корневого канала
- Для передних зубов
- Включает ключ E-типа для замены насадок

NSK Satelec МОДЕЛЬ **E11** КОД ЗАКАЗА **Z217031**

МОДЕЛЬ E12

• Держатель для U-файлов с углом наклона 95°






- Для U-файлов (диаметр хвостовика: 0,8 мм)
- Для чистки корневых каналов
- Для жевательных зубов
- Включает ключ E-типа для замены насадок

NSK Satelec МОДЕЛЬ **E12** КОД ЗАКАЗА **Z217032**

МОДЕЛЬ U-файлы

Длина: 33 мм Диаметр хвостовика: 0,8 мм

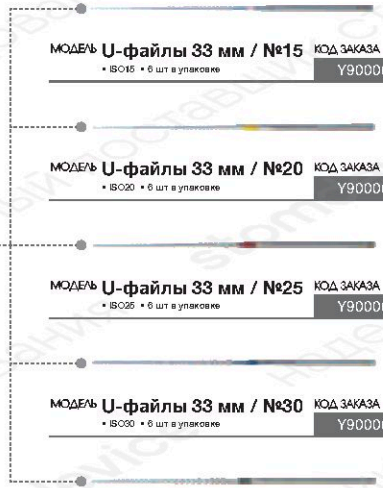

МОДЕЛЬ **U-файлы 33 мм / №15** КОД ЗАКАЗА
• ISO15 • 6 шт в упаковке **Y900062**

МОДЕЛЬ **U-файлы 33 мм / №20** КОД ЗАКАЗА
• ISO20 • 6 шт в упаковке **Y900063**

МОДЕЛЬ **U-файлы 33 мм / №25** КОД ЗАКАЗА
• ISO25 • 6 шт в упаковке **Y900064**

МОДЕЛЬ **U-файлы 33 мм / №30** КОД ЗАКАЗА
• ISO30 • 6 шт в упаковке **Y900065**

МОДЕЛЬ **U-файлы 33 мм / №35** КОД ЗАКАЗА
• ISO35 • 6 шт в упаковке **Y900066**

Всегда следуйте данной таблице для правильного выбора длины файла во избежание его поломки.


		№15	№20	№25	№30	№35
E11	Varios2	22 мм	24,5 мм	22 мм	22 мм	22 мм
	Varios	22-23 мм	22-23 мм	23-25 мм	23-25 мм	24-26 мм
E12	Varios2	22 мм	24,5 мм	24,5 мм	24,5 мм	22 мм
	Varios	21-25 мм	21-25 мм	21-25 мм	21-25 мм	21-25 мм




* Длина рабочей части канала, от вершины конуса до кончика инструмента. Размер указан для стандартных файлов. Выберите подходящий размер.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



МОДЕЛЬ **Набор Endo E11**
Для передних зубов

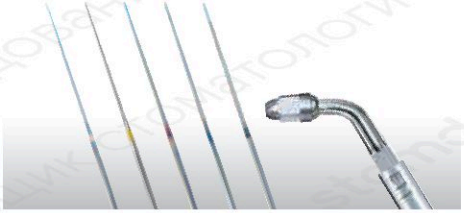

NSK Satelec

МОДЕЛЬ **Набор Endo E11** КОД ЗАКАЗА **Y900146**

- E11 (держатель для передних зубов с углом наклона 120°) : 1 шт.
- Ключ E-типа для замены насадок: 1 шт.
- U-файлы 33 мм №15, №20, №25, №30, №35 : набор из 6 шт. каждого размера

МОДЕЛЬ **Набор Endo E12**
Для передних зубов



NSK Satelec

МОДЕЛЬ **Набор Endo E12** КОД ЗАКАЗА **Y900147**

- E12 (держатель для жевательных зубов с углом наклона 95°) : 1 шт.
- Ключ E-типа для замены насадок: 1 шт.
- U-файлы 33 мм №15, №20, №25, №30, №35 : набор из 6 шт. каждого размера


Следуйте рукаводству по эксплуатации и техническому обслуживанию стр. 55-56 Оригинальная наконечник-турбина с системой подсветки LED, 2-х струйная, 4-х канальная

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Эндодонтия

Маленькая насадка с алмазным покрытием позволяет эффективно удалять дентин верхушки корня зуба.
Выпускается два вида угловых насадок (90° и 70°) для передних зубов и два вида закругленных насадок (левосторонняя и правосторонняя) для моляров.

МОДЕЛЬ E30RD








NSK Satelec МОДЕЛЬ **E30RD** КОД ЗАКАЗА **Z217212**

- Алмазное покрытие
- Для жевательных зубов (с изгибом вправо)

МОДЕЛЬ E30LD







NSK Satelec МОДЕЛЬ **E30LD** КОД ЗАКАЗА **Z217213**

- Алмазное покрытие
- Для жевательных зубов (с изгибом влево)

- Алмазное покрытие позволяет проводить эффективную подготовку полости.




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



МОДЕЛЬ E31D




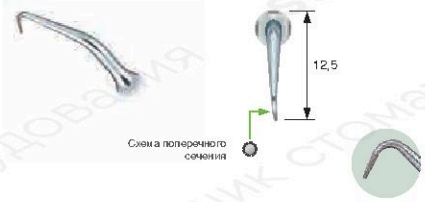

NSK Satelec МОДЕЛЬ **E31D** КОД ЗАКАЗА **Z217210**

- Алмазное покрытие
- Для передних и жевательных зубов (70°)

МОДЕЛЬ E32D





NSK Satelec МОДЕЛЬ **E32D** КОД ЗАКАЗА **Z217211**

- Алмазное покрытие
- Для передних зубов (90°)

МОДЕЛЬ Набор Retro




NSK Satelec МОДЕЛЬ **Набор Retro** КОД ЗАКАЗА **Y900149**

- E30RD, E30LD, E31D, E32D: по 1 шт каждого вида
- Держатель насадки: 1 шт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

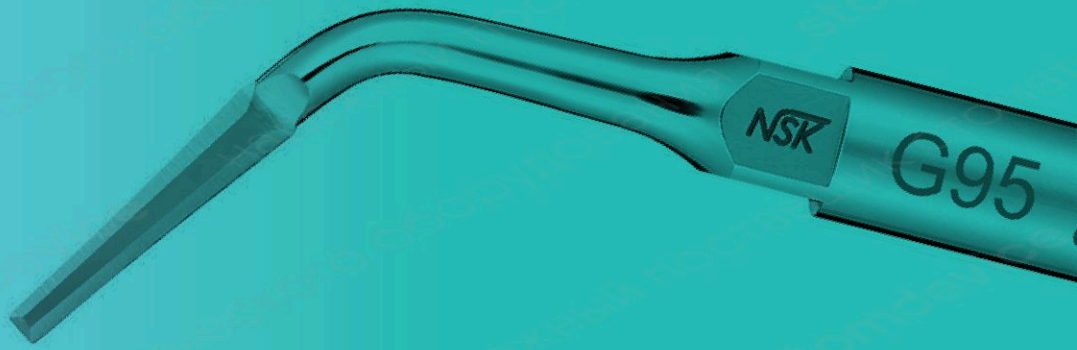

УДАЛЕНИЕ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

УДАЛЕНИЕ

Насадка для отслаивания периодонтальной мембраны.




МОДЕЛЬ **G95**

• Удаление возможно без дополнительного препарирования альвеолярной кости вокруг корня и с сохранением морфологии альвеолярной кости.






Предостережение



Перемещайте насадку не только в медиально-дистальных направлениях, но также вверх и вниз по мере поступления жидкости к алексу (эффект легкого пылесоса). В то же время уделяйте особое внимание потоку охлаждения.



Для предотвращения повреждения альвеолярной кости погружайте насадку к алексу вдоль контура корня зуба.

- Использование ирригации усиливает эффект.
- При использовании Varios 970 выберите уровень подачи ирригации.
- Насадка может использоваться только с ультразвуковыми скалерами NSK.


NSK МОДЕЛЬ **G95**

КОД ЗАКАЗА **Z217705**

• Нитрид-титановое покрытие • Толщина 0,7 мм • Двойная кромка, заостренная в трех направлениях

Удаление
(удаление верхнего левого зуба №2)






Изображение

Ретинированный зуб
(удаление нижнего левого зуба №8)





Изображение

Не применяйте чрезмерных усилий при работе с насадкой, как в случае использования элеваторов. Стоматологическая клиника Нишикава-гути.

Следуйте рукам

*Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Реставрация



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



МОДЕЛЬ G61D

МОДЕЛЬ G62D

- Используется насадка со сферическим кончиком с алмазным покрытием. Минимальная вероятность повреждения мягких тканей.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G61D** КОД ЗАКАЗА **Z217601**

- Алмазное покрытие

NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G62D** КОД ЗАКАЗА **Z217602**

- Алмазное покрытие



Следуйте рукавскому по выбору вакуумной мощности на стр. 55-56


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ G65D

- Для лечения межзубного кариеса проксимальной поверхности коренных зубов. Полусферический кончик насадки позволяет работать, не повреждая соседние здоровые зубы.







NSK Satelec МОДЕЛЬ **G65D** КОД ЗАКАЗА **Z217605**

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ G66D

- Для лечения кариеса проксимальной поверхности передних зубов. Позволяет удалить только разрушенный дентин на коренных зубах.








NSK Satelec МОДЕЛЬ **G66D** КОД ЗАКАЗА **Z217606**

- Алмазное покрытие



stomdevice




МОДЕЛЬ G67D

- Для лечения межзубного кариеса проксимальной поверхности коренных зубов. Полусферический кончик насадки позволяет работать, не повреждая соседние здоровые зубы.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G67D** КОД ЗАКАЗА **Z217607**

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ G68D

- Для лечения кариеса проксимальной поверхности передних зубов. Позволяет удалить только разрушенный дентин на коренных зубах.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G68D** КОД ЗАКАЗА **Z217608**

- Алмазное покрытие



Следуйте рукавчику по выбору вашей мощности на стр. 55-56

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Протезирование

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ G21

- Для уплотнения небольших вкладок, например, пломб на передних зубах.





NSK Satelec МОДЕЛЬ **G21** КОД ЗАКАЗА **Z217010**

- Для передних зубов
- Вода не требуется
- В комплект входят 3 колпачка

МОДЕЛЬ G22

- Для уплотнения больших протезов, например, накладок или коронок на коренных зубах.





NSK Satelec МОДЕЛЬ **G22** КОД ЗАКАЗА **Z217020**

- Для передних зубов
- Вода не требуется
- В комплект входят 3 колпачка



МОДЕЛЬ Колпачок на насадку



МОДЕЛЬ **Колпачок на насадку** КОД ЗАКАЗА **Y140751**

- Для G21 / G22
- В упаковке 10 штук
- Автоклавируемые

stomdevice



МОДЕЛЬ G26

• Для удаления штифтов (толщина ø1,3 мм)



NSK Satelec® МОДЕЛЬ G26 КОД ЗАКАЗА Z217206



МОДЕЛЬ G28

• Для уплотнения амальгам.



NSK Satelec® МОДЕЛЬ G28 КОД ЗАКАЗА Z217208

• Вода не требуется




Следуйте рукавчику по выбору рабочей мощности на стр. 55-56

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Система с V-держателем

stomdevice

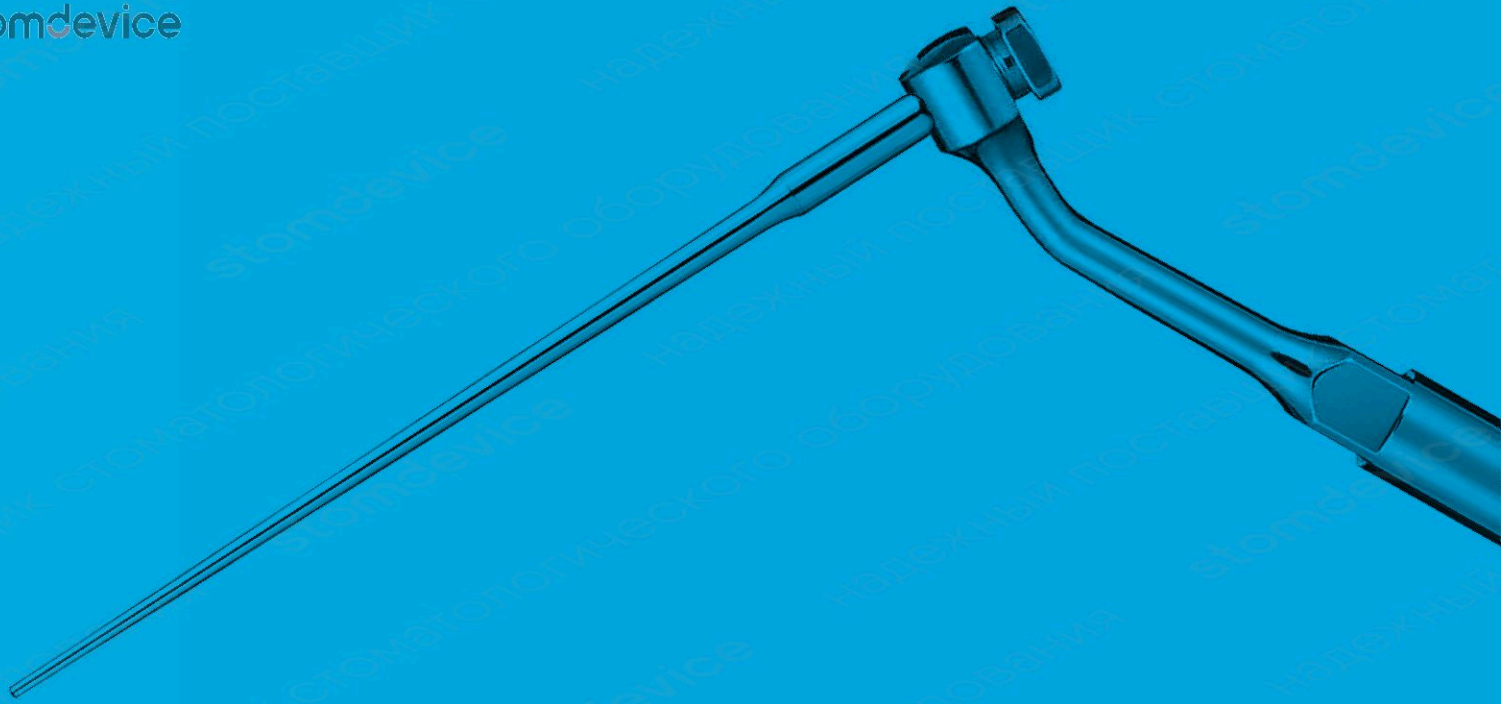

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Система с V-держателем

Система с V-держателем от NSK является инновационной, многофункциональной и экономичной. V-держатель – это отдельный от рабочей части насадки элемент. Он может быть легко заменен без особых затрат. Система с V-держателем от компании NSK обеспечивает гибкость и широкий спектр методов применения, чтобы отвечать всем требованиям различных клинических операций.

3 основные характеристики

Безопасность

- Минимальное повреждение мягких тканей
- Минимальный риск кровотечения
- Препарирование ткани ультразвуковыми системами – минимально инвазивное




Экономичность

- Одна насадка со сменной рабочей частью
- Недорогая рабочая часть

Удобство использования

- Маленький размер насадки гарантирует прекрасный обзор
- Маленькая головка обеспечивает превосходный доступ к дистальным поверхностям маляров и щечным поверхностям зубов
- Одна насадка используется для проведения всего спектра клинических процедур

Модельный ряд насадок для V-держателя



Реставрационные Страницы 49~52

- Для минимального вмешательства
- Для окончательной обработки / шлифовки / полировки
- Для удаления кариеса



Эндодонтические Страницы 47~48

- Для чистки корневых каналов
- Для расширения корневых каналов



МОДЕЛЬ **V30**





КОД ЗАКАЗА **Z217030**

• Насадки приобретаются отдельно



V30

• С углом наклона 120°

Эндодонтическая система с V-держателем

Для чистки корневых каналов

МОДЕЛЬ **V-S50**



КОД ЗАКАЗА **Y900169**

• Для чистки корневых каналов 17 мм • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-S51**



КОД ЗАКАЗА **Y900170**

• Для чистки корневых каналов 23 мм • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-S52**



КОД ЗАКАЗА **Y900171**


• Для чистки корневых каналов 26 мм • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-S53**




КОД ЗАКАЗА **Y900172**

• Для чистки корневых каналов 32 мм • Набор из 3-х штук

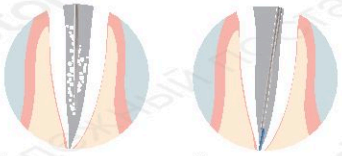

Чистка корневого канала

Извлечение сломанных инструментов



Для расширения корневых каналов

МОДЕЛЬ **V-S50D**



КОД ЗАКАЗА **Y900173**

• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 17 мм • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-S51D**



КОД ЗАКАЗА **Y900174**

• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 23 мм • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-S52D**



КОД ЗАКАЗА **Y900175**

• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 26 мм • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-S53D**



КОД ЗАКАЗА **Y900176**

• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов 32 мм • Набор из 3-х штук



* Для того чтобы исключить возможность образования уступов в корневых каналах, на кончике насадки (1 мм) нет алмазного покрытия.

Следуйте рукавскому по выбору вашей мощности на стр. 55-56

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Система с V-держателем для реставрации

Преимуществом ультразвукового препарирования является то, что движения насадки затрагивают только пораженные кариесом ткани дентина, в то время как здоровый дентин остается нетронутым. Пришеечный кариес может быть удален с минимальным вмешательством и быстрым заживлением мягких тканей.

V-TIP SYSTEM

Для минимального вмешательства

МОДЕЛЬ **V-G70**



КОД ЗАКАЗА **Y900118**

• С алмазным покрытием • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-G71**



КОД ЗАКАЗА **Y900119**

• С алмазным покрытием • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-G72**



КОД ЗАКАЗА **Y900120**


• С алмазным покрытием • Набор из 3-х штук



Удаление пришеечного кариеса



Удаление кариеса на корнях



Для минимального вмешательства

МОДЕЛЬ **V-G75**



КОД ЗАКАЗА **Y900121**

• С алмазным покрытием • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-G76**



КОД ЗАКАЗА **Y900122**

• С алмазным покрытием • Набор из 3-х штук



Удаление кариеса со смежных поверхностей



Удаление кариеса на корнях

Следуйте рукавелеру по выбору вакуумной мощности на стр. 55-56

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению, перед использованием. Рег. удост. РЗН 2014/1577

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Система с V-держателем для реставрации

Система с V-держателем от NSK разработана с целью проведения минимально инвазивных стоматологических процедур. Насадки Varios с V-держателем являются альтернативой вращающимся режущим инструментам благодаря точной и эффективной обработке поверхности с помощью ультразвуковых колебаний.


Окончательная обработка/ Шлифовка/ Полировка

МОДЕЛЬ **V-G77** Стандартная алмазная крошка



КОД ЗАКАЗА **Y900165**

МОДЕЛЬ **V-G78** Мелкая алмазная крошка



КОД ЗАКАЗА **Y900166**

МОДЕЛЬ **V-G79** Очень мелкая алмазная крошка



КОД ЗАКАЗА **Y900167**



Расширение корневого канала

Для препарирования дентина

МОДЕЛЬ **V-S1**



КОД ЗАКАЗА **Y900161**

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-S3**



КОД ЗАКАЗА **Y900162**

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук

МОДЕЛЬ **V-S33**



КОД ЗАКАЗА **Y900163**

• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3-х штук

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




МОДЕЛЬ **Assorted Tip Kit**
(Для минимального вмешательства)



МОДЕЛЬ **Assorted Tip Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900158**

- Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида

МОДЕЛЬ **Assorted Tip Kit**
(Окончательная обработка/ Шлифовка/ Полировка)

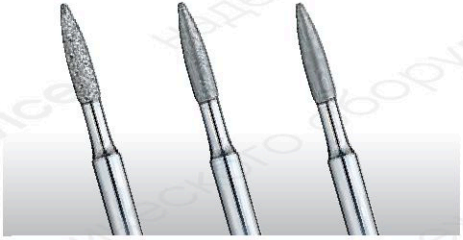

МОДЕЛЬ **Assorted Tip Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900168**

- Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида

МОДЕЛЬ **Assorted Tip Kit**
(Для препарирования дентина)



МОДЕЛЬ **Assorted Tip Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900164**

- Набор насадок: по 1-й насадке каждого вида

Задайте руководителю по выбору вопросы на стр. 55-56.

РУКОВОДСТВО ПО МОЩНОСТИ

НАСАДКА №	NSK Varios2 970/370	NSK Varios 750/560/350	Satelec® P-Max XS P5 XS	EMS® Piezon Master 600 (miniMaster)
Удаление зубных отложений				
G1	G7	G3	15	P6
G2	G7	G Max	15	P6
G3	G7	G3	15	P3
G4	G5	G3	15	P3
G5	G6	G3	15	–
G6	G8	G1	15	P6
G8	G7	G3	15	–
G9	G5	G1	15	–
G11	G6	G3	15	–
G12	G7	G3	15	–
G13	G6	G3	15	–
Пародонтология				
P1	P6	P2	5	–
P1D	P10	P2	5	–
P2D	P8	P4	5	–
P3D	P8	P4	5	–
P10	P10	P Max	5	–

НАСАДКА №	NSK Varios2 970/370	NSK Varios 750/560/350	Satelec® P-Max XS P5 XS	EMS® Piezon Master 600 (miniMaster)
P11R	P10	P Max	5	–
P11L	P10	P Max	5	–
P20	P8	P4	5	P6
P21R	P8	P4	5	P6
P21L	P8	P4	5	P6
P25R	P10	P4	5	P6
P25L	P10	P4	5	P6
P26R	P6	P3	5	–
P26L	P6	P3	5	–
P40	P3	P1	5	–
P41	P3	P1	5	–
V-P10	P6	P3	5	–
V-P11R	P6	P3	5	–
V-P11L	P6	P3	5	–
V-P12	P6	P3	5	–
V-P26R	P6	P3	5	–
V-P26L	P6	P3	5	–
				–

НАСАДКА №	NSK Varios2 970/370	NSK Varios 750/560/350	Satelec® P-Max XS P5 XS	EMS® Piezon Master 600 (miniMaster)
Эндодонтия				
E4	E6	E3	5	–
E4D	E7	E3	5	–
E5	E10	E3	5	–
E6	E10	E4	5	–
E7	E6	E Max	5	–
E7D	E6	E Max	5	–
E8	E2	E4	5	–
E8D	E2	E4	5	–
E15D	E6	E3	5	–
E11	E4	E3	5	–
E12	E3	E3	5	–
E30RD	E6	E3	5	–
E30LD	E6	E3	5	–
E31D	E6	E3	5	–
E32D	E6	E3	5	–
УДАЛЕНИЕ				
G95	G10	–	–	–

stomdevice

НАСАДКА №	NSK Varios2 970/370	NSK Varios 750/560/350	Satelec® P-Max XS P5 XS	EMS® Piezon Master 600 (miniMaster)
Реставрация зубов				
G61D	G2	G2	15	–
G62D	G2	G3	15	–
G65D	G2	G2	15	–
G66D	G2	G2	15	–
G67D	G2	G3	15	–
G68D	G2	G3	15	–
Уплотнение				
G21	G4	G2	20	–
G22	G4	G2	20	–
G26	G10	G Max	20	–
G28	G10	G2	20	–
Эндодонтическая система с V-держателем				
V-S50	E5	E3	10	–
V-S50D	E5	E3	10	–
V-S51	E3	E1	10	–
V-S51D	E3	E1	10	–
V-S52	E5	E2	10	–
V-S52D	E5	E2	15	–
V-S53	E5	E2	15	–
V-S53D	E5	E2	15	–
Система с V-держателем для реставрации				
V-G70	G6	G3	15	–
V-G71	G6	G3	15	–
V-G72	G6	G3	15	–
V-G75	G6	G1	15	–
V-G76	G6	G3	15	–
V-G77	G6	G3	15	–
V-G78	G6	G3	15	–
V-G79	G6	G3	15	–
V-S1	G6	E3	15	–
V-S3	G4	E3	15	–
V-S33	G6	E3	15	–

Цифры в руководстве по мощности указывают рабочую мощность и максимальную мощность для каждой насадки. Во избежание возможной поломки насадки не превышайте максимальную мощность.

Соответствующий диапазон мощностей для насадок Varios от NSK при их использовании с ультразвуковыми скалерами Varios и Varios 2 от NSK.

Varios2



Varios



<Внимание>

- Перед использованием прочтите инструкцию и сверьтесь с данным руководством.
- Для каждой насадки всегда используйте правильный режим и подходящий диапазон мощностей
- Всегда используйте достаточное охлаждение во избежание перегрева во время операции.
- Всегда начинайте работу при низких значениях мощности и затем при необходимости увеличивайте мощность.
- Перед использованием убедитесь, что насадка была надежно закреплена с помощью прилагающегося ключа. Следите за тем, чтобы значения мощности не превышали соответствующего уровня.

* Неправильное использование может привести к поломке насадки, даже если был выбран правильный диапазон мощностей. Перед использованием прочтайте инструкцию.

EMS®, Piezon и miniMaster являются зарегистрированными товарными знаками компании Electro Medical Systems SA, Швейцария.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Карта измерения износа насадок

- Простой способ оценить степень износа насадки

Ультразвуковые насадки изнашиваются по мере использования. Изношенные насадки передают вибрацию не так, как новые, и не работают с должной эффективностью.
Для проверки степени износа насадки используйте карту измерения насадок Varios.



Как использовать карту измерения степени износа насадок Varios

1. Приложите основание насадки к прорези на карте.

2. Проверьте износ насадки.


3. Используйте зеленую, желтую и красную полоску для определения степени износа.
* Посмотрите ниже, что означает каждый цвет.

NSK рекомендует менять насадку когда степень износа соответствует желтой линии (износ 1 мм), чтобы гарантировать безопасную и эффективную работу.

Зеленый: Без износа - Насадка в порядке.
Замена не требуется.

Желтый: износ 1 мм - насадка имеет износ.
Рекомендуется замена насадки.

Красный: Износ 2 мм - насадка сильно изношена.
Использовавние не рекомендуется, замените насадку.

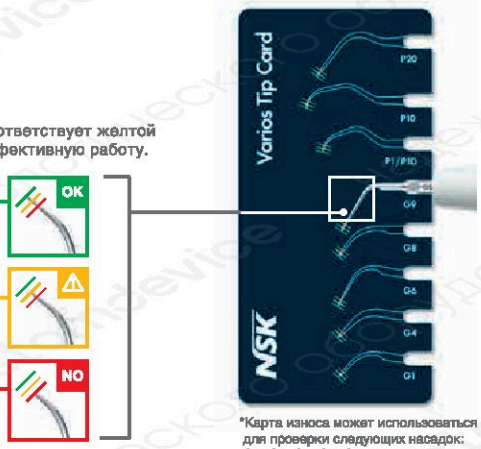

*Карта износа может использоваться для проверки следующих насадок: G1, G4, G6, G8, G9, P1/P1D, P10 и P20.

Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента

Для насадок G1- G68D, G95, P1- P41, E15D, E30RD, E30LD, E31D, E32D и насадок V-типа.
* Затягивайте насадки ключом до щелчка.



Ключ для замены насадок E-типа

Для насадок V10 (V-держатель), E4, E4D, E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11, E12 и насадок V30 (V-держатель).



 https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Видео по насадкам Varios

Посмотрите видео по работе насадок Varios на указанных ниже веб-сайтах,
чтобы убедиться, что «точность и качество работы» - синонимы NSK.

Серия ультразвуковых скалеров Varios



- Описание серии [Varios 970]
- Обслуживание

Насадка Varios



- Описание насадки

NAKANISHI INC. *www.nsk-inc.com*
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Rus & CIS *www.nsk-russia.ru*
2, Entuziastov bulvar, 11th floor, Moscow 109544, Russia

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

NSK

CREATE IT.

www.nsk-inc.com

РУССКИЙ ЯЗЫК
PR-D1095RU Ver.1 16.12.NRC

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ