stomdevice

инструкция по эксплуатации

NSK

Прямой наконечник с внутренней системой подачи охлаждения

S-Max M65

S-Max MS

CE 0197

Перед использованием устройства внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

MADE IN JAPAN

OM-H0189E

Powerful Partners®

РУССКИЙ

Назначение

Наконечник предназначен только для стоматологического лечения и использования только квалифицированным персоналом.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во время работы необходимо уделять особое внимание безопасности пациента.
- Запрещается самостоятельно разбирать устройство и вносить изменения в его конструкцию.
- Проверяйте уровень вибрации, шума и тепловыделения устройства вне полости рта пациента. При обнаружении любых неполадок немедленно прекратите работу и обратитесь за ремонтом к дилеру.

- Не подсоединяйте, не отсоединяйте наконечник до полной остановки мотора.
- Для предотвращения выпадения бора и обеспечения его надежного крепления в цанге, хвостовик должен всегда оставаться чистым.
- Для вашей безопасности и во избежании причинения вреда вашему здоровью работайте в защитных очках и пыленепроницаемой маске.

1. Характеристики

- Наконечник S-Max M65 предназначен для работы с CA борами (ISO1797-1 Тип 1) и HP борами.
- Запатентованная система очистки головки предотвращает попадание крови и загрязняющих веществ внутрь головки наконечника.
- Точная работа с минимальной вибрацией.
- Минимальный уровень тепловыделения.
- Автоклавирование при макс. температуре до 135°C.

2. Присоединение / Отсоединение наконечника

(1) Присоединение
Осторожно соедините соответствующие разъемы наконечника и мотора и сдвиньте их вместе.

(2) Отсоединение
Возьмите мотор и наконечник и аккуратно разъедините их по прямой линии.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3. Установка бора

(1) HP боры

Установка бора

1) Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до характерного щелчка.
2) Вставьте бор.
3) Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [C] до щелчка. Убедитесь, что черные метки расположены на одной линии (см. рисунок ниже).

Извлечение бора

Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до характерного щелчка и извлеките бор.

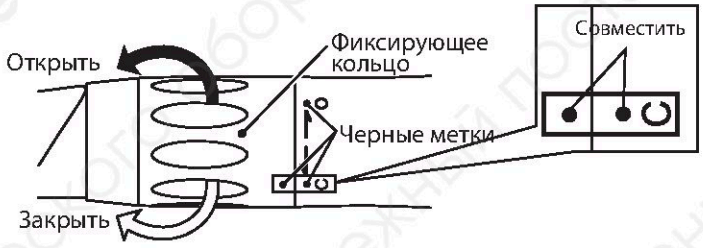


Рис. 1

(2) CA боры

Установка бора

1) Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до щелчка.
2) Вставьте прилагающийся ограничитель бора в цангу.
3) Вставьте CA бор до упора.
4) Поверните кольцевой зажим по направлению к метке [C] до щелчка. Убедитесь, что черные метки совпали.



Рис. 2

Извлечение бора

Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до характерного щелчка и извлеките бор.

Извлечение ограничителя бора

1) Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до щелчка.
2) Вставьте инструмент для извлечения ограничителя бора в цангу, расположите инструмент в прорези ограничителя и вытащите его.

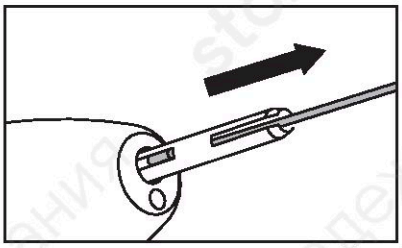


Рис. 3

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при использовании бора

- Перед началом работы убедитесь, что бор надежно закреплен в цанге. Неправильная установка бора может привести к выпадению бора из цанги и причинению вреда здоровью окружающих.
- Устанавливайте ограничитель бора в наконечник до упора. При неправильной установке впоследствии его будет трудно извлечь, что приведет к ослаблению цанги и выпадению бора.
- Не пользуйтесь гнутыми, поврежденными или нестандартными борами. Хвостовик может согнуться или сломаться даже при работе на рекомендованной скорости вращения.
- Не используйте угловые боры с коротким хвостовиком. Бор может выпасть из цанги и нанести вред.
- Не включайте мотор при открытом положении кольцевого зажима или когда бор не установлен в цангу.
- Не поворачивайте кольцевой зажим при вращении наконечника. Это может стать причиной отсоединения наконечника от мотора или вызвать мгновенное нагревание.
- Бор и/или ограничитель бора должны быть вставлены до упора. Это предотвратит выпадение бора и/или повреждение подшипников.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4. Обслуживание

См. руководство по тех. обслуживанию OM-Z0135E.


Наконечник можно чистить и дезинфицировать в термодезинфекторе.

Наконечник можно автоклавировать при макс. температуре до 135°C.

5. Сервисное обслуживание

Для замены картриджа требуются только оригинальные запчасти. За сервисным обслуживанием наконечников обращайтесь к вашему дилеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

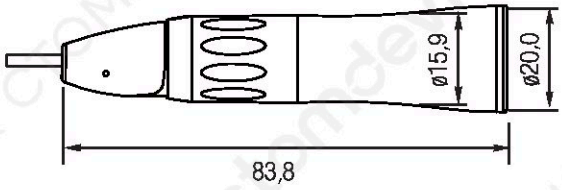

RUS

Макс. допустимая скорость: 40 000 об/мин
Используемые инструменты: Ø 2,35 мм HP боры
Ø 2,35 CA боры

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan

NSK Rus&CIS
www.nsk-russia.ru
115114, Россия, Москва,
Дербеневская наб.,7, стр.16

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

'09.03.02Ⓢ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ