stomdevice

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NSK

Хирургический микромотор с оптикой LED

SGL70M/SG70M

CE 0197

Перед использованием устройства внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее.

MADE IN JAPAN

ENGLISH OM-E0507E

Powerful Partners®

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Данный микромотор и колпачок для автоклавирования предназначены для использования только с Surgic Pro/Pro+. Не подключайте данный прибор к другим блокам управления.

Назначение

Микромотор может использоваться только квалифицированным персооналом в челюстно-лицевой хирургии.

⚠ Предостережение

- При работе с прибором в первую очередь следует уделять внимание безопасности пациента.
- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации к блоку управления до начала работы и ознакомьтесь со всеми функциями прибора и предназначением каждой части.
- Произведите калибровку крутящего момента наконечника до начала работы.
- Не пытайтесь разобрать микромотор и не вносите изменений в его внутреннюю конструкцию.
- Не роняйте, не ударяйте и не подвергайте прибор никаким чрезмерным механическим воздействиям.
- Не превышайте рекомендованной скорости вращения.
- При частом использовании прибора создайте небольшой запас запасных частей в целях его своевременного обслуживания.
- Не отсоединяйте кабель от микромотора.
- Не протирайте, не чистите и не погружайте прибор в растворы с высокой кислотностью, стерилизационные или электролизованные окисляющие растворы.

1. Присоединение/Отсоединение

1-1 Присоединение/Отсоединение микромотора

Совместите метку [•]на штекере кабеля мотора с меткой [•] на блоке управления.
Вставьте штекер в разъем до характерного щелчка.

Для отсоединения кабеля мотора потяните за фиксирующее кольцо и отсоедините штекер.

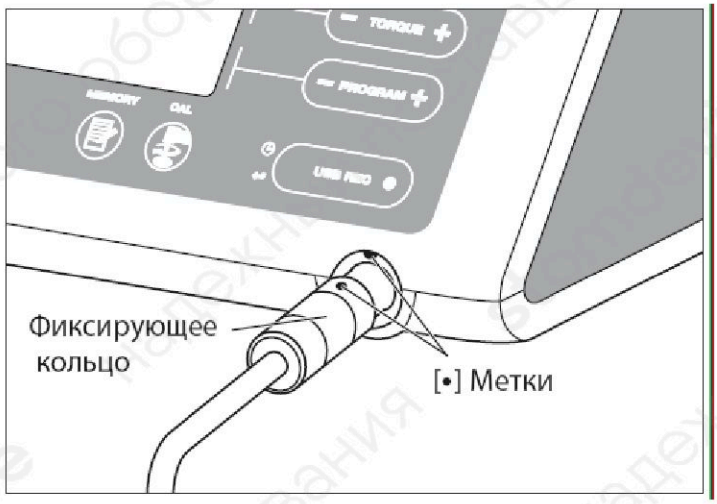


Рис. 1

1-2 Присоединение/Отсоединение наконечника

Для подключения наконечника E-типа совместите соответствующие разъемы мотора и наконечника и сдвиньте их до характерного щелчка. (Рис. 2)
(Позиционирующие штифты попадут в пазы)

Чтобы отсоединить наконечник от мотора, просто разъедините их.

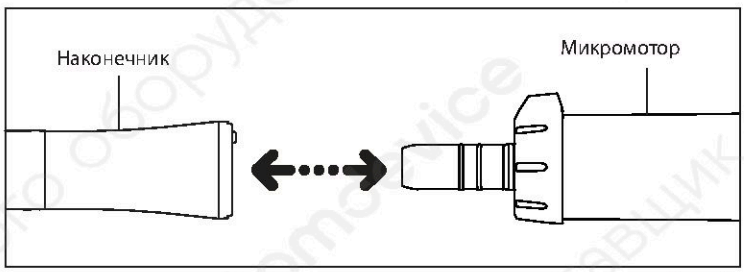


Рис. 2

⚠ Предостережение

- Будьте осторожны при работе с наконечниками, которые требуют периодической смазки. После смазки поставьте наконечник в вертикальном положении, чтобы лишнее масло вытекло из него. Протрите наконечник и затем установите его на мотор.
- Если масло попадет внутрь мотора, это может привести к неисправности.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

2. Обслуживание

В качестве метода стерилизации мы рекомендуем автоклавирование. Стерилизация по процедуре описанной ниже необходима перед первым использованием и после каждого пациента.

■ Автоклавирование

1) Удалите кровь и грязь с наконечника и мотора.
2) Смажьте и очистите наконечник внутри при помощи спрея.
   - Не смазывайте мотор и не распыляйте спрей внутрь него.
   - Оденьте колпачок для автоклавирования на мотор. (Рис.3)
3) Поместите наконечник и мотор в пакеты для автоклавирования (не входят в комплект) и запечатайте их.
4) Автоклавируйте при макс. температуре до 135°C. (Автоклавируйте в течение 20 мин. при 121°C или 15 мин. при 132°C)
5) Храните наконечник и мотор в пакетах, чтобы они оставались стерильными до следующего использования.

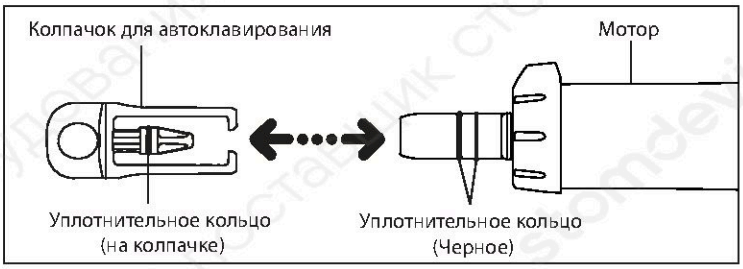


Рис. 3

*Стерилизация при 121°C в течение более чем 15 минут рекомендована стандартами EN13060 или EN554.

■ Замена уплотнительных колец

Если уплотнительные кольца износились, и наконечник стало сложно подключить к мотору, замените уплотнительные кольца.
Удалите уплотнительные кольца со втулки мотора или с колпачка для автоклавирования при помощи острого инструмента и установите новые кольца в пазы.

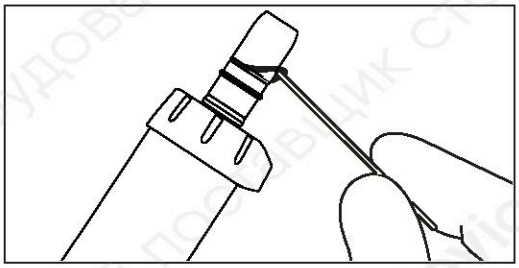


Рис. 4

Дополнительный колпачок для автоклавирования
Код заказа: 10001595
Уплотнительное кольцо (Черное)
Код заказа: 03120740080
Уплотнительное кольцо (на колпачке)
Код заказа: 0312457102
*Аксессуары: Колпачок для автоклавирования, Уплотнительные кольца (2 типа по 2 шт. каждого)

⚠ Предостережение

- Не смазывайте мотор.
- Не отсоединяйте кабель от мотора.
- Ирригационные шланги являются одноразовым расходным материалом и их нельзя автоклавировать.
- Вы можете повесить колпачок для автоклавирования на штатив, чтобы не потерять его.
- Не вешайте мотор за колпачок. Это может привести к падению мотора и возникновению неисправности.

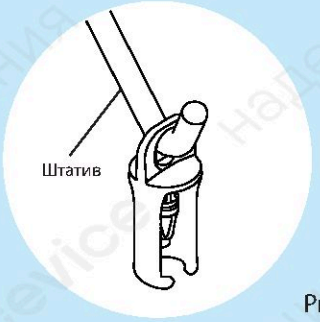


Рис. 5

CE Разработка и производство данного медицинского устройства проводились в соответствии с директивой EC 93/42/EEC.

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan

NSK RUS & CIS
www.nsk-russia.ru
115114, Россия, Москва,
Дербеневская наб., д.7,
стр.16, 3-й этаж

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

RU

Характеристики

Модель	SGL70M	SG70M
Тип	E1023	E1025
Скорость вращения	200 – 40 000 об/мин	
Входное напряжение	Пост. ток 24В	
Размеры	Ø23,5хД103,3 мм (без кабеля)	
Длина кабеля	2 м	
ОПТИКА	Светодиодная	–

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ