stomdevice

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПЫЛЕВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
АР.93.00

ОЛИЕС

В данной инструкции описаны основные требования по безопасности и уходу за оборудованием.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети	220 В, 50 / 60 Гц
Мощность	1000 Вт
Производительность	42 л/сек
Уровень шума	72 dB (A)
Длина сетевого шнура	10 м.
Вес	8 кг.
Размеры	340x340x540 мм.
Вместительность	14 л.

МОТОР

Двухступенчатый однофазный (два вентилятора из жесткого алюминия и один неподвижный вентилятор). Несущий винт на 2 спаренных подшипниках.
Поршень насоса: стержень из закаленной стали на 4 колесиках
Фильтр: противопыльный, самоочищающийся из полистирола и войлока

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ:

Устройство не предназначено для работы с горючими материалами (газ, бензин, краска, мусор после проведения сварочных работ, и т.д.)

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Всегда отключайте устройство от сети, если вы его не используете, при чистке фильтра или во время технического обслуживания.
- При перемещении устройства не перекручивайте провода и шланги.
- Не тяните за провод при отключении устройства от сети.
- После использования отключите устройство от сети, сверните должным образом провод и шланг и поставьте устройство в сухое и чистое место

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Устройство должно быть подключено к сети переменного тока соответствующей стандартам CEI 86/90 рассчитанной на потребляемую мощность не менее 1000 ватт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВКЛЮЧЕНИЕ:

Устройство включается посредством водонепроницаемого выключателя
0 – выключено 1- включено

БУМАЖНЫЙ ФИЛЬТР

Устройству не требуются дополнительные фильтры.
Весь всасываемый мусор скапливается внутри контейнера.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Отсоедините устройство от сети.
Откройте две защелки, снимите мотор и основной фильтр и снимите бумажный фильтр.
Вставьте новый фильтр, установите основной фильтр кромкой на выступы основания, установите мотор и закройте защелки.
Рекомендуем менять фильтр при его заполнении на 2/3.

ЧИСТКА ОСНОВНОГО ФИЛЬТРА

Эффективность работы устройства зависит от чистоты основного фильтра.
Регулярно очищайте основной фильтр с помощью обычного пылесоса, щетки, или просто очистите его руками и вытрясите. Наилучшего результата можно достичь, продув фильтр струей сжатого воздуха не снимая его.

МОТОР

Для эффективной работы устройства, очень важно, чтобы никакие посторонние предметы не попали в мотор – это может привести к остановке или даже к поломке мотора.
Поэтому никогда не работайте с мокрым фильтром и не используйте устройство без фильтра или со сломанным фильтром.

НЕИСПРАВНОСТИ:

Если вы заметили, что устройство работает не на полную мощность, то:

- Почистите основной фильтр или замените бумажный;
- Проверьте, нет ли утечки воздуха через шланги – при обнаружении таковой, устраните течь


ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство сконструировано таким образом, что обслуживание практически не требуется. Однако регулярно проверяйте фильтры.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

N°	ОПИСАНИЕ	N°	ОПИСАНИЕ
01	Верхняя крышка	13	Мотор
02	Болты крепления верхней крышки	14	Кожух мотора
03	Верхняя часть кожуха	15	Нижняя часть мотора
04	Зажим провода	16	Кольцо с сеткой
05	Болты зажима провода	17	Основной фильтр
06	провод	18	Мусоросборник
07	Защитная оплетка провода	19	Защелки
08	выключатель	20	Шуруп крепления шланга
09	Болты верхней части кожуха	21	Основание
10	Средняя часть кожуха	22	Колеса
11	Шуруп	23	Разъем
12	Верхняя часть мотора	24	Пружинный крючок

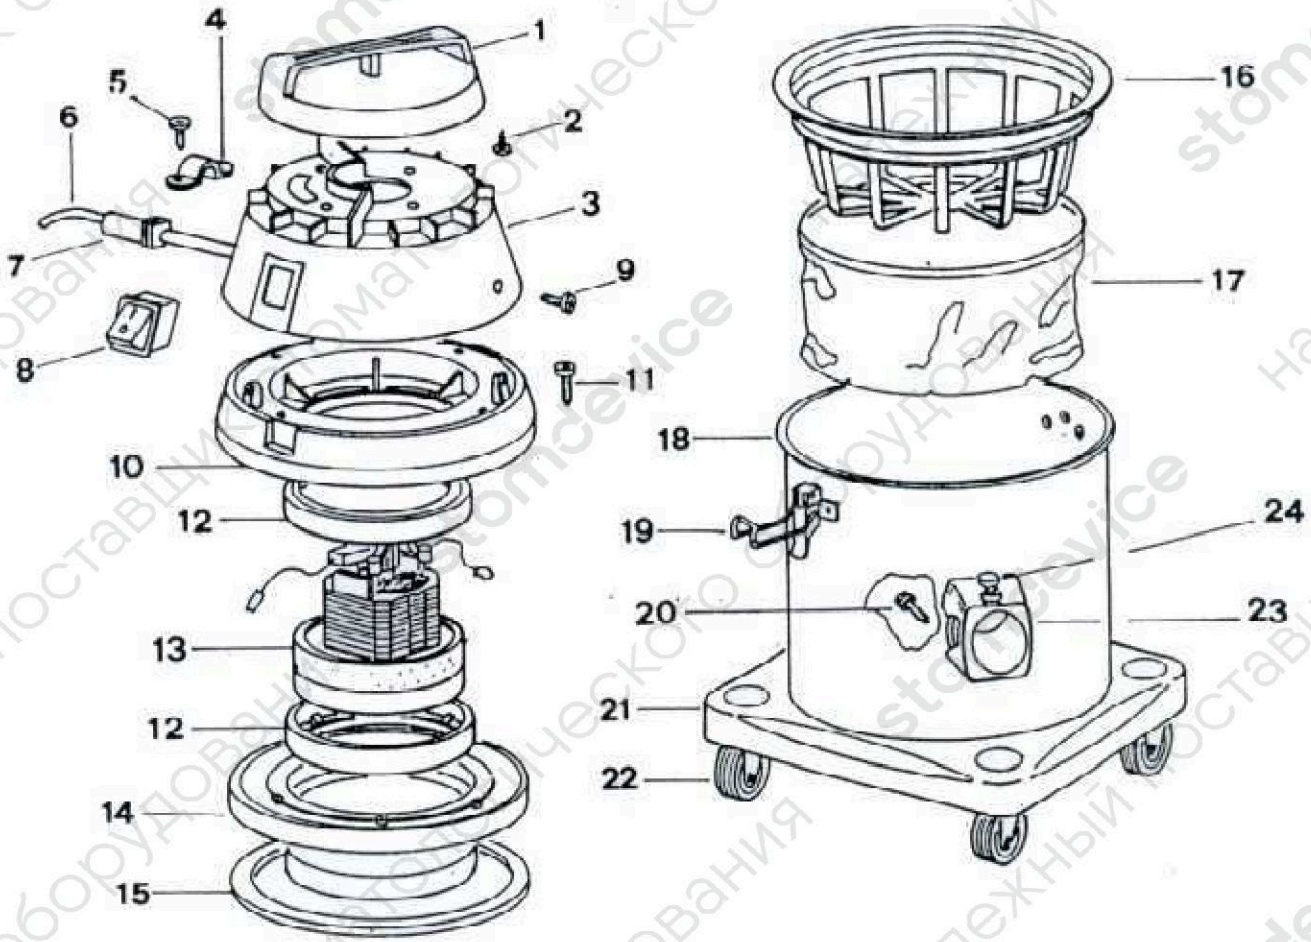

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ