stomdevice SAF SYSTEM by ReDent NOVA

Клинический протокол

Самоадаптирующийся файл (SAF)

1 ОЦЕНКА

A. Определение **рабочей длины**: рентген, апекслокатор

B. Определение **апикального размера**: первый К-файл, достигающий рабочей длины

C. Создание ковровой дорожки в соответствии с первым инструментом, достигшим рабочей длины

2 КОВРОВАЯ ДОРОЖКА

< #10	#10	#15 - #20	#20 - #30	≥ #35
При необходимости обработайте устье канала				
Ручной файл до #10	Файл #15/.02	Файл #20/.04	SAF **1.5**	SAF **2.0**



V 02.2015

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SAF SYSTEM by ReDentNOVA

3 КОНТРОЛЬ

Проверка ковровой дорожки проводится с SAF вручную:

A. Чтобы убедиться, что SAF достигает рабочей длины

B. Чтобы проверить вертикальную ось

В узких изогнутых каналах эта процедура может потребовать до 4 попыток, при которых SAF вручную поворачивают на 90⁰.



Полная версия Клинического протокола: www.redentnova.com

4 ПОДГОТОВКА

A. Присоедините SAF к ирригационной трубке

B. Присоедините к голове наконечника

C. Скорость: 5000 оборотов в минуту; ирригация: 4мл/мин

D. Натяните трубку, чтобы регулировать скорость вращения

E. Работайте лёгкими клюющими движениями, без давления

F. Сохраняйте вертикальную ось

G. Убедитесь, что вне канала файл вращается

Перелечивание:

A. Удалите основную массу пломбировочного материала, чтобы создать ковровую дорожку


B. Проверьте вручную (обычно с помощью SAF 2.0 мм)

C. Используйте растворитель гуттаперчи (хлороформ и т.д.)

D. Используйте SAF в течении одной минуты без ирригации

E. Продолжайте работать в соответствии со стандартным протоколом

Рекомендуемый протокол ирригации при работе SAF:

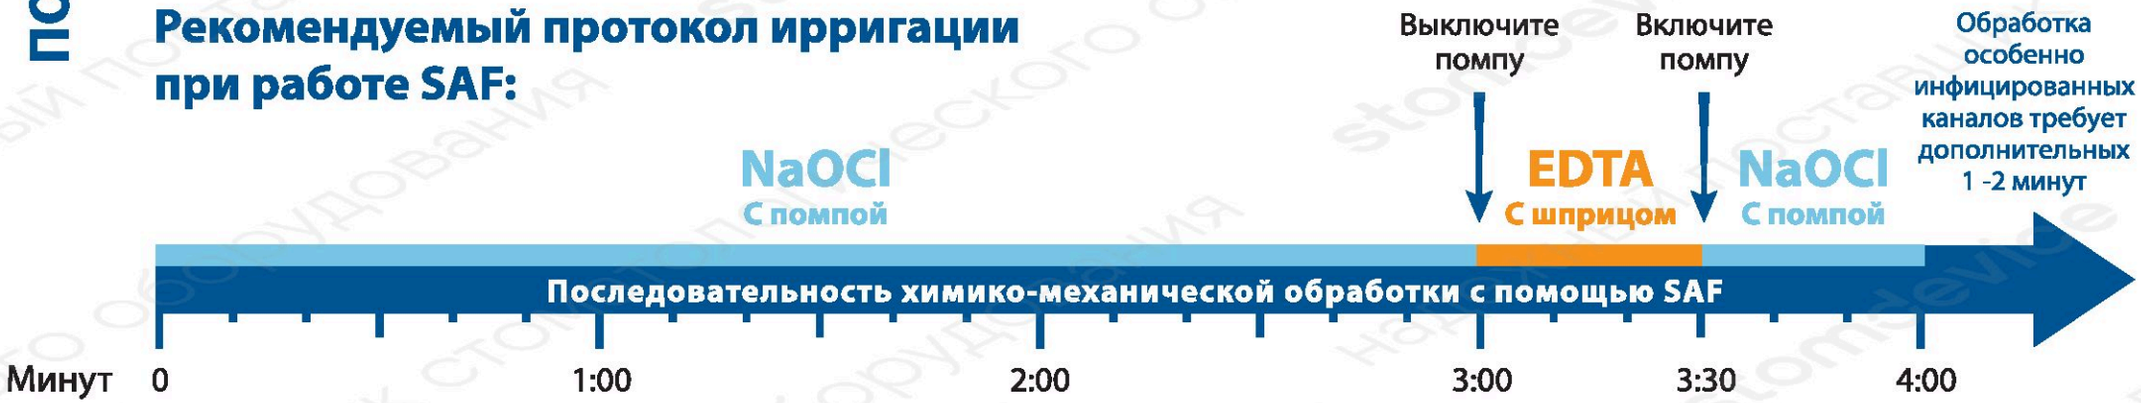

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ