stomdevice

TOP BM

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

МАТРИЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДИСКИ И ПОЛОСКИ

КЛИНЬЯ И ФИКСАТОРЫ

КЛАМПЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КОФФЕРДАМА



КОЛЛЕКЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

в библиотеку стоматологического искусства

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2021

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

О КОМПАНИИ

Российская компания «TOP BM» специализируется на производстве матричных систем и изделий для полировки с 1999 года. Мы выпускаем самый широкий ассортимент матриц в мире.

На предприятии внедрена система управления качеством, эффективность которой ежегодно подтверждается аудитами российских и международных сертифицирующих центров.

Собственные разработки компании защищены 9 патентами. Изделия «TOP BM» экспортируются более, чем в 75 стран мира.

О ПРОДУКЦИИ

В каталоге мы постарались представить информацию так, чтобы она была понятна и продвинутым, и начинающим пользователям. Дополнительная информация (видео и фото клинических случаев) размещена на нашем сайте www.torvm.ru в разделах «ФОТО» и «ВИДЕО».

По всем неясным вопросам о продукции или о том, с чего начать и как лучше использовать изделия «TOP BM», обращайтесь:
1) по электронной почте torvm77@gmail.com
2) через закладку «Задать вопрос» на главной странице нашего сайта www.torvm.ru
3) через соц.сети
https://vk.com/torvm

НОВИНКИ 2019 - 2020 гг.

В 2020 году торговая марка «TOP BM» TOR M была зарегистрирована в большинстве стран-импортеров.

В соответствии с этим изменился дизайн этикеток для всех изделий «TOP BM». Переход на новые этикетки будет осуществляться в течение 2020-2021 годов.


В последнее время в ассортименте продукции «TOP BM» появилось много новых изделий. Представленная ниже схема позволит быстро выделить новинки из всего многообразия продукции, выпускаемой «TOP BM».

2021


Матрицы двойные для передних зубов, стр. 18



Полоски алмазные, стр. 29

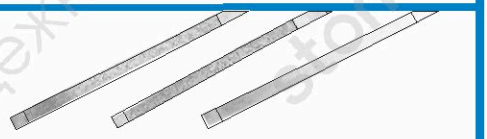

Держатели полосок, стр. 29

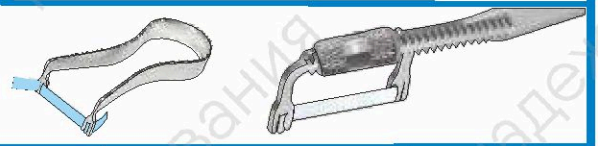

2020

Держатели установочные, стр. 17



Матрицы лепестковые, стр. 17



2019

Диски шлифовальные с металлической втулкой с повышенной шлифующей способностью, стр. 30



Полоски контурные для аппроксимальных поверхностей фронтальных зубов, стр. 18



Новые формы и новое качество всех клампов, темные клампы стр. 4



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ОГЛАВЛЕНИЕ

4 СИСТЕМА КОФФЕРДАМ. КЛАМПЫ

5 ЩИПЦЫ, ПОДСТАВКИ, РАМКИ

6 СИСТЕМА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ИЗ МЕЖЗУБНОГО ПРОМЕЖУТКА

7 ПЛАСТИНЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ, ВАЛИКОДЕРЖАТЕЛИ, РЕТРАКТОРЫ

8 МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТУРНЫЕ

9 МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТУРНЫЕ С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

10 МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАМКОВЫМ ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

12 МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТУРНЫЕ «ПОНИ»

13 МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

14 МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ

17 МАТРИЦЫ ЛЕПЕСТКОВЫЕ. ДЕРЖАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ

18 МАТРИЦЫ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ. ПОЛОСКИ СЕПАРАЦИОННЫЕ. МАТРИЦЫ КОЛЬЦЕВЫЕ

19 МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛОСКИЕ

19 МАТРИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ (МЕТАЛЛ / ЛАВСАН)

20 КЛИНЬЯ ФИКСИРУЮЩИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

21 КЛИНЬЯ ФИКСИРУЮЩИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

21 ФИКСАТОРЫ КОЛЬЦЕВЫЕ «ЭЛАСТИК»

22 НАСАДКИ СИЛИКОНОВЫЕ. КОНТАКТ-ФОРМЕРЫ

23 МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ ЛАВСАНОВЫЕ (СЕКЦИОННЫЕ)

23 МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ ЛАВСАНОВЫЕ С ФИКСИРУЮЩИМ КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ

24 МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ ЛАВСАНОВЫЕ

25 МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ ЛАВСАНОВЫЕ С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

26 МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ ЛАВСАНОВЫЕ ЗАКРЫТЫЕ (КОЛПАЧКИ)

28 МАТРИЦЫ ЛАВСАНОВЫЕ СЕПАРАЦИОННЫЕ

29 ПОЛОСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ. ДЕРЖАТЕЛИ ПОЛОСОК

30 ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВТУЛКОЙ. ДИСКОДЕРЖАТЕЛИ

31 ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ВТУЛКОЙ. ДИСКОДЕРЖАТЕЛИ

Обращаем внимание, что полные названия изделий вынесены в заглавие раздела, например, «Матрицы металлические контурные с фиксирующим устройством», возле номера для заказа приведено короткое название с уточнением назначения, например, - «Матрицы для моляров».

Данный каталог носит исключительно информационно-методический характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии изделий обращайтесь к менеджерам компании.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Клампы

Клампы Бринкера (ретракторы десневого края)



№ B1 № B2 № B3 № B4 № B4-M *НОВИНКА* № B5 № B6

Клампы для передних зубов



№ 9 № W9 № 210 № 212

Клампы для премоляров


Симметричные клампы



№ 0 № 00 № 1 № 2 № 2A № W2 № W2A

Клампы для моляров

Симметричные клампы

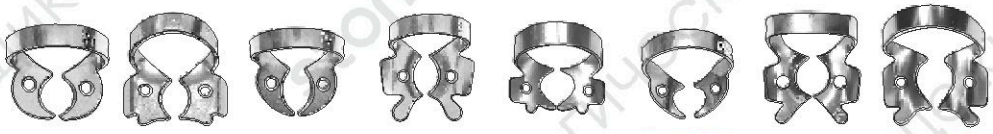

№ W3 № 7 № W7 № 8 № 8A № W8A № 14 № 14A



№ W56 № 201 № 202


Клампы «правый - левый»



№ 12A № 13A № 24 № 25 № 138 № 139 № 22 № 23

Клампы для детских зубов

Клампы «правый - левый»

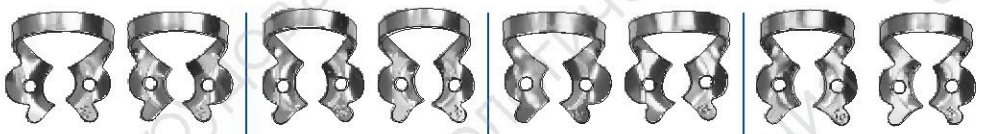

№ 64 № 74 № 65 № 75 № 54 № 84 № 55 № 85



№ P1 № P2

Клампы изготовлены из высококачественной упругой нержавеющей стали, обеспечивающей отличную память формы.

Клампы Бринкера обеспечивают эффективную ретракцию без повреждения десневого края.

У клампа **B4-M** рабочие части тоньше, чем у клампа **B4**.



Различают бескрылые клампы и клампы с крыльями.

Все клампы выпускаются в стандартном и темном исполнении. Клампы темной модификации (темные клампы) обеспечивают удобство в работе за счет антибликовых свойств.




Для заказа темных клампов добавляйте букву «**B**» к номеру клампа - например, **№ B4-B** или **№ 2-B**.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ









https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



№ 3.014 **Клампы, набор** 10 шт.
НОВИНКА
№B4, №0, №2, №2A, №7, №8, №9, №12A, №13A, № W56



№ 3.016 **Клампы детские, набор** 10 шт.
НОВИНКА
№54, №55, №64, №65, № 74, №75, №84, №85, №P-1, №P-2



№ 3.017 **Клампы, набор** 9 шт.
НОВИНКА
№1, №7, №8, №8A, №9, №14, №201, №202, №212

Рекомендуемая методическая литература по работе с системой коффердам



И.М. Макеева, А.И. Николаев Восстановление зубов светоотверждаемыми композитными материалами. Практическое руководство для врачей стоматологов-терапевтов Москва: «МЕДпресс-информ», 2011 г.



Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. Учебное пособие под редакцией проф. И.М. Макеевой. Москва: «МЕДпресс-информ», 2007 г.

Щипцы установочные



№ 3.991 **Щипцы установочные** 1 шт.

Ножки щипцов № 3.991





№ 3.993 **Щипцы установочные** 1 шт.


Ножки щипцов № 3.993




Щипцы установочные изготовлены из высококачественной стали. Щипцы удобно фиксируются в ладони и надежно удерживают в растянутом состоянии любой кламп. Щипцы действуют по принципу телескопических щипцов - бранши щипцов открываются при сжимании ручек. Ретенционные шипы на "щечках" щипцов вводятся в отверстия на клампе, щипцы фиксируются в раздвинутом состоянии. Рамка-ограничитель свободно передвигается по ручкам щипцов между их изгибом и центральным фиксирующим винтом и позволяет снизить физическую нагрузку в процессе установки клампа.

ВНИМАНИЕ!
При стерилизации:
- не используйте растворы с высокой концентрацией хлора и растворы, содержащие щавелевую кислоту;
- не оставляйте изделия в растворе более, чем на 3 часа.

Подставки для стерилизации клампов



№ 3.909 **Подставка для стерилизации клампов** (на 9 клампов) 1 шт.



№ 3.912 **Подставка для стерилизации клампов** (на 12 клампов) 1 шт.

Подставки можно также использовать в качестве органайзера - для хранения клампов.



Шип для установки клампа имеет 3 посадочных диаметра для устойчивой фиксации любого клампа без избыточного разведения

Рамки для коффердама




№ 3.401A **Рамка для коффердама, детская,** 96x73 мм, 1 шт.

№ 3.401B **Рамка для коффердама,** с фиксаторами нити, 93мм x 91мм, 1 шт.

№ 3.402B **Рамка для коффердама,** с фиксаторами нити, 110мм x 100мм, 1 шт.

№ 3.403B **Рамка для коффердама,** с фиксаторами нити, 128мм x 125мм, 1 шт.

Винты на рамках №№ 3.401B, 3.402B и 3.403B предназначены для фиксации концов нити, используемой для фиксации клампа или коффердама в десневой борозде.

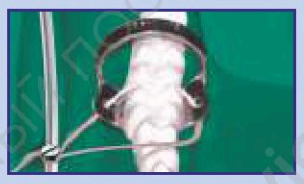



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Система для удаления материала из межзубного промежутка

Система предназначена для удаления излишков пломбировочного материала из межзубных промежутков и сепарации зубов при фиксации виниров.

Система включает
- полоски сепарационные зубчатые,
- полоски сепарационные с алмазным напылением 3-х видов зернистости,
- держатели полосок.

Полоски без отверстий на краях (тип 1) подходят только для фиксации держателем № 1.369, полоски с отверстиями на краях (тип 2) - только для фиксации держателем № 1.389.




№ 1.384(1) **Полоски сепарационные зубчатые**
тип 1, толщина 50 мкм, 12 шт.



№ 1.385C1 **Полоски сепарационные крупнозернистые,**
до августа 2020г. № 1.385K(1) тип 1, толщина 150 мкм, 12 шт.

№ 1.385M1 **Полоски сепарационные среднезернистые,**
до августа 2020г. № 1.385C(1) тип 1, толщина 100 мкм, 12 шт.

№ 1.385F1 **Полоски сепарационные мелкозернистые,**
до августа 2020г. № 1.385M(1) тип 1, толщина 70 мкм, 12 шт.

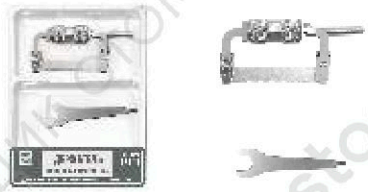

№ 1.369 **Держатель полосок сепарационных**

держатель полосок сепарационных № 1.369B	- 1 шт.
ключ № 1.369K	- 1 шт.



№ 1.367KT **Держатель с ручкой**

держатель полосок сепарационных № 1.369B	- 1 шт.
ключ № 1.369K	- 1 шт.
ручка № 1.107	- 1 шт.



№ 1.369KT **Держатель с ручкой**

держатель полосок сепарационных № 1.369B	- 1 шт.
ключ № 1.369K	- 1 шт.
ручка № 1.109	- 1 шт.



№ 1.370 **Набор полосок сепарационных с держателем и ключом**

полоски № 1.384(1)	- 12 шт.
полоски № 1.385C1	- 12 шт.
полоски № 1.385M1	- 12 шт.
полоски № 1.385F1	- 12 шт.
держатель полосок сепарационных № 1.369B	- 1 шт.
ключ № 1.369K	- 1 шт.
ручка-держатель № 1.109	- 1 шт.

Ручки-держатели



№ 1.107 **Ручка-держатель**, 1 шт.



№ 1.109 **Ручка-держатель**, 1 шт.

Работа с держателем № 1.369


1) Вращая винт ***1***, сдвиньте ножки держателя так, чтобы расстояние между внешними краями ножек было равно длине полоски



2) Вставьте полоску в зажимы ***2*** на ножках держателя и затяните зажимы ключом ***3***



3) Вращая винт ***1***, натяните полоску



4) Плотно вставьте штырь ***4*** держателя в ручку-держатель

Возможна работа без присоединения держателя к ручке - роль ручки выполняет штырь ***4***, для работы можно также фиксировать штырь ***4*** в наконечнике типа EVE, позволяющем создавать возвратно-поступательное движение.

Работа с ручкой-держателем № 1.107

Вставить держатель в гнездо ***1*** ручки **№1.107** и зафиксировать, затянув верхнюю гайку ***2*** с помощью ключа. Вращая верхнюю рельефную часть ***3*** ручки, разблокировать соединение, выбрать нужный угол и зафиксировать положение вращением рельефной части ***3*** ручки.



Работа с ручкой-держателем № 1.109

Требуемое рабочее положение обеспечивается размещением держателя в одно из отверстий ручки **№ 1.109.**



3 отверстия в ручке-держателе позволяют фиксировать штырь держателя в любом из трех положений: вдоль оси ручки (0°), перпендикулярно (±90°) и под углом (±45°) к оси ручки

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



№ 1.384(2) **Полоски сепарационные зубчатые**
тип 2, толщина 50 мкм, 12 шт.




№ 1.385C2 **Полоски сепарационные крупнозернистые,**
до августа 2020г. № 1.385K(2)
тип 2, толщина 150 мкм, 12 шт.



№ 1.385M2 **Полоски сепарационные среднезернистые,**
до августа 2020г. № 1.385C(2)
тип 2, толщина 100 мкм, 12 шт.



№ 1.385F2 **Полоски сепарационные мелкозернистые,**
до августа 2020г. № 1.385M(2)
тип 2, толщина 70 мкм, 12 шт.



№ 1.389 **Держатель полосок сепарационных**
(только для полосок с отверстиями (тип 2)), 1 шт.

Работа с держателем № 1.389

1) Вставить выступ на ножке ***1*** держателя в отверстия на полоске ***4***, загнуть полоску ***4*** вокруг ножки ***1*** держателя



2) Обогнуть полоску ***4*** вокруг ножки ***2***, вставить выступ на ножке ***2*** в другое отверстие полоски



3) Затянуть полоску ***4*** между ножками ***1*** и ***2***, вращая ручку ***3*** держателя с резьбой



Пластины для удаления зубного камня



№ 1.386 **Пластины для удаления зубного камня**
12 шт., ширина 4 мм, длина 100 мм

Пластины для удаления зубного камня



схематичный вид сбоку



Валикодержатели



№ 1.010 **Валикодержатель**
1 шт.

Валикодержатели предназначены для фиксации ватных валиков при проведении стоматологических манипуляций



Ретракторы

НОВИНКА



№ 1.016S **Ретрактор для укладки нити малый**
1 шт.



№ 1.019 **Ретрактор**
(с резьбовым соединением для ручки)
1 шт.




№ 1.119 **Ретрактор**
(в сборе с ручкой)
1 шт.



№ 1.013 **Ретрактор**
1 шт.

Ретракторы обеспечивают надежную изоляцию рабочего поля и максимально удобный доступ к зубному ряду, препятствуя попаданию языка и щеки в рабочее пространство





Матрицы металлические контурные

Выпускаются толщиной 35 и 50 мкм. При заказе в скобках после номера указывайте толщину. Например, №1.512(50).

Матрицы характеризуются высокой анатомичностью форм,обеспечивают идеальные условия для восстановления контактных областей.



для премоляров

№ 1.501 **Матрицы для премоляров**
без выступа,
высота рабочей части 5 мм
12 шт.

№ 1.502 **Матрицы для премоляров**
билатеральные
12 шт.

№ 1.506 **Матрицы для премоляров**
билатеральные,
12 шт.

№ 1.503 **Матрицы для премоляров**
выступ слева
12 шт.

№ 1.504 **Матрицы для премоляров**
выступ справа
12 шт.

№ 1.505 **Матрицы для премоляров**
центральный выступ,
12 шт.



для моляров

№ 1.511 **Матрицы для моляров**
без выступа,
высота рабочей части 7 мм
12 шт.

№ 1.517 **Матрицы для моляров**
без выступа,
высота рабочей части 6 мм
12 шт.


№ 1.512 **Матрицы для моляров**
билатеральные
12 шт.

№ 1.513 **Матрицы для моляров**
выступ слева
12 шт.

№ 1.514 **Матрицы для моляров**
выступ справа
12 шт.

№ 1.515 **Матрицы для моляров**
центральный выступ,
12 шт.

Пример работы



С матрицедержателем Нустрем

Формы билатеральных матриц



№ 1.502
№ 1.506
№ 1.512

Варианты установки матриц

Матрицедержателями Тоффльмайра или Нустрем



С использованием системы Супермат



с помощью кольца «Слот» (см. стр.12 Каталога)



Матрицедержателем пружинным фиксатором Слот (см. стр.12 Каталога)



Для работы с матрицедержателем Тоффльмайра удобнее использовать удлиненные матрицы №№ 1.505,1.506,1.511,1.515, 1.517. Матрицы №№ 1.501 и 1.517 оптимальны для матрицедержателя Нустрем. При работе с системой Супермат рекомендуется использовать матрицы №№ 1.502-1.504,1.513,1.514 толщиной 35 мкм; концы матриц №№ 1.505, 1.506, 1.512, 1.515,1.517 следует укорачивать.



№ 1.500+ **Матрицы для премоляров**
30 шт.:
№ 1.501 6 шт.
№ 1.502 6 шт.
№ 1.503 6 шт.
№ 1.504 6 шт.
№ 1.505 6 шт.



№ 1.510+ **Матрицы для моляров**
30 шт.:
№ 1.511 6 шт.
№ 1.512 6 шт.
№ 1.513 6 шт.
№ 1.514 6 шт.
№ 1.515 6 шт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы металлические контурные с фиксирующим устройством (матрицы-«восьмерки»)

Выпускаются толщиной 35 мкм.



для премоляров

№ 1.541 **Матрицы для премоляров**
центральный выступ
10 шт.



№ 1.542 **Матрицы для премоляров**
билатеральные
10 шт.



№ 1.543 **Матрицы для премоляров**
выступ слева
10 шт.



№ 1.544 **Матрицы для премоляров**
выступ справа
10 шт.



№ 1.545 **Матрицы для премоляров**
без выступа
10 шт.



№ 1.549 **Матрицы для премоляров**
№ 1.543 + № 1.544
10 шт. (5 шт. + 5 шт.)





№ 1.540 **Набор матриц для премоляров**
16 шт.:
№ 1.541 3 шт.
№ 1.542 3 шт.
№ 1.543 3 шт.
№ 1.544 3 шт.
№ 1.545 4 шт.



№ 1.560 **Набор матриц для моляров и премоляров**
без выступа 10 шт.
(5 шт. - для премоляров + 5 шт. - для моляров)





для моляров

№ 1.551 **Матрицы для моляров**
центральный выступ
10 шт.



№ 1.552 **Матрицы для моляров**
билатеральные
10 шт.



№ 1.553 **Матрицы для моляров**
выступ слева
10 шт.



№ 1.554 **Матрицы для моляров**
выступ справа
10 шт.



№ 1.555 **Матрицы для моляров**
без выступа
10 шт.



№ 1.559 **Матрицы для моляров**
№ 1.553 + № 1.554
10 шт. (5 шт. + 5 шт.)






№ 1.550 **Набор матриц для моляров**
16 шт.:
№ 1.551 3 шт.
№ 1.552 3 шт.
№ 1.553 3 шт.
№ 1.554 3 шт.
№ 1.555 4 шт.

Устанавливаются без матрицедержателя

Сжатие алюминиевого кольца в горизонтальной плоскости обеспечивает фиксацию матрицы вокруг зуба.

Установка матриц

Установить матрицу на зуб, сжать алюминиевое кольцо



Система в рабочем состоянии



Вариант работы на двух контактных пунктах с использованием матрицы-«восьмерки», клиньев, и колец (см. стр. 16 Каталога).



При таком варианте необязательно сжимать алюминиевое кольцо до тугого охвата зуба матрицей.

Примеры работы



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы металлические с замковым фиксирующим устройством

Матрицы плоские с замковым фиксирующим устройством



Все матрицы выпускаются трех форм и двух толщин (35 и 50 мкм). При заказе в скобках после номера указывайте форму и толщину. Например, заказывая №1.301(1)(50),Вы получите замковые матрицы формы 1 толщиной 50 мкм.

	Матрицы малые 12 шт. в упаковке	**Матрицы средние** 12 шт. в упаковке	**Матрицы большие** 12 шт. в упаковке
Стандартная форма	 **№ 1.301(1)**	 **№ 1.302(1)**	 **№ 1.303(1)**
Форма с подвижной центральной частью*	 **№ 1.301(2)**	 **№ 1.302(2)**	 **№ 1.303(2)**
Форма с увеличенным поддесневым выступом	 **№ 1.301(3)**	 **№ 1.302(3)**	 **№ 1.303(3)**

** Ширина матрицы в области между центральной частью и краями у матриц формы 2 меньше, чем в стандартном варианте (матрицы формы 1), что делает центральную часть более подвижной*

Матрицы контурные с замковым фиксирующим устройством



Все матрицы выпускаются трех форм и двух толщин (35 и 50 мкм). При заказе в скобках после номера указывайте форму и толщину. Например, заказывая №1.312(2)(35),Вы получите замковые матрицы формы 2 толщиной 35 мкм.

	Матрицы малые 12 шт. в упаковке	**Матрицы средние** 12 шт. в упаковке	**Матрицы большие** 12 шт. в упаковке
Стандартная форма	 **№ 1.311(1)**	 **№ 1.312(1)**	 **№ 1.313(1)**
Форма с подвижной центральной частью*	 **№ 1.311(2)**	 **№ 1.312(2)**	 **№ 1.313(2)**
Форма с увеличенным поддесневым выступом	 **№ 1.311(3)**	 **№ 1.312(3)**	 **№ 1.313(3)**

** Ширина матрицы в области между центральной частью и краями у матриц формы 2 меньше, чем в стандартном варианте (матрицы формы 1), что делает центральную часть более подвижной*


Края матриц выполнены в виде цилиндрических трубочек для введения ножек колец **№ 1.033**, **1.033с**, **1.033А** и матрицедержателей пружинных - фиксаторов **№ 1.003** или **№ 1.005**.

Выбор длины матрицы:



Варианты установки матриц с замковым фиксирующим устройством

Установка с фиксатором № 1.003



Установка с кольцом № 1.033



Одновременная реставрация 2-х зубов. Установка с кольцами



Установка с фиксатором № 1.005



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



№ 1.310 **Матрицы металлические замковые**
18 шт.:

№ 1.311(1)	6 шт.
№ 1.312(1)	6 шт.
№ 1.313(1)	6 шт.
фиксатор № 1.003	1 шт.



№ 1.320 **Матрицы металлические замковые**
18 шт.:

№ 1.311(1)	6 шт.
№ 1.312(1)	6 шт.
№ 1.313(1)	6 шт.
кольцо № 1.033	1 шт.



№ 1.330 **Матрицы металлические замковые. Универсальный набор**
36 шт.:

№ 1.301(1)	3 шт.
№ 1.302(1)	3 шт.
№ 1.303(1)	3 шт.
№ 1.311(1)	6 шт.
№ 1.312(1)	6 шт.
№ 1.313(1)	6 шт.
№ 1.311(2)	3 шт.
№ 1.312(2)	3 шт.
№ 1.313(2)	3 шт.
фиксатор № 1.003	1 шт.

Кольца и матрицедержатели пружинные - фиксаторы замыкающие



№ 1.033 **Кольцо**
1 шт.



№ 1.033c **Кольцо**
1 шт.



№ 1.033A **Кольцо**
1 шт.

Ножки колец **№ 1.033**, **№ 1.033c**, **№ 1.033A** (1,2 мм)



Петля в кольце № 1.033A обеспечивает сохранение упругих свойств кольца (сходимость ножек) при больших разведениях.



№ 1.003 **Матрицедержатель пружинный - фиксатор замыкающий малый**
1 шт.



№ 1.005 **Матрицедержатель пружинный - фиксатор замыкающий большой**
1 шт.

При работе с фиксаторами фиксация матрицы на зубе слабее, чем при использовании колец.

Установка с фиксатором


Выбирают матрицу нужной длины и вне полости рта вставляют ножки фиксатора в трубочки на краях матрицы



Устанавливают систему на зуб



Матрица на мезиальной поверхности



Установка с кольцом

Выбирают матрицу нужной длины и вне полости рта соединяют ее с кольцом.



Щипцами (см. стр.15 Каталога) устанавливают систему на зуб



Проводят реставрацию

ВНИМАНИЕ!

При работе с кольцом необходимо:
1) Перед началом работы убедиться в отсутствии на поверхности кольца следов ржавчины и признаков нарушения целостности кольца;
2) Все манипуляции по разведению кольца проводить вне полости рта пациента;
3) избегать резкого разведения кольца;
4) не допускать разведения ножек кольца на расстояние свыше 10-12 мм.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы металлические контурные «Пони»

Выпускаются толщиной 35 и 50 мкм. При заказе в скобках после номера указывайте толщину. Например, №1.342(35).





№ 1.341 **Матрицы «Пони» малые с выступом**
12 шт.



№ 1.342 **Матрицы «Пони» малые**
12 шт.



№ 1.343 **Матрицы «Пони» большие**
12 шт.



№ 1.344 **Матрицы «Пони» большие с выступом**
12 шт.



№ 1.340 **Матрицы металлические контурные «Пони»**
24 шт.:

№ 1.341	6 шт.
№ 1.342	6 шт.
№ 1.343	6 шт.
№ 1.344	6 шт.
фиксатор «Слот» **№ 1.004**	1 шт.



№ 1.350 **Матрицы металлические контурные «Пони»**
24 шт.:

№ 1.341	6 шт.
№ 1.342	6 шт.
№ 1.343	6 шт.
№ 1.344	6 шт.
кольцо «Слот» **№ 1.044**	1 шт.

Кольцо «Слот» и матрицедержатель пружинный - фиксатор «Слот»

Ножки кольца и фиксатора «Слот» выполнены с прорезями, в которые вставляют края матрицы. Специальный профиль прорези обеспечивает надежную фиксацию матрицы.
С кольцом и фиксатором «Слот» можно использовать любые матрицы достаточной длины. При работе необходимо следить за тем, чтобы край матрицы, обращенный к десне, не выступал из щели. При необходимости ширину матрицы на краях можно уменьшить ножницами.



№ 1.044 **Кольцо «Слот»**
1 шт.

Ножки кольца «Слот»



Схема установки на зубе





№ 1.004 **Матрицедержатель пружинный - фиксатор «Слот»**
1 шт.

Ножки фиксатора «Слот»




Схема установки на зубе



Матрицы «Пони» имеют минимальную длину, необходимую для полного охвата зуба, и позволяют проводить реставрацию при обширных разрушениях коронковой части зуба.

Пара больших матриц **№ 1.343** и **№ 1.344** является наиболее универсальной.

Установка матриц «Пони» с кольцом «Слот»



Вставляют концы матрицы «Пони» в прорези ножек кольца «Слот». Длину петли матрицы выбирают таким образом, чтобы она могла охватить около 3/4 длины реставрируемого зуба по окружности



Устанавливают систему на зуб с помощью щипцов (см. стр.15 Каталога)

ВНИМАНИЕ!

При работе с кольцом необходимо:
1) Перед началом работы убедиться в отсутствии на поверхности кольца следов ржавчины и признаков нарушения целостности кольца;
2) Все манипуляции по разведению кольца проводить вне полости рта пациента;
3) избегать резкого разведения кольца;
4) не допускать разведения ножек кольца на расстояние свыше 10-12 мм.

Установка матриц «Пони» с фиксатором «Слот»

Вставляют концы матрицы «Пони» в прорези ножек фиксатора «Слот».



Длину петли матрицы выбирают таким образом, чтобы она могла охватить около 3/4 длины реставрируемого зуба по окружности. Длину петли можно регулировать, перемещая концы матрицы.



После регулировки длины петли отгибают края матрицы и устанавливают систему на зуб




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы металлические перфорированные

Толщина перфорированных матриц 50 мкм

Матрицы плоские



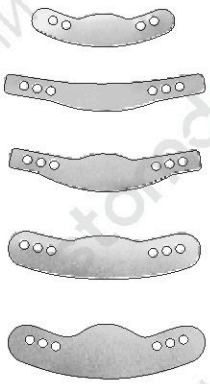

№ 1.331(1) **Матрицы перфорированные** 12 шт.

№ 1.331(2) **Матрицы перфорированные** 12 шт.

№ 1.331(3) **Матрицы перфорированные** 12 шт.

№ 1.331(4) **Матрицы перфорированные** 12 шт.

№ 1.331(5) **Матрицы перфорированные** 12 шт.

Матрицы контурные





№ 1.531(1) **Матрицы перфорированные** 12 шт.

№ 1.531(2) **Матрицы перфорированные** 12 шт.

№ 1.531(3) **Матрицы перфорированные** 12 шт.

№ 1.531(4) **Матрицы перфорированные** 12 шт.

№ 1.531(5) **Матрицы перфорированные** 12 шт.

Кольцо «Краб» и матрицедержатели пружинные



№ 1.022 **Кольцо «Краб»** 1 шт.

Для разведения и установки колец используют щипцы (см. стр. 15 Каталога)

Ножки кольца «Краб»






№ 1.002 **Матрицедержатель пружинный - фиксатор «Краб»** 1 шт.



№ 1.006 **Матрицедержатель пружинный - фиксатор Айвори** 1 шт.

Варианты установки перфорированных матриц

Матрицедержателем Айвори **№ 1.006**



Кольцом «Краб» **№ 1.022**



Фиксатором «Краб» **№ 1.002**



Как правило, соединение матрицедержателя с матрицей осуществляют вне полости рта, при этом рабочие элементы вставляют в те отверстия, которые при размещении матрицы на зубе окажутся примерно на одной линии с межзубным промежутком.

Рабочие элементы матрицедержателей напоминают клешню краба: они вставляются в отверстия на краях матрицы и, смыкаясь с противоположной от восставливаемого контактного пункта стороны зуба, фиксируют матрицу.

Ножки кольца **№ 1.022** и фиксаторов сточены для наилучшего вхождения в межзубный промежуток.

ВНИМАНИЕ!

При работе с кольцом необходимо:
1) Перед началом работы убедиться в отсутствии на поверхности кольца следов ржавчины и признаков нарушения целостности кольца;
2) Все манипуляции по разведению кольца проводить вне полости рта пациента;
3) избегать резкого разведения кольца;
4) не допускать разведения ножек кольца на расстояние свыше 10-12 мм.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы металлические секционные

Выпускаются четырех типов: твердые 50 мкм, твердые 35 мкм, мягкие 50 мкм, мягкие 35 мкм. Толщину и твердость матриц указывайте при заказе. Например, № 1.0972 - 50 мкм, твердые, или № 1.198 - 35 мкм, мягкие.*

* *Матрицы с номинальным названием "мягкие 50 мкм" могут выпускаться из твердого металла толщиной 40 мкм. В таком случае на упаковке наносится дополнительная поясняющая информация "твердые 40 мкм"*





№ 1.0971 **Матрицы малые с выступом** 10 шт.

№ 1.971 **Матрицы малые с выступом** 50 шт.





№ 1.0972 **Матрицы малые** 10 шт.

№ 1.972 **Матрицы малые** 50 шт.





№ 1.0973 **Матрицы большие** 10 шт.

№ 1.973 **Матрицы большие** 50 шт.





№ 1.0974 **Матрицы большие с выступом** 10 шт.

№ 1.974 **Матрицы большие с выступом** 50 шт.





№ 1.0975 **Матрицы средние с выступом** 10 шт.

№ 1.975 **Матрицы средние с выступом** 50 шт.





№ 1.0976 **Матрицы средние** 10 шт.

№ 1.976 **Матрицы средние** 50 шт.

Матрицы металлические секционные темные *НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ*





№ 1.0976В **Матрицы темные средние** 10 шт.
Выпускаются только мягкие толщиной 50 мкм

Матрицы металлические секционные средние выпускаются также в темной модификации. Антибликовые свойства темных матриц обеспечивают удобство в работе.



№ 1.1972 **Матрицы малые 4-х типов**, 30 шт.

50 мкм, твердые	10 шт.
35 мкм, твердые	10 шт.
50 мкм, мягкие	5 шт.
35 мкм, мягкие	5 шт.

№ 1.1976 **Матрицы средние 4-х типов**, 30 шт.

50 мкм, твердые	10 шт.
35 мкм, твердые	10 шт.
50 мкм, мягкие	5 шт.
35 мкм, мягкие	5 шт.



№ 1.1973 **Матрицы большие 4-х типов**, 30 шт.

50 мкм, твердые	10 шт.
35 мкм, твердые	10 шт.
50 мкм, мягкие	5 шт.
35 мкм, мягкие	5 шт.

Матрицы металлические секционные предназначены для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа.


Все матрицы - объемные, вогнутые, сформованы из специальной коррозионно-стойкой стали.

Тонкие матрицы удобно использовать для восстановления небольших дефектов, толстые - для реставрации больших кариозных полостей с разрушением в поддесневой области.

Толстые матрицы хорошо держат форму, что позволяет в ряде случаев не использовать клинья при восстановлении десневого бортика или придесневой стенки.

Твердые матрицы легче вводятся, однако, их адаптация для формирования контактного пункта затруднена.

Клинический случай







Варианты использования







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



№ 1.097 **Матрицы металлические секционные** 15 шт.:

№ 1.0971 (малые с выступом)	5 шт.
№ 1.0972 (малые)	10 шт.



№ 1.098 **Матрицы металлические секционные** 25 шт.:

№ 1.0972 (малые)	10 шт.
№ 1.0973 (большие)	10 шт.
№ 1.0974 (большие с выступом)	5 шт.



№ 1.198 **Матрицы металлические секционные** 30 шт.:

№ 1.0971 (малые с выступом)	3 шт.
№ 1.0972 (малые)	10 шт.
№ 1.0973 (большие)	5 шт.
№ 1.0974 (большие с выступом)	3 шт.
№ 1.0975 (средние с выступом)	4 шт.
№ 1.0976 (средние)	5 шт.
кольцо **№ 1.099(5)**	1 шт.



№ 1.298 **Матрицы металлические секционные** 50 шт.:

№ 1.0971 (малые с выступом)	5 шт.
№ 1.0972 (малые)	15 шт.
№ 1.0973 (большие)	10 шт.
№ 1.0974 (большие с выступом)	5 шт.
№ 1.0975 (средние с выступом)	5 шт.
№ 1.0976 (средние)	10 шт.
кольцо **№ 1.099(5)**	1 шт.



№ 1.398 **Матрицы металлические секционные** 100 шт.:

№ 1.0971 (малые с выступом)	10 шт.
№ 1.0972 (малые)	20 шт.
№ 1.0973 (большие)	20 шт.
№ 1.0974 (большие с выступом)	10 шт.
№ 1.0975 (средние с выступом)	10 шт.
№ 1.0976 (средние)	30 шт.
кольцо **№ 1.099(5)**	1 шт.
кольцо Дельта **№ 1.299**	1 шт.

Щипцы для установки колец для фиксации матриц



№ 1.099-1 **Щипцы для установки пружинных держателей (колец)** 1 шт.

Ножки щипцов № 1.099-1






№ 1.099-2 **Щипцы для установки пружинных держателей (колец) с ограничителем** 1 шт.

Ножки щипцов № 1.099-2



Ограничитель позволяет использовать щипцы № 1.099-2 для установки фиксаторов кольцевых «Эластик» (стр. 21 Каталога)

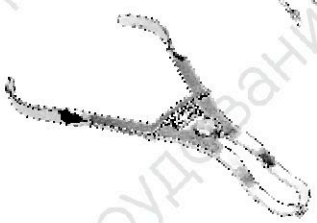

№ 1.099-3 **Щипцы установочные** 1 шт.

Ножки щипцов № 1.099-3



Матрицедержатели пружинные для секционных матриц



№ 1.009 **Матрицедержатель пружинный - фиксатор** 1 шт.

Установка с кольцом

1. После обработки полости зуба в межзубное пространство устанавливают матрицу (рекомендуется устанавливать широким основанием вниз) и клин.



2. Щипцами **№ 1.099-1** вне полости рта разжимают кольцо **№ 1.099,** избегая чрезмерного разведения ножек.



3. Накладывают кольцо на матрицу и проводят реставрацию зуба.



Фиксация кольцом на дистальной поверхности.



Варианты установки кольца №1.099

Вариант 1. Кольцо за клином (степень разрушения значительна)



Вариант 2. Кольцо перед клином (степень разрушения незначительна)



ВНИМАНИЕ!

При стерилизации:
- не используйте растворы с высокой концентрацией хлора и растворы, содержащие щавелевую кислоту;
- не оставляйте изделия в растворе более, чем на 3 часа.

Сила прижатия матрицы к стенкам зуба при установке фиксатором меньше, чем при использовании пары «щипцы-кольцо»



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицедержатели пружинные и кольца



№ 1.099* **Матрице-держатель пружинный - кольцо**
1 шт.

Ножки кольца № 1.099



Схема установки на зубе



Кольца фиксирующие выпускаются 3 типов:
№1.099(5) - кольцо стандартное (высота ножек 5 мм),
№1.099(4) - кольцо низкое (высота ножек 4 мм),
№1.099(6) - кольцо высокое (высота ножек 6 мм)

**При заказе указывайте необходимую высоту ножек. Если высота не указана, в заказе поставляются стандартные кольца №1.099(5).*



№ 1.399 **Матрицедержатели пружинные - кольцо**, 3 шт.:
№ 1.099(5) (стандартное) 1 шт.
№ 1.099(4) (низкое) 1 шт.
№ 1.099(6) (высокое) 1 шт.



№ 1.099А **Кольцо**
1 шт.

Петля в кольце № 1.099А обеспечивает сохранение упругих свойств кольца (сходимость ножек) при больших разведениях.



№ 1.099с **Кольцо**
1 шт.

Защитный элемент из силикона кольца № 1.099с исключает разлет частей кольца при его разрушении в случае чрезмерного разведения. Допускает автоклавирование.



№ 1.199 **Кольцо**
1 шт.

Ножки кольца №1.199



Схема установки на зубе



Кольца с плоскими ножками (плоские кольца) рекомендуются при значительных разрушениях в области контактного пункта



№ 1.299 **Кольцо «Дельта»**
1 шт.

Ножки кольца №1.299



Схема установки на зубе



Прорезь в ножках кольца Дельта для клина и насадки силиконовой № 1.861 или 1.866 (стр.22 Каталога)



НОВИНКА
№ 1.299с **Кольцо «Дельта»**
1 шт.

Выступы на кольце № 1.299с препятствуют попаданию языка в рабочую зону.



№ 1.167 **Кольцо «МД»**
1 шт.

Ножки кольца № 1.167



Схема установки на зубе



Ножки МД-кольца имеют прорезь для установки поверх клина и обеспечивают повышенную устойчивость кольца на зубе и эффективную фиксацию матрицы на дистальной и на медиальной поверхностях.



НОВИНКА
№ 1.167с **Кольцо «МД»**
1 шт.

Выступы на кольце № 1.167с препятствуют попаданию языка в рабочую зону.



№ 1.166 **Кольцо «Д»**
1 шт.

Ножки кольца № 1.166



Схема установки на зубе



Вогнутые внутрь ножки Д-кольца эффективны при восстановлении дефекта на дистальной поверхности




№ 1.177 **Кольцо «М»**
1 шт.

Ножки кольца № 1.177



Схема установки на зубе



Выгнутые наружу ножки М-кольца эффективны при восстановлении дефекта на медиальной поверхности

ВНИМАНИЕ!

При работе с кольцом необходимо:
1) Перед началом работы убедиться в отсутствии на поверхности кольца следов ржавчины и признаков нарушения целостности кольца;
2) Все манипуляции по разведению кольца проводить вне полости рта пациента;
3) избегать резкого разведения кольца;
4) не допускать разведения ножек кольца на расстояние свыше 10-12 мм.

Варианты одновременной установки колец с различной высотой ножек





Кольцо № 1.199



Кольцо № 1.299



Примеры установки колец «МД»







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы лепестковые

НОВИНКА

Выпускаются толщиной 35 и 50 мкм. При заказе в скобках после номера указывайте нужную толщину. Например, №1.351(35).




№ 1.351 **Матрицы малые с выступом**
4,5 мм, 12 шт.

№ 1.352 **Матрицы средние с выступом**
5,5 мм, 12 шт.

№ 1.353 **Матрицы большие с выступом**
6,5 мм, 12 шт.

№ 1.353L **Матрицы большие с выступом**
7,6 мм, 12 шт.



№ 2.351 **Матрицы малые**
4,0 мм, 12 шт.

№ 2.352 **Матрицы средние**
5,1 мм, 12 шт.



№ 2.353 **Матрицы большие**
6,0 мм, 12 шт.



№ 1.338 **Матрицы лепестковые**
матрицы 18 шт.:
№ 2.351 - 5 шт.,
№ 2.352 - 5 шт.,
№ 2.353 - 5 шт.,
№ 1.353L - 3 шт.,
МД кольцо № 1.167 - 1 шт.



№ 1.348 **Матрицы лепестковые**
матрицы 18 шт.:
№ 1.351 - 6 шт.,
№ 1.352 - 6 шт.,
№ 1.353 - 6 шт.,
МД кольцо № 1.167 - 1 шт.



№ 1.368 **Матрицы лепестковые**
матрицы 30 шт.:
№ 1.351 - 4 шт.,
№ 1.352 - 5 шт.,
№ 1.353 - 4 шт.,
№ 1.353L - 4 шт.,
№ 2.351 - 5 шт.,
№ 2.352 - 4 шт.,
№ 2.353 - 4 шт.,
МД кольцо № 1.167 - 1 шт.

Лепестковые матрицы предшествующих серий - №№ 1.351(1), 1.352(1), 1.353(1) и набор № 1.358 - могут поставляться по специальному заказу.


Матрицы лепестковые предназначены для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа.



Лепестковые матрицы обеспечивают более полный охват зуба по сравнению с секционными матрицами.

Все матрицы - объемные, вогнутые, сформованы из специальной коррозионно-стойкой стали.

Наличие лепестков позволяет притянуть матрицу к соседнему зубу в любом направлении.



Отверстия обеспечивают более надежный захват при установке и извлечении матрицы.

Держатели установочные

НОВИНКА




№ 1.154 **Держатель установочный продольный**
1 шт.




№ 1.164 **Держатель установочный поперечный**
1 шт.

Работа с держателями установочными



держатель продольный № 1.154



держатель поперечный № 1.164

Матрицы для передних зубов

Полоски контурные для передних зубов

Предназначены для восстановления проксимальных поверхностей передних зубов





№ 1.387А **Полоски контурные для передних зубов малые**, 12 шт.

№ 1.387 **Полоски контурные для передних зубов средние**, 12 шт.

№ 1.388 **Полоски контурные для передних зубов большие**, 12 шт.

Матрицы двойные для передних зубов

НОВИНКА





№ 1.523 **Матрицы двойные для передних зубов** 12 шт.

№ 1.533 **Матрицы двойные для передних зубов** 12 шт.



№ 1.888 **Матрицы для передних зубов** 30 шт.

№ 1.387А - 6 шт.
№ 1.387 - 6 шт.
№ 1.388 - 6 шт.
№ 1.523 - 6 шт.
№ 1.533 - 6 шт.

Полоски сепарационные





№ 1.382 **Полоски сепарационные** 100 шт., толщина 60 мкм, ширина 6 мм, длина 50 мм

№ 1.383 **Полоски сепарационные** 100 шт., толщина 90 мкм, ширина 6 мм, длина 50 мм

Матрицы кольцевые

Конструкция обеспечивает простоту регулировки длины петли матрицы.
Устанавливаются без матрицедержателя.
Могут использоваться для защиты соседнего зуба при препарировании.






№ 1.595 **Матрицы кольцевые** высота 5 мм, 6 шт.





№ 1.597 **Матрицы кольцевые** высота 7 мм, 6 шт.

Работа с полосками №№ 1.387А, 1.387, 1.388



При восстановлении фронтальных зубов рекомендуется ввести полоску в вертикальном положении и надавить на ручку как на рычаг, прижимая контурную рабочую часть к соседнему зубу


Примеры работы с полосками №№ 1.387А, 1.387, 1.388






Работа с матрицами двойными

матрицы № 1.523





матрицы № 1.533




Работа с матрицей кольцевой

Отрегулировать длину петли матрицы по размеру зуба





Установить матрицу на зуб, подтянуть конец матрицы до полного обжатия зуба и зафиксировать натяжение, отогнув конец матрицы



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы металлические плоские

Выпускаются толщиной 35 и 50 мкм. При заказе в скобках после номера указывайте толщину. Например, № 1.390(50).

Для премоляров (масштаб 1:2)




№ 1.0930 12 шт.

№ 1.0932 12 шт.

№ 1.0933 12 шт.

№ 1.0935 12 шт.

Для моляров (масштаб 1:2)



№ 1.0931 12 шт.

№ 1.1937 12 шт.

№ 1.1932 12 шт.

№ 1.1933 12 шт.

№ 1.1935 12 шт.



№ 1.380 **Матрицы**
12 шт. толщина 35 мкм
ширина 6 мм, длина 100 мм



№ 1.381 **Матрицы**
12 шт. толщина 35 мкм
ширина 7 мм, длина 100 мм



№ 1.390 **Матрицы в рулоне**
ширина 6 мм, длина 3 м
(круглая упаковка)

№ 1.391 **Матрицы в рулоне**
ширина 7 мм, длина 3 м
(круглая упаковка)



№ 1.392 **Матрицы в рулоне**
ширина 6 мм, длина 3 м
(квадратная упаковка)

№ 1.393 **Матрицы в рулоне**
ширина 7 мм, длина 3 м
(квадратная упаковка)

Матрицы комбинированные (металл / лавсан)

Наличие металлической части в комбинированных матрицах существенно облегчает процедуру введения матрицы в межзубное пространство: сначала вводят металлическую часть, затем протягивают к месту дефекта прозрачную половину матрицы.

Для премоляров (масштаб 1:2)



масштаб 1:2

№ 1.034 12 шт.

Для моляров (масштаб 1:2)



масштаб 1:2

№ 1.134 12 шт.

Матрицедержатели



№ 1.007 **Матрицедержатель**
типа Тоффльмайра
1 шт.



№ 1.008 **Матрицедержатель**
типа Тоффльмайра
Нустрем, универсальный
1 шт.

Плоские матрицы устанавливают также, как матрицы контурные (см. стр.8 Каталога)

Ширина рабочей части матриц

№ 1.0930 - 7 мм
№ 1.1937 - 6 мм
№ 1.0931 - 5 мм

Две прорези в верхней части квадратной упаковки №№ 1.392 и 1.393 позволяют легко регулировать длину ленты для использования



Работа с матрицедержателем



1. Вращением винта ***1*** освобождают щель ***3*** и вставляют матрицу в щели ***4*** и ***3***



или в щели ***5*** и ***3***.



2. Вращением винта ***1*** фиксируют матрицу в матрицедержателе.



3. Вращением винта ***2*** осуществляют фиксацию матрицы вокруг зуба.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Клинья фиксирующие деревянные



№ 1.181 **Клинья деревянные супертонкие, суперкороткие (оранжевые)**
100 шт.



№ 1.182 **Клинья деревянные тонкие, короткие (белые)**
100 шт.



№ 1.183 **Клинья деревянные тонкие, короткие (зеленые)**
100 шт.



№ 1.184 **Клинья деревянные тонкие, длинные (желтые)**
100 шт.



№ 1.185 **Клинья деревянные средние, короткие (синие)**
100 шт.



№ 1.186 **Клинья деревянные средние, длинные (розовые)**
100 шт.



№ 1.187 **Клинья деревянные толстые, длинные (фиолетовые)**
100 шт.



№ 1.080 **Клинья деревянные 2-х типов**
100 шт.
белые (тонкие, короткие) 50 шт.
синие (средние, короткие) 50 шт.



№ 1.083 **Клинья деревянные 4-х типов**
200 шт.
белые (тонкие, короткие) 50 шт.
желтые (тонкие, длинные) 50 шт.
синие (средние, длинные) 50 шт.
розовые (средние, длинные) 50 шт.



№ 1.085 **Клинья деревянные 6-ти типов**
400 шт.
оранжевые (супертонкие, суперкороткие) 100 шт.
белые (тонкие, короткие) 100 шт.
желтые (тонкие, длинные) 50 шт.
синие (средние, длинные) 50 шт.
розовые (средние, длинные) 50 шт.
фиолетовые (толстые, длинные) 50 шт.

Имеют анатомическую форму.



Изготавливаются из клена

По специальному заказу комплектуются и поставляются наборы из клиньев 2-х типов по 50 штук каждого типа, например, белые/желтые или белые/зеленые.

Примеры работы











https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Клинья фиксирующие деревянные, тригональные




№ 1.281 **Клинья деревянные тригональные**
100 шт.

Тригональные клинья



Изготавливаются из клена

Клинья фиксирующие пластиковые светопрозрачные

Допускают термообработку до 120°С



№ 1.811 **Клинья светопрозрачные тонкие**
40 шт.


№ 1.812 **Клинья светопрозрачные средние**
40 шт.



№ 1.810 **Клинья светопрозрачные 2-х типов**
40 шт.
тонкие 25 шт.
средние 15 шт.



№ 1.820 **Клинья светопрозрачные 2-х типов**
80 шт.
тонкие 50 шт.
средние 30 шт.



Клинья светопрозрачные изготавливаются из специального пластика. Характеризуются оптимальным сочетанием гибкости и жесткости.



Допускают многократное сгибание.



Клинья фиксирующие пластиковые несветопрозрачные

Допускают термообработку до 120°С




№ 1.841 **Клинья несветопрозрачные тонкие**
40 шт.

№ 1.842 **Клинья несветопрозрачные средние**
40 шт.



№ 1.840 **Клинья несветопрозрачные 2-х типов**
80 шт.
тонкие 50 шт.
средние 30 шт.



Клинья зеленые рекомендуются для работы с матрицами металлическими, когда для фиксации необходим изгиб клина.



Фиксаторы кольцевые «Эластик»

Допускают термообработку до 150°С.



№ 1.801 **Фиксаторы кольцевые «Эластик»**
толщина 2,5 мм
10 шт.



№ 1.802 **Фиксаторы кольцевые «Эластик»**
толщина 2,0 мм
10 шт.



№ 1.808 **Фиксаторы кольцевые «Эластик» 2-х типов**
40 шт.:
№ 1.801 20 шт.
№ 1.802 20 шт.

Фиксаторы кольцевые «Эластик» могут использоваться как клинья фиксирующие, а также в качестве корда при работе с системой Коффердам. Устанавливаются с помощью щипцов (с.15 Каталога).



Установка фиксатора «Эластик»

Вне полости рта вставляют в отверстия в клине ножки щипцов. Растягивают фиксатор, разводя ножки щипцов, и устанавливают в межзубный промежуток.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Насадки силиконовые

Насадки надеваются на ножки колец и обеспечивают прижатие матрицы на некотором расстоянии от контактного пункта.
Изготавливаются из силикона. Допускают термообработку до 150°С.



№ 1.861 **Насадки силиконовые** 40 шт.



№ 1.866 **Насадки силиконовые** (с укороченным носиком) 40 шт.

№ 1.862 **Насадки силиконовые** 40 шт.

насадка № 1.861





насадка № 1.866





Отверстия в насадках силиконовых предназначены для ножек кольца или фиксатора




№ 1.870 **Насадки силиконовые**
40 шт.
насадки № 1.861 20 шт.
насадки № 1.862 20 шт.
кольцо «Дельта» № 1.299 1 шт.

Контакт-формеры

НОВИНКА

Контакт-формеры изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали. Ручки выполнены из титанового сплава, что делает инструменты более легкими и удобными в работе



№ 1.1902 **Контакт-формер** 1 шт.



№ 1.1904 **Контакт-формер** 1 шт.

Рабочая часть А контакт-формера № 1.1902 предназначена для адаптации матрицы на дистальной поверхности, часть В используется при реставрации мезиальной поверхности.

резьбовое соединение для соединения с ручкой № 1.100 или стандартной ручкой для зеркала



кончик контакт-формера № 1.943 выполнен со специальным углублением



№ 1.943 **Контакт-формер** 1 шт.

Контакт-формер № 1.943 используется с ручкой № 1.100 или иной ручкой, обеспечивающей резьбовое соединение



№ 1.100 **Ручка-держатель** 1 шт.



№ 1.863 **Насадки силиконовые** 10 шт.



№ 1.867 **Насадки силиконовые** 10 шт.



№ 1.868 **Насадки силиконовые** 10 шт.



№ 1.965 **Контакт- и рельеф-формеры, набор:**
- контакт-формер № 1.943 - 1 шт.
- ручка-держатель № 1.100 - 1 шт.
- насадки № 1.863 - 10 шт.
- насадки № 1.867 - 10 шт.
- насадки № 1.868 - 10 шт.

Насадки **№1.861** и **№ 1.866** предназначены для прижатия матрицы по всей высоте зуба для более точного воссоздания формы зуба при реставрации (выступ насадки направлен к контактному пункту).



Если носик насадки **№ 1.861** вторгается в область контактного пункта и мешает прижатию матрицы к соседнему зубу, носик можно подрезать, либо использовать насадку **№ 1.866** с укороченным носиком.

Насадки **№1.862** обеспечивают фиксацию матрицы дальше от контактного пункта, что удобно при реставрации больших полостей.



Работа с контакт-формером № 1.943




1) После адгезивной обработки нанести на все стенки полости, кроме придесневой, текучий композит слоем 0,3-0,5 мм, провести его фотополимеризацию.
2) Вне полости рта подготовить «шарик» из универсального композита размером немного меньше, чем полость на контактной поверхности, провести его фотополимеризацию.
3) На придесневую стенку полости нанести тонкий слой текучего композита, а поверх него – универсальный композит. Фотополимеризацию не проводить!
4) Поместить «шарик» в полость и вдавить его контакт-формером, обеспечивая плотное прижатие матрицы к соседнему зубу в области контактного пункта. Не прекращая давления на «шарик», провести фотополимеризацию, затем убрать контакт-формер и повторить фотополимеризацию.
5) Провести реставрацию зуба.
6) Удалить фиксирующее кольцо, отогнуть матрицу от боковых скатов коронки, провести дополнительную фотополимеризацию композита в придесневой области, направляя световой поток со стороны вестибулярной и язычной поверхностей зуба.
7) Удалить фиксирующий клин и матрицу.
8) Провести финишную обработку реставрации.

Работа с контакт- и рельеф-формерами №1.965

Моделирование зубного бугорка жевательных зубов



Моделирование вестибулярной поверхности передних зубов



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы контурные лавсановые (секционные)





№ 1.922 **Матрицы секционные узкие**
30 шт.




№ 1.923 **Матрицы секционные широкие**
30 шт.


Матрицы контурные лавсановые с фиксирующим клеящим слоем

№ 1.490(1) **Матрицы для премоляров**
центральный выступ
12 шт.




№ 1.490(2) **Матрицы для премоляров**
билатеральные
12 шт.


№ 1.490(3/4) **Матрицы для премоляров**
2-х типов
12 шт.:
правый выступ 6 шт.
левый выступ 6 шт.




№ 1.491(1) **Матрицы для моляров**
центральный выступ
12 шт.




№ 1.491(2) **Матрицы для моляров**
билатеральные
12 шт.

№ 1.491(3/4) **Матрицы для моляров**
2-х типов
12 шт.:
правый выступ 6 шт.
левый выступ 6 шт.

Установка секционной матрицы с использованием светопрозрачных клиньев (стр.21 Каталога)



Возможна также установка с кольцом (стр.16 Каталога)

Пример работы с секционной матрицей



На края матрицы нанесен специальный клеевой слой, который позволяет фиксировать матрицу без использования матрицедержателя

Устанавливаются без матрицедержателя

Установка матрицы с фиксирующим клеящим слоем

Установить матрицу на зуб



Зондом удалить окрашенный защитный слой с краев матрицы



Соединить участки матрицы, покрытые клеевым слоем



Пример работы с самоклеящейся матрицей



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы контурные лавсановые



для премоляров

№ 1.090(1) **Матрицы для премоляров**
центральный выступ
30 шт.



№ 1.090(2) **Матрицы для премоляров**
билатеральные
30 шт.



№ 1.090(3) **Матрицы для премоляров**
правый выступ
30 шт.



№ 1.090(4) **Матрицы для премоляров**
левый выступ
30 шт.



№ 1.090(3/4) **Матрицы для премоляров 2-х типов**
30 шт.:
№ 1.090(3) 15 шт.
№ 1.090(4) 15 шт.





для моляров

№ 1.091(1) **Матрицы для моляров**
центральный выступ
30 шт.



№ 1.091(2) **Матрицы для моляров**
билатеральные
30 шт.



№ 1.091(3) **Матрицы для моляров**
правый выступ
30 шт.



№ 1.091(4) **Матрицы для моляров**
левый выступ
30 шт.



№ 1.091(3/4) **Матрицы для моляров 2-х типов**
30 шт.:
№ 1.091(3) 15 шт.
№ 1.091(4) 15 шт.






№ 1.190 **Матрицы для премоляров 4-х форм**
60 шт.:
№ 1.090(1) 15 шт.
№ 1.090(2) 15 шт.
№ 1.090(3) 15 шт.
№ 1.090(4) 15 шт.



№ 1.191 **Матрицы для моляров 4-х форм**
60 шт.:
№ 1.091(1) 15 шт.
№ 1.091(2) 15 шт.
№ 1.091(3) 15 шт.
№ 1.091(4) 15 шт.



№ 1.092 **Матрицы для моляров и премоляров**
120 шт.

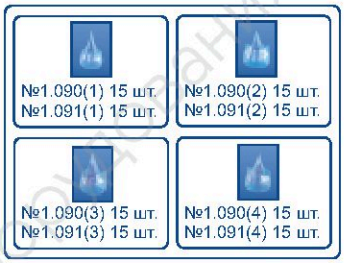


Матрицы контурные лавсановые обеспечивают оптимальное контурирование пломбы и сокращают объем шлифовальных операций после ее отверждения.


Матрицы выпускаются 4-х форм для моляров и 4-х форм для премоляров.

Способы установки матрицы

Матрицедержатель Тоффльмайра (или Нустрем)



Система Супермат



Кольцо «Слот»
(см. стр. 12 Каталога)



Фрагменты контурных лавсановых матриц могут также использоваться для восстановления контактных (аппроксимальных) поверхностей резцов и клыков.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы контурные лавсановые с фиксирующим устройством



для премоляров

№ 1.094(1) **Матрицы для премоляров** центральный выступ 10 шт.



№ 1.094(2) **Матрицы для премоляров** билатеральные 10 шт.



№ 1.094(3) **Матрицы для премоляров** правый выступ 10 шт.



№ 1.094(4) **Матрицы для премоляров** левый выступ 10 шт.



№ 1.094(3/4) **Матрицы для премоляров 2 типов** 10 шт.:
№ 1.094(3) 5 шт.
№ 1.094(4) 5 шт.





для моляров

№ 1.095(1) **Матрицы для моляров** центральный выступ 10 шт.



№ 1.095(2) **Матрицы для моляров** билатеральные 10 шт.



№ 1.095(2+) **Матрицы для больших моляров** билатеральные 10 шт.




№ 1.095(3) **Матрицы для моляров** правый выступ 10 шт.



№ 1.095(4) **Матрицы для моляров** левый выступ 10 шт.



№ 1.095(3/4) **Матрицы для моляров 2 типов** 10 шт.:
№ 1.095(3) 5 шт.
№ 1.095(4) 5 шт.





№ 1.194 **Матрицы для премоляров** 16 шт.:
№ 1.094(1) 3 шт.
№ 1.094(2) 3 шт.
№ 1.094(3) 5 шт.
№ 1.094(4) 5 шт.



№ 1.195 **Матрицы для моляров** 16 шт.:
№ 1.095(1) 3 шт.
№ 1.095(2) 3 шт.
№ 1.095(3) 5 шт.
№ 1.095(4) 5 шт.



№ 1.096 **Матрицы для моляров и премоляров** 32 шт.




Устанавливаются без матрицедержателя

Матрицы контурные лавсановые с фиксирующим устройством позволяют проводить реставрацию зубов без использования матрицедержателя.

Фиксирующее устройство представляет собой алюминиевое кольцо, сжатие которого в горизонтальной плоскости обеспечивает надежную фиксацию матрицы вокруг зуба.

Установка матриц с фиксирующим устройством


1. Устанавливают матрицу на зуб



2. Сдавливают алюминиевое кольцо и фиксируют матрицу



3. Матрица в рабочем состоянии



Примеры работы с матрицами с фиксирующим устройством





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы контурные лавсановые закрытые «колпачки»


Матрицы контурные лавсановые (матрицы-«колпачки») предназначены для лечения кариеса и проведения эстетической реставрации некрасивых или изменивших цвет зубов (в основном - передних), а также для восстановления врожденных дефектов и дефектов, возникших в результате травм.

Идеальное восстановление естественного зубного ряда обеспечивают анатомичность форм и вариации размеров, тонкие интерпроксимальные стенки колпачков, жесткость материала.

Колпачки удобны в работе - легко снимаются, обеспечивают плотный контакт и гладкую поверхность реставрации, идеальны для работы с химическими и светоотверждаемыми материалами.

Матрицы-«колпачки» для взрослых зубов выпускаются 14 анатомических форм для резцов и клыков и 14 анатомических форм для премоляров и моляров.



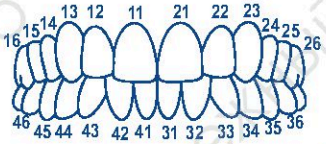



11/21 S 4 шт.	11/21 M 4 шт.	11/21 L 4 шт.	12/22 S 4 шт.	12/22 M 4 шт.	12/22 L 4 шт.	13/23 S 4 шт.	
32/42 M 4 шт.						32/42 L 4 шт.	
13/23 M 4 шт.	13/23 L 4 шт.	31/41 32/42 S 4 шт.	31/41 M 4 шт.	31/41 L 4 шт.	33/43 S 4 шт.	33/43 M 4 шт.	

№ 1.910 **Матрицы «колпачки» для фронтальных зубов,** 64 шт.

** S - малые, M - средние, L - большие*




14/24 S 4 шт.	14/24 M 4 шт.	16/26 S 4 шт.	16/26 M 4 шт.	17/27 S 4 шт.	17/27 M 4 шт.	34/44 S 4 шт.	
15/25 S 4 шт.						15/25 M 4 шт.	
34/44 M 4 шт.	35/45 S 4 шт.	35/45 M 4 шт.	36/46 S 4 шт.	36/46 M 4 шт.	37/47 S 4 шт.	37/47 M 4 шт.	

№ 1.911 **Матрицы «колпачки» для моляров и премоляров,** 64 шт.

** S - малые, M - средние, L - большие*

Матрицы-«колпачки» для детских зубов выпускаются 8 анатомических форм для резцов и клыков и 8 анатомических форм для премоляров и моляров.







51/61 M 4 шт.	51/61 L 4 шт.	52/62 S 4 шт.	52/62 M 4 шт.	52/62 L 4 шт.	53/63 S 4 шт.	53/63 M 4 шт.	
51/61 S 4 шт.						54/64 S 4 шт.	
75/85 S 4 шт.	75/85 M 4 шт.	74/84 S 4 шт.	74/84 M 4 шт.	55/65 S 4 шт.	55/65 M 4 шт.	54/64 M 4 шт.	

№ 1.912 **Матрицы «колпачки» для детских зубов,** 64 шт.

** S - малые, M - средние, L - большие*

Матрицы-«колпачки» конические выпускаются 8 форм для всех групп зубов.






№ 1.915 **Матрицы «колпачки» конические,** 64 шт. (8 типов по 8 шт.)

Восстановление полной формы зуба



Реставрация угловых и краевых частей коронки зуба

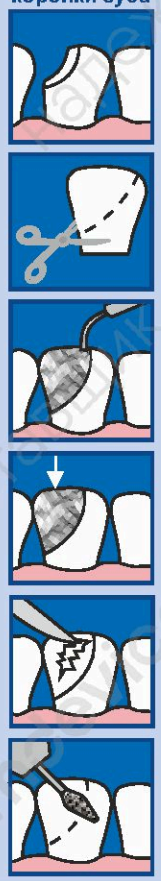

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Матрицы «колпачки» для фронтальных зубов. 10 шт.



Форма зуба	11/21	12/22	13/23	31/41, 32/42	31/41	32/42	33/43
Номер для заказа*	1.9(11|21)S 1.9(11|21)M 1.9(11|21)L	1.9(12|22)S 1.9(12|22)M 1.9(12|22)L	1.9(13|23)S 1.9(13|23)M 1.9(13|23)L	1.9(312|412)S	1.9(31|41)M 1.9(31|41)L	1.9(32|42)M 1.9(32|42)L	1.9(33|43)S 1.9(33|43)M

** S - малые, M - средние, L - большие*

Матрицы «колпачки» для зубов жевательной группы. 10 шт.



Форма зуба	14/24	15/25	16/26	17/27	34/44	35/45	36/46	37/47
Номер для заказа*	1.9(14|24)S 1.9(14|24)M	1.9(15|25)S 1.9(15|25)M	1.9(16|26)S 1.9(16|26)M	1.9(17|27)S 1.9(17|27)M	1.9(34|44)S 1.9(34|44)M	1.9(35|45)S 1.9(35|45)M	1.9(36|46)S 1.9(36|46)M	1.9(37|47)S 1.9(37|47)M

** S - малые, M - средние, L - большие*

Матрицы «колпачки» для детских зубов. 10 шт.



Форма зуба	51/61	52/62	53/63	54/64	55/65	74/84	75/85
Номер для заказа*	1.9(51|61)S 1.9(51|61)M 1.9(51|61)L	1.9(52|62)S 1.9(52|62)M 1.9(52|62)L	1.9(53|63)S 1.9(53|63)M	1.9(54|64)S 1.9(54|64)M	1.9(55|65)S 1.9(55|65)M	1.9(74|84)S 1.9(74|84)M	1.9(75|85)S 1.9(75|85)M

** S - малые, M - средние, L - большие*

Матрицы контурные лавсановые закрытые «колпачки» на пластинах



№ 1.901 **Матрицы «колпачки» для коронковой части резцов**
12 шт.



№ 1.903 **Матрицы «колпачки» для фронтальной поверхности**
16 шт.



№ 1.905 **Матрицы «колпачки» для аппроксимальной поверхности резцов и клыков (малого и среднего размера)**
17 шт.



№ 1.907 **Матрицы «колпачки» для аппроксимальной поверхности резцов и клыков (среднего и большого размера)**
18 шт.



№ 1.908 **Матрицы «колпачки» для моляров и премоляров**
12 шт.



№ 1.909 **Матрицы «колпачки» для коронковой части резцов** (2 шт.), **клыков** (6 шт.) **и премоляров** (4 шт.)
12 шт.

Работа с закрытыми матрицами «колпачками»

Проколоть колпачок зондом



Наполнить колпачок пломбировочным материалом



Поместить колпачок на поврежденный зуб



Удалить излишки пломбировочного материала и провести светоотверждение



Клинический случай



Матрицы лавсановые сепарационные

Выпускаются толщиной 50 мкм.



№ 1.040 **Матрицы сепарационные**
(ширина 8 мм), 100 шт.



№ 1.041 **Матрицы сепарационные**
(ширина 10 мм), 100 шт.



№ 1.240 **Матрицы в рулоне**
ширина 8 мм, длина 10 м



№ 1.241 **Матрицы в рулоне**
ширина 10 мм, длина 10 м



№ 1.242 **Матрицы в рулоне**
ширина 8 мм, длина 10 м



№ 1.243 **Матрицы в рулоне**
ширина 10 мм, длина 10 м




№ 1.244 **Матрицы в рулоне,**
упаковка с режущей пластиной
ширина 8 мм, длина 10 м



№ 1.245 **Матрицы в рулоне,**
упаковка с режущей пластиной
ширина 10 мм, длина 10 м



№ 1.440 **Матрицы сепарационные**
с ограничителем
(ширина 8 мм), 12 шт.



№ 1.441 **Матрицы сепарационные**
с ограничителем
(ширина 10 мм), 12 шт.



№ 1.141 **Матрицы лавсановые**
сепарационные для
формирования
пришеечных пломб
(матрицы лавсановые
прямоугольные 10х37мм 100 шт.
матрицедержатель 1 шт.
фиксатор 1 шт.)



Примеры работы с матрицами сепарационными






Две прорези в верхней части новой квадратной упаковки **№№ 1.242-1.245** обеспечивают легкую регулировку длины ленты, необходимой для работы, а режущая пластина в прорези упаковок **№№ 1.244, 1.245** позволяет отрезать ленту нужного размера без использования ножниц.




Наличие ограничителя на сепарационных матрицах **№№ 1.440** и **1.441** позволяет надежно фиксировать матрицу одной рукой.



Работа с матричной системой для формирования пришеечных пломб

1. Матрицу осторожно (не перегибая) сворачивают и вставляют в матрицедержатель, представляющий собой металлическую трубку (рис. *1*).
2. Регулируют длину выступающей части матрицы таким образом, чтобы кривизна матрицы примерно соответствовала кривизне реставрируемой части зуба, и обрезают углы матрицы для полного соответствия форме зуба (рис. *2*).
3. Фиксируют матрицу в матрицедержателе с помощью фиксатора (рис. *3*).
4. Проводят реставрацию зуба, удерживая одной рукой матрицедержатель с матрицей (рис. *4-6*).

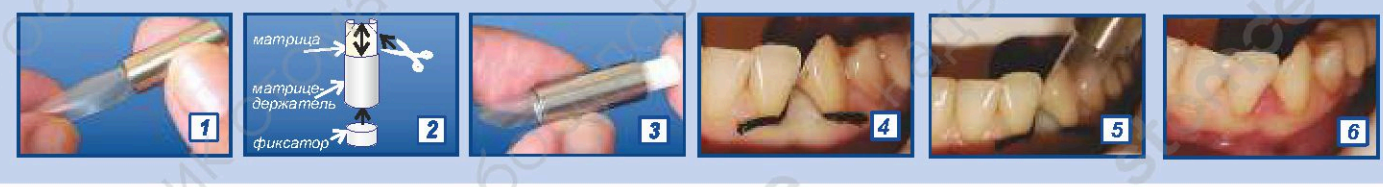

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Полоски шлифовальные



№ 1.050 **Полоски для снятия излишков материала** ширина 4 мм, 25 шт.

№ 1.051 **Полоски для предварительного шлифования** ширина 4 мм, 25 шт.

№ 1.052 **Полоски для полирования** ширина 4 мм, 25 шт.

№ 1.053 **Полоски для снятия излишков материала, для предварительного шлифования** ширина 4 мм, 50 шт.: **№ 1.050** - 25 шт., **№ 1.051** - 25 шт.

№ 1.054 **Полоски для предварительного шлифования, для полирования** ширина 4 мм, 50 шт.: **№ 1.051** - 25 шт., **№ 1.052** - 25 шт.

№ 1.055 **Полоски для снятия излишков материала, для предварительного шлифования, для полирования** ширина 4 мм, 75 шт.: **№1.050** -25шт., **№1.051** -25шт., **№1.052** -25шт.

По специальному заказу изготавливаются полоски шлифовальные шириной 3 мм

Полоски шлифовальные удобны для полирования интерпроксимальных и придесневых поверхностей реставрации.

Выпускаются на лавсановой основе.

Каждая полоска содержит два участка с различной абразивностью:

тип 1 - для снятия излишков материала / для предварительного шлифования (синий / зеленый)

тип 2 - для предварительного шлифования / для окончательного шлифования (зеленый / желтый)

тип 3 - для окончательного шлифования / для полирования (желтый / белый)

В средней части полоски абразив отсутствует.

Аппроксимальные поверхности рекомендуется полировать сразу после удаления матричной системы и клина, пока между зубами сохраняется небольшое расстояние.

Полоски алмазные *НОВИНКА*



№ 1.150 **Полоски алмазные крупнозернистые** 5 шт.

№ 1.151 **Полоски алмазные среднезернистые** 5 шт.

№ 1.152 **Полоски алмазные мелкозернистые** 5 шт.

№ 2.150 **Полоски алмазные перфорированные крупнозернистые** 5 шт.

№ 2.151 **Полоски алмазные перфорированные среднезернистые** 5 шт.

№ 2.152 **Полоски алмазные перфорированные мелкозернистые** 5 шт.

Полоски алмазные выпускаются 3-х типов:
- крупнозернистые,
- среднезернистые,
- мелкозернистые.

Одна сторона средней части алмазных полосок может выполняться в виде пилки



Схема фиксации полосок в ножках держателей




Держатели полосок



Система двух щелей позволяет надежно фиксировать как гладкие металлические и пластиковые полоски, так и полоски с абразивным покрытием



№ 1.105 **Держатель полосок продольный,** 1 шт.




№ 1.106 **Держатель полосок поперечный,** 1 шт.




№ 1.106В **Держатель полосок поперечный,** 1 шт.
Модель с винтом для регулировки натяжения

Держатели серии №1.106 могут использоваться для фиксации любой полоски шириной 2.9 мм - 4.1 мм. Наиболее эффективны для фиксации
- полосок металлических шириной 0.035 - 0.150 мм с или без абразивного покрытия,
- полосок лавсановых толщиной 0,100 - 0,150 мм с абразивным покрытием.

Фиксация полоски металлической в держателе № 1.105



Фиксация полоски лавсановой в держателе № 1.106



Диски шлифовальные с металлической втулкой

Номер для заказа и количество дисков в упаковке - в таблице: № 2.731(9,5)BR ← номер для заказа; 50 шт. ← количество в упаковке






Диски для снятия излишков материала

диаметр, мм	9,5	10	12	12,7	14	16
	№ 2.731(9,5)BR 50 шт.			№ 2.731(12,7)BR 50 шт.		
	№ 2.731(9,5) 40 шт.	№ 2.731(10) 40 шт.	№ 2.731(12) 40 шт.	№ 2.731(12,7) 40 шт.	№ 2.731(14) 40 шт.	№ 2.731(16) 40 шт.
	№ 1.731(9,5) 40 шт.	№ 1.731(10) 40 шт.	№ 1.731(12) 40 шт.	№ 1.731(12,7) 40 шт.	№ 1.731(14) 40 шт.	№ 1.731(16) 40 шт.
	№ 1.731(A) 50 шт.			№ 1.731(B) 50 шт.		

Диски для предварительного шлифования

диаметр, мм	9,5	10	12	12,7	14	16
	№ 1.732(9,5) 40 шт.	№ 1.732(10) 40 шт.	№ 1.732(12) 40 шт.	№ 1.732(12,7) 40 шт.	№ 1.732(14) 40 шт.	№ 1.732(16) 40 шт.
	№ 1.732(A) 50 шт.			№ 1.732(B) 50 шт.		

Диски для окончательного шлифования

диаметр, мм	9,5	10	12	12,7	14	16
	№ 1.733(9,5) 40 шт.	№ 1.733(10) 40 шт.	№ 1.733(12) 40 шт.	№ 1.733(12,7) 40 шт.	№ 1.733(14) 40 шт.	№ 1.733(16) 40 шт.
	№ 1.733(A) 50 шт.			№ 1.733(B) 50 шт.		


Диски для полирования

диаметр, мм	9,5	10	12	12,7	14	16
	№ 1.734(9,5) 40 шт.	№ 1.734(10) 40 шт.	№ 1.734(12) 40 шт.	№ 1.734(12,7) 40 шт.	№ 1.734(14) 40 шт.	№ 1.734(16) 40 шт.
	№ 1.734(A) 50 шт.			№ 1.734(B) 50 шт.		



Диски шлифовальные выпускаются на лавсановой основе.

Диски для снятия излишков материала

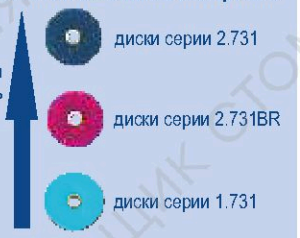

Диски серии 2.731 характеризуются большей шлифующей способностью и износостойкостью по сравнению с другими дисками производства TOP BM.

Диски серии 2.731BR более тонкие и гибкие по сравнению с дисками серии 2.731.

Диски для предварительного шлифования


диски серии 1.732

Диски для окончательного шлифования


диски серии 1.733

Диски для полирования


диски серии 1.734

Дискодержатели



№ 1.120 **Дискодержатель прямой,** 1 шт.

№ 1.121 **Дискодержатель угловой,** 1 шт.

Диски шлифовальные с металлической втулкой в наборах



№ 1.069 **Диски шлифовальные** (диаметр 10 мм) 40 шт.:
№ 1.731(10) - 10 шт., **№ 1.732(10)** - 10 шт.,
№ 1.733(10) - 10 шт., **№ 1.734(10)** - 10 шт.,
дискодержатель **№ 1.121** 1 шт.




№ 1.070 **Диски шлифовальные** (диаметр 12 мм) 40 шт.:
№ 1.731(12) - 10 шт., **№ 1.732(12)** - 10 шт.,
№ 1.733(12) - 10 шт., **№ 1.734(12)** - 10 шт.,
дискодержатель **№ 1.121** 1 шт.



№ 1.071 **Диски шлифовальные** (диаметр 14 мм) 40 шт.:
№ 1.731(14) - 10 шт., **№ 1.732(14)** - 10 шт.,
№ 1.733(14) - 10 шт., **№ 1.734(14)** - 10 шт.,
дискодержатель **№ 1.121** 1 шт.



№ 1.072 **Диски шлифовальные** (диаметр 16 мм) 40 шт.:
№ 1.731(16) - 10 шт., **№ 1.732(16)** - 10 шт.,
№ 1.733(16) - 10 шт., **№ 1.734(16)** - 10 шт.,
дискодержатель **№ 1.121** 1 шт.



№ 1.075 **Диски шлифовальные** (диаметры 12 и 14 мм) 80 шт.:
№ 1.731(12) - 10 шт., **№ 1.732(12)** - 10 шт.,
№ 1.733(12) - 10 шт., **№ 1.734(12)** - 10 шт.,
№ 1.731(14) - 10 шт., **№ 1.732(14)** - 10 шт.,
№ 1.733(14) - 10 шт., **№ 1.734(14)** - 10 шт.,
дискодержатель **№ 1.121** 1 шт.

Диски применяются на скорости не более 30000 об/мин. Диски с большей абразивностью (синие) используются на скорости 10000 об/мин, менее абразивные - на больших скоростях.

Диски шлифовальные с металлической втулкой выпускаются следующих диаметров:



По специальному заказу изготавливаются наборы:


№ 1.076 в составе:
диски шлифовальные 240 шт.:
№ 1.731(12) - 30шт., **№ 1.731(14)** - 30шт.,
№ 1.732(12) - 30шт., **№ 1.732(14)** - 30шт.,
№ 1.733(12) - 30шт., **№ 1.733(14)** - 30шт.,
№ 1.734(12) - 30шт., **№ 1.734(14)** - 30шт.
дискодержатель **№ 1.121** - 1 шт.

№ 1.077 в составе:
диски шлифовальные 240 шт.:
№ 1.731(A) - 30шт., **№ 1.731(B)** - 30шт.,
№ 1.732(A) - 30шт., **№ 1.732(B)** - 30шт.,
№ 1.733(A) - 30шт., **№ 1.733(B)** - 30шт.,
№ 1.734(A) - 30шт., **№ 1.734(B)** - 30шт.
дискодержатель **№ 1.121** - 1 шт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Диски шлифовальные с пластиковой втулкой





Диски для снятия излишков материала

диаметр, мм	8	12	14
№ по каталогу, количество	№ 1.611 40 шт.	№ 1.621 40 шт.	№ 1.631 40 шт.





Диски для предварительного шлифования

диаметр, мм	8	12	14
№ по каталогу, количество	№ 1.612 40 шт.	№ 1.622 40 шт.	№ 1.632 40 шт.





Диски для окончательного шлифования

диаметр, мм	8	12	14
№ по каталогу, количество	№ 1.613 40 шт.	№ 1.623 40 шт.	№ 1.633 40 шт.





Диски для полирования

диаметр, мм	8	12	14
№ по каталогу, количество	№ 1.614 40 шт.	№ 1.624 40 шт.	№ 1.634 40 шт.

Дискодержатели



№ 1.110 **Дискодержатель прямой** 1 шт.

№ 1.111 **Дискодержатель угловой** 1 шт.

Диски шлифовальные с пластиковой втулкой в наборах



№ 1.610 **Диски шлифовальные**
диаметр 8 мм, 40 шт.
(№№1.611-1.614 - по 10 шт.)
дискодержатель № 1.111 - 1 шт.



№ 1.620 **Диски шлифовальные**
диаметр 12 мм, 40 шт.
(№№1.621-1.624 - по 10 шт.)
дискодержатель № 1.111 - 1 шт.

№ 1.630 **Диски шлифовальные**
диаметр 14 мм, 40 шт.
(№№1.631-1.634 - по 10 шт.)
дискодержатель № 1.111 - 1 шт.



№ 1.600 **Диски шлифовальные**
диски диаметром 8, 12 и 14 мм - 80 шт.:
№№ 1.611 - 1.614 - по 5 шт.
№№ 1.621 - 1.624 - по 5 шт.
№№ 1.631 - 1.634 - по 5 шт.
обратное расположение абразива
№№ 1.631 - 1.634 - по 5 шт.
дискодержатель № 1.111 - 1 шт.

Шлифовальные наборы



№ 1.020 **Шлифовальный набор**
диски с пластиковой втулкой 48 шт.
(**№№ 1.631-1.634** - по 12 шт.)
полоски шлифовальные 75 шт.:
№ 1.050 25 шт.
№ 1.051 25 шт.
№ 1.052 25 шт.
дискодержатель № 1.111 1 шт.



№ 1.021 **Шлифовальный набор**
диски с металлической втулкой 48 шт.
(**№№ 1.731(14)-1.734(14)** - по 12 шт.)
полоски шлифовальные 75 шт.:
№ 1.050 25 шт.
№ 1.051 25 шт.
№ 1.052 25 шт.
дискодержатель № 1.121 1 шт.



Диски с пластиковой втулкой выпускаются с абразивным слоем на сплошной рабочей поверхности.



Диски с пластиковой втулкой выпускаются 3-х диаметров:



Выпускаются также диски с обратным расположением абразивного слоя.



Диски с обратным расположением абразива представлены в наборе **№ 1.600**.

Диски с обратным расположением абразива могут поставляться отдельно по специальному заказу.

Использованы материалы изданий:

А.В.Салова «Восстановление контактных областей зубов с помощью матричных систем», М.:МедПресс-информ, 2011.

«Практическая терапевтическая стоматология», Под ред. А.И.Николаева и Л.М. Цепова, М.:МедПресс-информ, 2018.

«Методы изоляции рабочего поля в стоматологии», Под ред. И.М. Макеевой, М.: МедПресс-информ, 2007.

Обложки этих изданий приведены на обложке каталога. Остальные изображения не являются изображениями обложек реальных изданий, а служат для информирования о деятельности фирмы «ТОР ВМ», о ее продукции и партнерах.

ООО «ТОР ВМ» выражает глубокую благодарность

К. Алейникову (г.Москва),
К. Асимакополусу (г Афины),
В. Безручко (г.Дмитров),
А. Волому (г.Будапешт),
В. Дурову (г.Тверь),
К. О'Коннору (Ньюкасл-апон-Тайп, Великобритания)
Д. Левченко (г.Воронеж),
Ю. Некипелову (г.Вологда),
А. Николаеву (г.Смоленск),
Д. Николаеву (г.Брянск),
А. Саловой (г.Санкт-Петербург),
А. Сидорову (г.Москва),
В. Тищенко (г.Краснодар),
К. Шенджену (г.Краснодар)
за постоянные советы и консультации, идеи новых изделий и предоставленные фотоматериалы

Каталог подготовлен в марте 2021 г.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ООО «ТОР ВМ»
ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Головной офис:

119421, Москва, ул.Новаторов, 7А
тел.: +7(495) 225 54 17, e-mail: torvm77@gmail.com
www.torvm.ru

Интернет-магазин: www.mikond.top

ВКонтакте

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ