
stomdevice

МИКРОМОТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗУБР-МП ("ZUBR -MP") по ТУ 9452-042-54814727-2014



ISO 13485

LL-C (Certification)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ВНИМАНИЕ:

Для получения полной информации об эффективной работе приобретенного Вами изделия внимательно изучите настоящую инструкцию по применению. Настоятельно рекомендуем обратить особое внимание на «Правила техники безопасности».

При обнаружении неполадок в работе микромотора обращаться к Вашим дистрибьюторам или в службу сервисного обслуживания.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение микромотора..... 5
2. Технические характеристики.....6
3. Комплектность.....7
4. Правила техники безопасности.....8
5. Подготовка микромотора к работе и порядок работы.....9
6. Стерилизация.....11
7. Правила хранения и эксплуатации.....12
8. Гарантии изготовителя.....15
9. Свидетельство о приемке.....19
Гарантийный талон..... 21

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1. НАЗНАЧЕНИЕ МИКРОМОТОРА

1.1 Микромотор пневматический ЗУБР–МП (в дальнейшем микромотор), изготовленный по ТУ 9452-042-54814727-2014, регистрационный номер: РЗН 2015/2396 от 05.02.15, предназначен для использования в бормашинах и стоматологических установках в качестве привода микромоторных стоматологических наконечников.

Область применения - терапевтическая и ортопедическая стоматология.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная частота вращения, $с^{-1}$ (об/мин), не менее..... 333 (20000)
- Рабочее давление воздуха, подаваемое на вход, МПа..... 0,2 – 0,35
- Корректированный уровень звуковой мощности, дБ·А, не более.....75
- Расход воздуха, л/мин, не более.....50
- Габариты, мм:
  длина.....108,5±0,5
  диаметр.....21,5 ±0,5
- Масса, кг, не более..... 0,1
- Стерилизация в паровом автоклаве при температуре (134±1)°С и давлении (0,21±0,01)МПа в течение 5 минут

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- микромотор..... 1 шт.
- инструкция по применению.....1 шт.
- коробка укладочная..... 1 шт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Снятие и установку микромоторного наконечника производить только после полной остановки микромотора.
4.2 При установке необходимо убедиться в надежности соединения.
4.3 В случае подтекания воды необходимо заменить резиновые герметизирующие кольца на держателе микромотора.
4.4 Чтобы свести к минимуму опасность травмирования и заражения, необходимо использовать в работе защитные перчатки.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

5. ПОДГОТОВКА МИКРОМОТОРА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Перед пробным пуском необходимо установить рабочее давление на входе в микромотор в пределах 0.2 - 0,35 МПа.

5.2 Смазать микромотор сервисным маслом. Смазку производить в отверстие для подвода воздуха как указано на рис. 1 и рис. 2.

5.3 Подсоединить микромотор к шлангу бормашины. Включить подачу воздуха и кольцом регулятора скорости вращения включить микромотор. Поворот кольца по часовой стрелке до крайнего правого положения соответствует правому вращению, поворот против часовой стрелки – левому вращению. Дать поработать микромотору на холостом ходу в течение 15 - 20 с в каждую сторону, после чего выключить подачу воздуха и вытереть излишки смазки чистой сухой салфеткой.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

5.4 Присоединить микромоторный наконечник.

ВНИМАНИЕ! Не подсоединять наконечники к микромотору до полной его остановки!

5.5 Техническое обслуживание:

5.5.1 Для предупреждения преждевременного выхода из строя микромотор необходимо регулярно (2 – 3 раза в смену) смазывать его по п. 5.2 и дать поработать на холостом ходу по п.5.3 .

5.5.2 После каждого приема пациента необходимо провести стерилизацию микромотора.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

6.СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Перед стерилизацией микромотор должен быть смазан по п. 5.2 и уложен в стерилизационный пакет.

Методы стерилизации:

Стерилизация в паровом автоклаве при температуре (134±1)°С и давлении (0,21±0,01)МПа в течение 5 минут.

⚠ **Стерилизацию необходимо проводить после каждого приема пациента.**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Микромотор предназначен для эксплуатации при температуре от плюс 10 до плюс 35°С и относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С.

7.2 Микромотор должен храниться в укладочной коробке, входящей в его комплект, в закрытых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при плюс 15°С.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

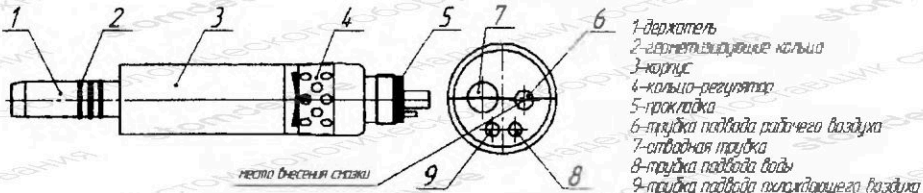


Рисунок 1

Микромотор пневматический ЭУБР-МП-МК

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

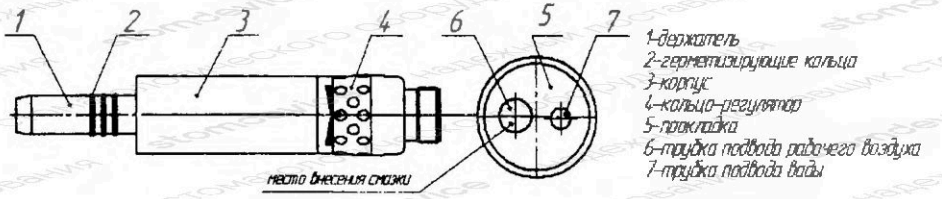


Рисунок 2

Микромотор пневматический ЗУБР-МП-В2

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу микромотора в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

8.2 Общий гарантийный срок эксплуатации микромотора 12 месяцев с даты продажи, заверенной печатью торгующей организации и подписью продавца. В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи, заверенной печатью торгующей организации и подписью продавца, гарантийный срок исчисляется с даты приемки микромотора ОТК предприятия-изготовителя.

8.3 Гарантийные обязательства аннулируются, и гарантийный ремонт не производится, если во время гарантийного срока:

- произошло механическое повреждение наружных поверхностей микромотора;

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

- производилась разборка микромотора;
- микромотор подвергался негарантийному ремонту;
- не соблюдались правила его эксплуатации или хранения;
- не соблюдался режим смазки;
- замена инструмента производилась во время неполной остановки микромотора;
- не заполнен или неправильно заполнен гарантийный талон.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

В случае отказа или неисправности микромотора в период действия гарантийных обязательств, владелец микромотора должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание:

- стерилизованный микромотор в полной комплектации с инструкцией по применению и гарантийным талоном;
- заявку на ремонт (замену) с указанием адреса и телефона владельца.

В случае невозможности устранения неисправностей силами гарантийных мастерских ремонт производит предприятие-изготовитель.

Работы по ремонту и сервисному обслуживанию микромоторов должны проводиться только сервисными службами или специально обученными лицами.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



При обнаружении неполадок следует незамедлительно обращаться к Вашим дистрибьюторам или в службу сервисного обслуживания и продаж.

По вопросам отказа изделий в период гарантийного срока обращаться в службу сервисного обслуживания ООО «ВХ-Тайфун» по телефону:
Тел./факс (4967)35-10-17, +7(915)4595434
Электронная почта: wh-tayfun@mail.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микромотор ЗУБР-МП заводской номер 00156 соответствует техническим условиям ТУ 9452 – 042 – 54814727 – 2014 и признан годным к эксплуатации.

М.П. ОТК 1

Дата приёмки 16 МАР 2023

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц, ответственных за приемку)

Адрес предприятия-производителя:

ООО «ВХ-Тайфун», 142200, Московская область, г. Серпухов. а/я 1046
Тел./факс (4967)35-10-17, +7(915)4595434, электронная почта: wh-tayfun@mail.ru.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Корешок талона №____
На гарантийный ремонт
(техническое обслуживание)
микромотора
ЗУБР-МП

Изъят «__» _____ 20__ г.
Гл. механик цеха _____ (подпись)
м. п.

Линия отреза

ТАЛОН №_____
на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)
микромотора ЗУБР-МП.

изготовленного 16 МАР 2023 Заводской № 00156
(дата изготовления)

Продан магазином №_____
(наименование торгующей организации)

«_____» _____ 20__ г.

Штамп магазина_____
(личная подпись)

Владелец и его адрес _____

21

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



ООО «ВХ-Тайфун»
+7 (915) 459-54-34
+7 (4967) 35-10-17
https://stomdevice.ru

Https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ