Безмасляный компрессор
OIL LESS 24 (W-601)



Инструкция по применению и паспорт

Перед использованием прибора внимательно изучите инструкцию

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и форму, комплектацию, отклонения в оттенках цветов — без предварительного предупреждения.

2017


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Производитель:
Guangzhou WuerWei Machine Co., Ltd., F7No. 78 Ershe Industrial Zone Hebian Village, Jiahe 510440, Китай


1. Технические характеристики

Напряжение электросети	AC 220±10% В 50±1 Гц
Потребляемая мощность	550 Вт
Объём выпускаемого воздуха	60 л/0,4 МПА
Максимальное давление	0,8 МПа
Давление при вкл./откл. прибора	0,5/0,8 МПа
Шумность	60 дБ
Допустимая температура в помещении	5~40°C
Объём ресивера	24 л
Габариты	41x41x63 см

2. Комплект поставки:

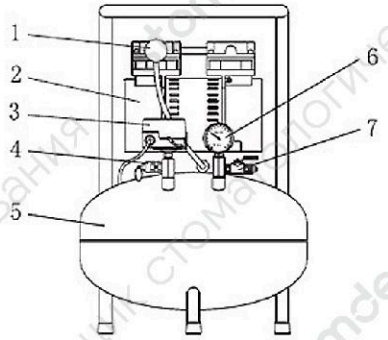

1. Фильтр глушителя
2. Крышка компрессора
3. Переключатель давления
4. Предохранительный клапан
5. Воздушный ресивер
6. Измеритель давления
7. Воздушный кран

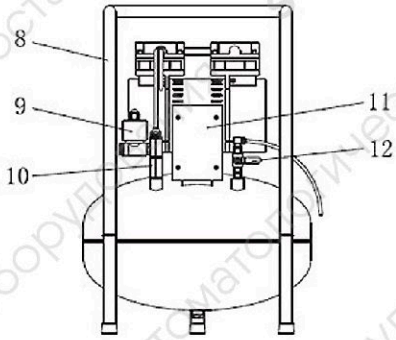

8. Ручка
9. Электромагнитный клапан
10. Обратный клапан
11. Блок управления
12. Кран сброса конденсата

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3. Применение:

Компрессоры этого типа отличаются высокой производительностью, низким уровнем шума, функцией автоматического отключения мотора-нагнетателя после того как закачанный в ресивер воздух достигнет рабочего давления. По мере падения давления мотор также автоматически включится. Данные компрессоры будут идеальны для стоматологических клиник различного размера, зуботехнических лабораторий и ювелирных мастерских.
Для применения высоквалифицированными специалистами, ознакомленными с инструкцией по эксплуатации.

3.1. После вскрытия упаковки проверьте детали на наличие повреждений.
3.2. Установите компрессор в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении.
3.3. Источник электропитания должен быть заземлен.
3.4. Включите питание, компрессор начнет работу; закройте выпускной кран и кран сброса конденсата, проверьте герметичность системы.

ВНИМАНИЕ:
После запуска компрессора, электромагнитный клапан начинает выпускать воздух — это является отличительной чертой данного компрессора; при нормальной работе мотора, клапан закрывается автоматически.

3.5. Давление внутри компрессора поднимется до 0,8 мПа, система автоматически выключится, если давление в системе понизится до 0,5 мПа, она автоматически включится.
3.6. Значения уровня давления в системе и на предохранительный клапан устанавливаются изначально на заводе производителе. Не пытайтесь изменить параметры давления:
3.7. Переключатель давления расчитан на 0,5–0,8 мПа. Для запуска компрессора поднимите ручку переключателя вверх, и компрессор начнёт работу.
Для того, чтобы выключить компрессор, опустите металлическую ручку вниз.
3.8. Предохранительный клапан избыточного давления срабатывает при давлении 0,9 мПа.

ВНИМАНИЕ:
Не устанавливайте дополнительные настройки для предохранительного клапана.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

4. Обслуживание:

4.1. Периодически из воздушного ресивера необходимо сливать воду (для этого давление в системе необходимо понизить до отметки 0,1 Мпа и открыть кран сброса конденсата). Рекомендуется повторять данную процедуру каждый день.

4.2. Раз в месяц рекомендуется прочищать фильтр глушителя. (Для этого снимите крышку глушителя, достаньте фильтр и прочистите его.)

5. Внимание:

Данный компрессор является безмасляным. Использовать смазочное масло запрещается.

6. Внимание:

6.1. Компрессор оснащен функцией защиты от перегрева: если корпус компрессора сильно нагревается, он автоматически отключается, после того, как температура корпуса понижается, компрессор автоматически снова начинает работать. (Если компрессор перегревается, постарайтесь понизить температуру в помещении.)

6.2. Если напряжение сети ниже 210 В, необходимо установить стабилизатор напряжения, в противном случае могут наблюдаться следующие отклонения в работе:

1) компрессор не включается;
2) если давление было низким, а затем оно повысилось, компрессор будет работать слабо либо не будет работать вообще;
3) будет срабатывать механизм, защищающий от перегрева.

Данное оборудование прошло регистрацию на территории Российской Федерации и внесено в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники.
Номер регистрационного удостоверения: ФСЗ 2011/11413 от 27.12.2011.
Срок действия РУ не ограничен.

Транспортировка и хранение

Медицинские изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующих на транспорте каждого вида. Медицинские изделия при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов при температурном режиме от - 5°С до +40°С, при относительной влажности воздуха 30-75% (без образования конденсата).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

7. Гарантия:

7.1. Заводская гарантия 12 месяцев со дня приобретения товара.

7.2. В пределах сроков поставки производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и форму, комплектацию, отклонения в оттенках цвета без предварительного предупреждения.

7.3. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, печати и товарного чека.

7.4. Гарантия не распространяется на случаи повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией оборудования, внешними механическими воздействиями, повреждениями в процессе транспортировки, а также случаи вмешательства в конструкцию оборудования лиц, не имеющих на это соответствующего разрешения.

Гарантийный талон № _____

Изделие _____ Модель _____

Серийный номер _____ Дата продажи _____

Компания-продавец _____

Подпись продавца / _____ /

Печать и телефон компании-продавца _ _____

Изделие проверено полностью,

Покупатель _____ с условиями гарантии ознакомлен _____

Адрес и телефон покупателя _____

Гарантийный талон № _____

Изделие _____ Модель _____

Серийный номер _____ Дата продажи _____

Компания-продавец _____

Подпись продавца / _____ /

Печать и телефон компании-продавца _ _____

Изделие проверено полностью,

Покупатель _____ с условиями гарантии ознакомлен _____

Адрес и телефон покупателя _____

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

7. Неисправности: их причины и устранение

1. Компрессор не работает. Пожалуйста, проверьте следующие части компрессора:
Подключение к сети, выключатель, датчик давления, электромагнитный клапан. Если вы не выявили явных повреждений комплектующих, обратитесь в сервисную службу. 2. Компрессор включается, но воздух не попадает в ресивер. Пожалуйста, проверьте электромагнитный клапан и ведущий к нему электрический кабель. Возможно, вышел из строя датчик давления, также возможен выход из строя однонаправленного клапана (износилось уплотнительное кольцо). Если данные неполадки выявлены, просьба обратиться в сервисную службу.
3. Если помещение плохо проветривается и температура воздуха слишком высокая компрессору приходиться работать в сложных условиях, в некоторых случаях срабатывает защита от перегрева и компрессор автоматически отключается. После того как мотор остынет компрессор автоматически включится.
4. Если показания манометра достигли предельных значений, а компрессор не отключается, немедленно отключите аппарат от сети, проверьте датчик давления. Через некоторое время снова включите компрессор.
5. Давление, при котором компрессор автоматически отключается, соответствует 0,85 мПа. Если компрессор, достигнув его, не отключился и повторное подключение не решило эту проблему, обратитесь в сервисную службу.
6. Производитель гарантирует надежную и бесперебойную работу компрессора в течение года с момента его продажи. В случае выявления неисправностей при изготовлении отдельных частей компрессора и его сборки товар ремонтируется или меняется по гарантии. В случае выхода компрессора из строя по вине владельца ремонт товара осуществляется за его счет силами компании-продавца.

Утилизация

Запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами. Медицинское изделие по истечению срока службы должно утилизироваться в специализированных организациях в соответствии с классом А СанПин 2.1.7.2790-10.

Срок службы данного медицинского изделия составляет 10 лет.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ